

beurer

BF 1000 Super Precision



DE Diagnosewaage Gebrauchsanweisung.....	2
EN Diagnostic bathroom scale Instructions for use.....	17
FR Pèse-personne impédancemètre Mode d'emploi	31
ES Báscula diagnóstica Instrucciones de uso	45
IT Bilancia diagnostica Istruzioni per l'uso	59
TR Diyagnoz terazisi Kullanım kılavuzu	73
RU Диагностические весы Инструкция по применению.....	87
PL Waga diagnostyczna Instrukcja obsługi	101



Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch. Befolgen Sie die Warn- und Sicherheitshinweise. Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung für den späteren Gebrauch auf. Machen Sie die Gebrauchsanweisung anderen Benutzern zugänglich. Geben Sie bei Weitergabe des Geräts auch die Gebrauchsanweisung mit.

Inhalt

1. Lieferumfang.....	2	10. Ergebnisse bewerten.....	11
2. Zeichenerklärung.....	3	11. Messwerte übertragen per App.....	13
3. Warn- und Sicherheitshinweise.....	3	12. Weitere Informationen.....	13
4. Gerätebeschreibung.....	5	13. Reinigung und Pflege.....	13
5. Inbetriebnahme.....	6	14. Entsorgung.....	14
6. Einrichten der Diagnosewaage mit App.....	6	15. Was tun bei Problemen?.....	14
7. Alternativ: Einrichten der Diagnosewaage ohne App.....	7	16. Technische Angaben.....	15
8. Messung durchführen.....	8	17. Garantie/Service.....	16
9. Analyse der Messwerte.....	9		

Zum Kennenlernen

Funktionen des Gerätes

Diese digitale Waage dient zum Wiegen und zur Ermittlung Ihrer persönlichen Fitness-Daten.

Sie ist für die Eigenanwendung im privaten Bereich bestimmt.

Die Waage verfügt über folgende Funktionen, die von bis zu 10 Personen benutzt werden können:

- Körpergewicht-Messung
- Ermittlung von Körperfettanteil,
- Visceralfettanteil (Organfett / Bauchfett),
- Körperwasseranteil,
- Muskelanteil,
- Knochenmasse sowie
- Grund- und Aktivitätsumsatz.

Außerdem verfügt die Waage über folgende weitere Funktionen:

- Überkreuzmessung mit 8 Elektroden ermöglicht die Segmentanalyse, d.h. eine separate Darstellung einzelner Körperteile (Arme, Beine, Rumpf)
- Innovative Menüführung im großen Display (wahlweise in 5 Sprachen),
- Umschalten zwischen Kilogramm „kg“, Pfund „lb“ und Stone „st“,
- Batteriewechsel-Anzeige bei schwachen Batterien,
- Automatische Benutzererkennung,
- Speicherung der letzten 30 Messungen für 10 Personen, wenn zur App nicht übertragen werden kann,
- Gastmodus (ohne Speicherfunktion).

Das Messprinzip

Diese Waage arbeitet mit dem Prinzip der B.I.A., der Bioelektrischen-Impedanz-Analyse. Dabei wird innerhalb von Sekunden durch einen nicht spürbaren, völlig unbedenklichen und ungefährlichen Strom eine Bestimmung von Körperanteilen ermöglicht.

Mit dieser Messung des elektrischen Widerstandes (Impedanz) und der Einberechnung von Konstanten bzw. individuellen Werten (Alter, Größe, Geschlecht, Aktivitätsgrad) können der Körperfettanteil und weitere Größen im Körper bestimmt werden. Muskelgewebe und Wasser haben eine gute elektrische Leitfähigkeit und daher einen geringeren Widerstand. Knochen und Fettgewebe hingegen haben eine geringe Leitfähigkeit, da die Fettzellen und Knochen durch sehr hohen Widerstand den Strom kaum leiten.

Der elektrische Kontakt zum Körper wird durch 4 Handelektroden und 4 Fußelektroden optimiert, um eine höhere Messgenauigkeit und somit eine bessere Analyse zu erreichen. Durch diese sensible Analysetechnik ist es möglich, dass sich bei Wiederholungsmessungen die Werte geringfügig ändern können. Der Grund hierfür sind Abweichungen während der Impedanzmessung (z.B. anderer elektrischer Kontakt zu den Elektroden mit Händen und Füßen, andere Verteilung des Wassers im Körper).

Beachten Sie, dass die von der Diagnosewaage ermittelten Werte nur eine Annäherung an die medizinischen, realen Analysewerte des Körpers darstellen. Nur der Facharzt kann mit medizinischen Methoden (z.B. Computertomografie) eine exakte Ermittlung von Körperfett, Körperwasser, Muskelanteil und Knochenbau durchführen.

1. LIEFERUMFANG

Überprüfen Sie den Lieferumfang auf äußere Unversehrtheit der Kartonverpackung und auf die Vollständigkeit des Inhalts. Vor dem Gebrauch ist sicherzustellen, dass das Gerät und Zubehör keine sichtbaren Schäden aufweisen und jegliches Verpackungsmaterial entfernt wird. Benutzen Sie es im Zweifelsfall nicht und wenden Sie sich an Ihren Händler oder an die angegebene Kundendienstadresse.

- Diagnosewaage mit erhöhtem Display auf Aluminium-Stele

- 4 x 1,5V Typ AA Batterien
- Diese Gebrauchsanweisung
- 2 x Kurzanleitung
- Montagesatz (4 Schrauben mit 2 Ersatzschrauben + Imbusschlüssel)

2. ZEICHENERKLÄRUNG

Auf dem Gerät, in der Gebrauchsanweisung, auf der Verpackung und auf dem Typschild des Geräts werden folgende Symbole verwendet:

⚠ WARNUNG Bezeichnet eine möglicherweise drohende Gefahr. Wenn sie nicht gemieden wird, können Tod oder schwerste Verletzungen die Folge sein.			
	Produktinformation Hinweis auf wichtige Informationen		United Kingdom Conformity Assessed Mark
	Das Gerät darf nicht von Personen mit medizinischen Implantaten (z.B. Herzschrittmacher) verwendet werden. Andernfalls kann deren Funktion beeinträchtigt sein.		Importeur Symbol
	CE-Kennzeichnung Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien.		Hersteller
	Die Produkte entsprechen nachweislich den Anforderungen der Technischen Regelwerke der EAWU		Produkt und Verpackungskomponenten trennen und entsprechend der kommunalen Vorschriften entsorgen.
	(Elektro-)Gerät darf nicht über den Hausmüll entsorgt werden		Gebrauchsanweisung beachten
	Schadstoffhaltige Batterien nicht im Hausmüll entsorgen		Kennzeichnung zur Identifikation des Verpackungsmaterials. A = Materialabkürzung, B = Materialnummer: 1-7 = Kunststoffe, 20-22 = Papier und Pappe
	Rutschgefahr! Waage nicht bei Nässe betreten		Waage auf einen ebenen und festen Untergrund stellen. Waage nicht auf einen Teppich stellen.
	Kippgefahr! Stellen Sie sich nicht auf den äußersten Rand.		

3. WARN- UND SICHERHEITSHINWEISE

⚠ WARNUNG

- Das Gerät ist nur zum Wiegen von Menschen und zur Aufzeichnung Ihrer persönlichen Fitness-Daten bestimmt. Das Gerät ist nur zur Eigenanwendung und nicht für den medizinischen oder kommerziellen Gebrauch bestimmt. Verwenden Sie das Gerät nur für den Zweck, für den es entwickelt wurde und auf die in dieser Gebrauchsanweisung angegebenen Art und Weise.
- **Das Gerät darf nicht von Personen mit medizinischen Implantaten (z.B. Herzschrittmacher) verwendet werden. Andernfalls kann deren Funktion beeinträchtigt sein.**
- **Verwenden Sie das Gerät nicht während der Schwangerschaft.**
- **Kippgefahr!** Stellen Sie die Waage niemals auf einen unebenen Untergrund. Steigen Sie nicht einseitig auf den äußersten Rand der Waage.
- **Rutschgefahr!** Steigen Sie nicht mit nassen Füßen auf die Waage. Betreten Sie die Waage nicht, wenn die Oberfläche feucht ist. Steigen Sie nicht mit Socken auf die Waage.
- Beachten Sie, dass technisch bedingt Messtoleranzen möglich sind, da es sich um keine geeichte Waage für den professionellen, medizinischen Gebrauch handelt.



- Bei jeder Behandlung bzw. Diät von Über- oder Untergewicht muss eine qualifizierte Beratung durch entsprechendes Fachpersonal (z.B. ein Arzt) erfolgen. Die mit der Waage ermittelten Werte können dabei das Fachpersonal unterstützen.
- Bei Kindern, Leistungssportlern oder Personen mit medizinischen/körperlichen Einschränkungen (z.B. Ödem-Symptomen, Osteoporose, Einnahme bei kardiovaskulärer oder gefäßverändernder Medizin, Personen mit erheblichen anatomischen Abweichungen an den Beinen), können bei der Ermittlung des Körperfettes ungenaue oder nicht plausible Ergebnisse auftreten.
- Reparaturen dürfen nur vom Beurer Kundenservice oder autorisierten Händlern durchgeführt werden. Öffnen Sie die Waage niemals selbst.

Sicherheitshinweise zum Umgang mit Batterien

- Batterien immer korrekt und unter Berücksichtigung der Polaritäten (+ / -) einlegen. Batterien sauber und trocken halten und von Wasser fernhalten. Stets den richtigen Batterietyp wählen.
- Batterien und Kontakte des Batteriefachs niemals kurzschließen.
- Batterien niemals aufladen, zwangsentladen, erhitzen, zerlegen, deformieren, einkapseln oder modifizieren.
- Niemals an Batterien schweißen oder löten.
- Batterien unterschiedlicher Herstellung, Kapazität (neu und gebraucht), Größe und Typ innerhalb eines Gerätes niemals mischen.
- **Explosionsgefahr!** Nichtbeachtung der genannten Punkte kann zu Personenschäden, Überhitzung, Auslaufen, Entlüftung, Bruch, Explosion oder Feuer führen.
- Wenn eine Batterie ausgelaufen ist, Schutzhandschuhe anziehen und das Batteriefach mit einem trockenen Tuch reinigen.
- Wenn Flüssigkeit aus einer Batteriezelle mit Haut oder Augen in Kontakt kommt, die betroffene Stelle mit Wasser auswaschen und ärztliche Hilfe aufsuchen.
- **Verschluckungsgefahr!** Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Bei Verschlucken sofort ärztliche Hilfe aufsuchen.
- Niemals Kindern erlauben, Batterien ohne Aufsicht eines Erwachsenen auszutauschen.
- Batterien entfernt von Metallgegenständen, in gut belüfteten, trockenen und kühlen Räumen lagern.
- Batterien niemals direkter Sonneneinstrahlung oder Regen aussetzen.
- Bei längerer Nichtnutzung Batterien aus dem Gerät entfernen.
- Entladene Batterien sofort und ordnungsgemäß entsorgen. Batterien niemals im Feuer entsorgen.
- Bei der Entsorgung, Batterien mit unterschiedlichen elektrochemischen Systemen getrennt aufbewahren.


Allgemeine Hinweise

- Die Belastbarkeit der Waage beträgt max. 200 kg (440 lb, 31 st). Bei der Gewichtsmessung werden die Ergebnisse in 50-g-Schritten (0,1 lb) angezeigt.
- Die Messergebnisse des Körperfett-, Körperwasser- und Muskelanteils werden in 0,1 %-Schritten angezeigt.
- Der Kalorienbedarf wird in Schritten von 1 kcal angegeben.
- Im Auslieferungszustand ist die Waage auf die Einheiten „cm“ und „kg“ eingestellt. Während der Inbetriebnahme mit der App können Sie die Einstellungen der Einheiten ändern.

Allgemeine Tipps


- Wiegen Sie sich möglichst zur selben Tageszeit (am besten morgens), nach dem Toilettengang, nüchtern und ohne Bekleidung, um vergleichbare Ergebnisse zu erzielen.
- Wichtig bei der Messung: Die Ermittlung des Körperfettes kann nur mit Handmessung und Barfußmessung erfolgen und kann zweckmäßig mit schwach befeuchteten Fußsohlen vorgenommen werden.
- Völlig trockene oder stark verhornte Fußsohlen können zu unbefriedigenden Ergebnissen führen, da diese eine zu geringe Leitfähigkeit aufweisen.
- Stehen Sie während des Messvorgangs aufrecht und still.
- Warten Sie einige Stunden nach ungewohnter körperlicher Anstrengung.
- Warten Sie ca. 15 Minuten nach dem Aufstehen, damit sich das im Körper befindliche Wasser verteilen kann.
- Wichtig ist, dass nur der langfristige Trend zählt. In der Regel sind kurzfristige Gewichtsabweichungen innerhalb von wenigen Tagen durch Flüssigkeitsverlust bedingt; Körperwasser spielt jedoch für das Wohlbefinden eine wichtige Rolle.

4. GERÄTEBESCHREIBUNG

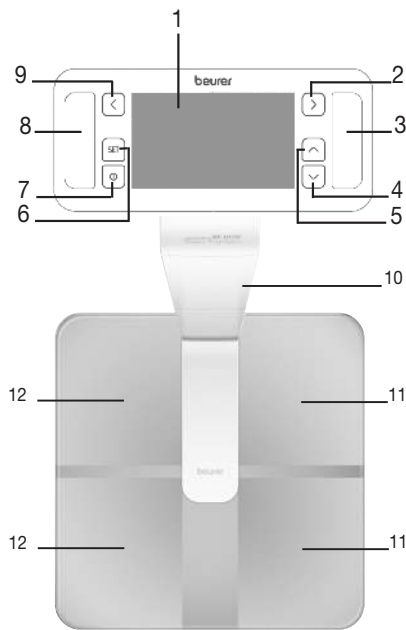

1. Display
2. > Menü: Rechts-Taste (Sensortaste)
3. Elektroden, rechte Hand
4. ↓ Menü: Ab-Taste (Sensortaste)
5. ↑ Menü: Auf-Taste (Sensortaste)
6. [OK] Einstelltaste, Eingaben bestätigen (Sensortaste)
7. [ON/OFF] ON/OFF-Taste (Sensortaste)
8. Elektroden, linke Hand
9. < Menü: Links-Taste (Sensortaste)
10. Aluminium-Stele
11. Fuß-Elektroden, rechter Fuß
12. Fuß-Elektroden, linker Fuß

Display

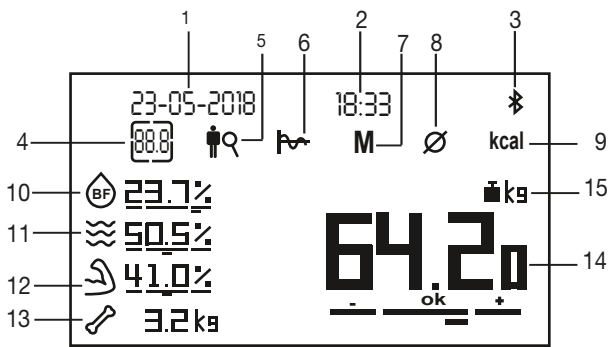


1. Datum	2. Uhrzeit
3. Bluetooth®	4. Gesamtübersicht
5. Segmentanalyse	6. Grafische Darstellung
7. Benutzerspeicher	8. Mittelwerte
9. Kalorienverbrauch	10. Körperfettanteil mit Interpretation
11. Körperwasseranteil mit Interpretation	12. Muskelanteil mit Interpretation
13. Knochenmasse mit Interpretation	14. Körpergewicht mit BMI-Interpretation
15. Gewichtseinheit(kg, lb oder st)	


5. INBETRIEBNAHME

Waage aufstellen


Stellen Sie die Waage auf einen ebenen und festen Untergrund. Eine feste Standfläche ist Voraussetzung für eine korrekte Messung.

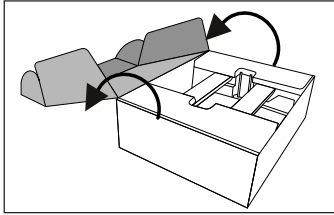


1. Karton öffnen.

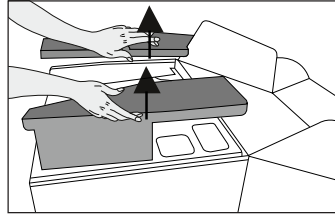


2. Styroporabdeckung links und rechts entfernen.

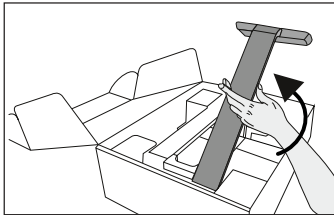


3. Oberen und unteren Teil der Aluminium-Stele zeitgleich hochklappen.

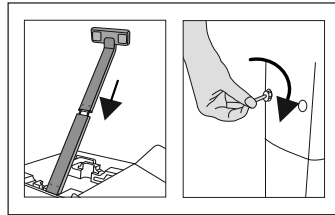


4. Oberen Teil der Aluminium-Stele in den unteren Teil hineinstecken und oben verschrauben.

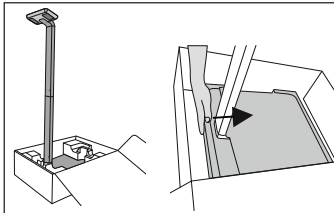


5. Aluminium-Stele im Karton aufrecht hinstellen. Waage an den Rand schieben...

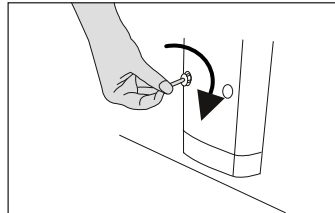

6. ...und unten verschrauben.

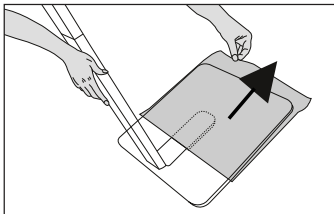

7. Mit der einen Hand Stele festhalten, mit der anderen Hand Folie entfernen.

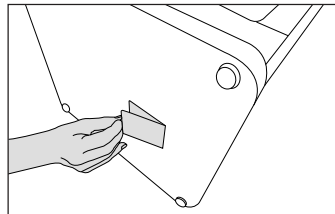

8. Batterien auf der Unterseite der Waage mit korrekter Polung (+/-) einlegen. Und die Waage auf ebener Fläche hochkant aufstellen.

6. EINRICHTEN DER DIAGNOSEWAAGE MIT APP

Um Ihren Körperfettanteil und weitere Körperwerte ermitteln zu können, müssen Sie die persönlichen Benutzerdaten auf der Waage einspeichern.

Die Waage verfügt über 10 Benutzerspeicherplätze, in die Sie und beispielsweise die Mitglieder Ihrer Familie Ihre persönlichen Einstellungen abspeichern können.

Zusätzlich können Benutzer über weitere mobile Endgeräte mit installierter „beurer HealthManager Pro“ App oder durch Benutzerprofilwechsel in der App (siehe Einstellungen App) in Betrieb genommen werden.

Damit während der Inbetriebnahme eine **Bluetooth®**-Verbindung aktiv gehalten werden kann, bleiben Sie mit dem Smartphone in der Nähe der Waage.

- **Bluetooth® in den Einstellungen des Smartphones aktivieren.**
- **Laden Sie die kostenlose „beurer HealthManager Pro“ App im Apple App Store (iOS) oder bei Google Play (Android™) herunter.**
- **App starten und den Anweisungen folgen.**
 - Folgende Einstellungen müssen in der „beurer HealthManager Pro“ App eingestellt sein bzw. eingegeben werden:

Benutzerdaten	Einstellwerte
Initialen	max. 3-stellig (A-Z, 0-9)
Geschlecht	männlich (♂), weiblich (♀)
Körpergröße	100 bis 250 cm (3' 03" bis 8' 02")
Geburtsdag	Jahr, Monat, Tag
Aktivitätsgrad	Bei der Auswahl des Aktivitätsgrades ist die mittel- und langfristige Betrachtung entscheidend:
	Körperliche Aktivität
	1 Keine.
	2 Geringe: Wenige und leichte körperliche Anstrengungen (z.B. Spazierengehen, leichte Gartenarbeit, gymnastische Übungen).
	3 Mittlere: Körperliche Anstrengungen, mindestens 2 bis 4 mal pro Woche, jeweils 30 Minuten.
	4 Hohe: Körperliche Anstrengungen, mindestens 4 bis 6 mal pro Woche, jeweils 30 Minuten.
	5 Sehr hohe: Intensive körperliche Anstrengungen, intensives Training oder harte körperliche Arbeit, täglich, jeweils mindestens 1 Stunde.
Zielgewicht	kg/lb/st (für grafische Verlaufsdarstellung)

- Die App weist Ihnen den nächsten freien Waagen-Benutzerspeicher zu (Person 1 bis Person 10).
- Messung durchführen: Für die automatische Personenerkennung muss die erste Messung auf Ihren persönlichen Benutzerdaten zugewiesen werden. Die App fordert Sie hierzu auf. Beachten Sie hierzu Kapitel „8. Messung durchführen“.

7. ALTERNATIV: EINRICHTEN DER DIAGNOSEWAAGE OHNE APP

Wir empfehlen die Inbetriebnahme und Durchführung aller Einstellungen per App. Siehe Kapitel „6. Einrichten der Diagnosewaage mit App“. Diese können jedoch auch am Gerät durchgeführt werden.

Einstellungen zu Gerät/Zeit/Nutzer am Bedienteil durchführen. Treffen Sie dazu generell Ihre Auswahl über die Tasten [] bzw. [] und bestätigen Sie jeweils mit [SET].

a.) Zeit einstellen

[SET] → „ZEIT EINSTELLEN“ → [SET]

Reihenfolge	Einstellwerte
Datum	Jahr – Monat – Tag
Uhrzeit	Stunden – Minuten

b.) Gerät einstellen

[SET] → „GERÄT EINSTELLEN“ → [SET]

Reihenfolge	Einstellwerte
Sprache	    
Maßeinheit	kg – lb – st
Uhrzeit	24 h – 12 h
Gastmodus	AN – AUS
Bluetooth®	AN – AUS
	 Wenn „AUS“, dann ist eine Bluetooth® -Verbindung nur möglich, wenn die Waage angeschaltet ist. Dies kann sinnvoll sein, um die Batteriebenszeit zu verlängern oder um nicht gewollte Funkstrahlung zu vermeiden.

c.) Benutzerdaten einstellen

[SET] → „PERSON ÄNDERN“ → [SET]

Benutzerdaten	Einstellwerte
Initialen	max. 3-stellig (A-Z, 0-9)
Geschlecht	männlich (♂), weiblich (♀)
Größe	100 bis 250 cm (3'-03" bis 8'-02")
Geburtstag	Jahr, Monat, Tag
Aktivitätsgrad	1 bis 5 (Siehe Kapitel 6)
Zielgewicht	kg/lb/st (für grafische Verlaufsdarstellung)
Benutzer-Pin	Wird automatisch zugewiesen für eventuell spätere <i>Bluetooth®</i> -Nutzung. Diese Information wird nur bei nachträglicher App-Einrichtung benötigt, wenn existierende Waagenbenutzer bei späterer App-Installationen hinzugefügt werden.



Spätere App Anmeldung

Sollten Sie die Inbetriebnahme der Waage ohne App durchgeführt haben, können Sie Ihren existierenden Waagenbenutzer in die „beurer HealthManager Pro“ App hinzufügen. Dabei ist die Eingabe Ihrer 4 stelligen Benutzerpin-„PIN“ nötig. Diese Vorgehensweise wird in der App beschrieben.

8. MESSUNG DURCHFÜHREN

8.1 Messung Körpergewicht

- Drücken Sie die Taste am Bedienteil. Es erscheint „0.0“ kg im Display.
- Die Waage ist zur Gewichtsmessung bereit. Stellen Sie sich hierzu auf die Waage mit gleichmäßiger Gewichtsverteilung auf beiden Beinen. Die Gewichtsdaten werden nicht gespeichert. Eine Benutzerzuordnung ist nicht möglich, da keine BIA-Messung über Hände und Füße erfolgt.

8.2 Gastmessung durchführen

Bei einmaliger Messung, bzw. wenn keine Benutzerdaten gespeichert werden sollen. Hierfür muss in den Geräteeinstellungen der Gastmodus eingeschaltet sein.

[] → „Gast“ → [SET] oder Waage anschalten

Benutzerdaten	Einstellwerte
Geschlecht	männlich (♂), weiblich (♀)
Größe	100 bis 250 cm (3'-03" bis 8'-02")
Geburtstag	Jahr, Monat, Tag
Aktivitätsgrad	1 bis 5 (Siehe Kapitel 6)

8.3 Benutzermessung Ganzkörperanalyse

Drücken Sie die Taste am Bedienteil. Es erscheint „0.0“ kg im Display.




Falls der Gastmodus in den Waageneinstellungen aktiviert wurde, stellen Sie sich im ausgeschalteten Zustand auf die Waage.

- Stellen Sie sich barfuß auf die Waage und halten Sie das Bedienteil fest in den Händen. Halten Sie das Bedienteil mit dem unteren Bereich des Daumens auf den vorderen Elektroden und mit den anderen Fingern die hinteren Elektroden fest gedrückt.
- Stehen Sie ruhig auf der Waage mit gleichmäßiger Gewichtsverteilung auf beiden Beinen. Beachten Sie, dass kein Hautkontakt zwischen beiden Füßen, Beinen, Waden und Oberschenkeln bestehen darf.



- Falls die Waage Sie automatisch erkannt hat, erfolgt nach der Gewichtsmessung die Messung der Impedanz für die Analyse. Dies wird durch das Symbol des durchströmten Körpers angezeigt.
- Sobald die Ganzkörperanalyse abgeschlossen ist, wird die Übersicht angezeigt. Der Messwert wird automatisch gespeichert.



Initialen Segmentanalyse



Hinweis:

Es folgt keine Speicherung der Messung unter folgenden Voraussetzungen:

- Benutzer wird nicht automatisch erkannt. Dies geschieht, sollte Ihr gemessenes Gewicht um +/- 3 kg zur letzten Messung abweichen oder ein anderer Benutzer +/- 3 kg ähnlich an Ihren Werten liegt. Dann Taste [] drücken, um den Benutzer manuell auszuwählen und die Messung erneut durchzuführen.
- Benutzer steht mit Schuhen auf der Waage.
- Benutzer hält das Handteil nicht in den Händen.

9. ANALYSE DER MESSWERTE




Eine Auswertung der Ergebnisse erfolgt automatisch nach durchgeführter Messung oder nach manueller Benutzerauswahl am Bedienteil. Wählen Sie mit der Taste [] Ihren Benutzer. Bestätigen Sie mit der Taste [SET] oder warten Sie 3 Sekunden.



Gesamtübersicht


Vor oder nach einer Gesamtkörperanalyse Ihres Benutzers erscheint im Display die Gesamtübersicht auf einen Blick.



Segmentanalyse für Körperfett und Muskelanteil

a) Körperfett linker und rechter Arm


- Drücken Sie die Menü-Taste [] so oft, bis markiert ist. Im Display erscheint die Segmentanalyse des Körperfetts für den linken und rechten Arm.



Linker Arm Rechter Arm


b) Körperfett linkes und rechtes Bein

- Schalten Sie mit der Taste [] zur detaillierten Darstellung des Körperfetts für das linke und rechte Bein.




c) Körperfett Rumpf

- Schalten Sie mit der Taste [] zur detaillierten Darstellung des Körperfetts im Rumpf.




d) Viszeralfett (Organfett/Bauchfett)



- Schalten Sie mit der Taste [] zur detaillierten Darstellung des Viszeralfetts.



e) Muskelanteil linker und rechter Arm





- Schalten Sie mit der Taste [] zur detaillierten Darstellung des Muskelanteils im linken und rechten Arm.




f) Muskelanteil linkes und rechtes Bein Schalten Sie mit der Taste [] zur detaillierten Darstellung des Muskelanteils im linken und rechten Bein.	
g) Muskelanteil Rumpf Schalten Sie mit der Taste [] zur detaillierten Darstellung des Muskelanteils im Rumpf.	

 Für Benutzer im Alter von 10 – 17 Jahren wird kein Viszeralfett und kein segmentieller Muskelanteil (Arm/Bein/Rumpf) angezeigt.

Grafische Darstellung

a) Körpergewicht Drücken Sie die Menü-Taste [] so oft, bis  markiert ist. Im Display erscheint die Entwicklung Ihres Körpergewichtes. Die Entwicklung Ihres Körpergewichtes wird von Messung zu Messung dargestellt. Neuere Messungen werden rechts angefügt. Die Bezugslinie stellt das Zielgewicht dar.  Das Zielgewicht können Sie in den Benutzerdaten jederzeit ändern.	
b) Körperfett  Schalten Sie mit der Taste [] zum Verlauf der Körperfettwerte . Die Entwicklung Ihres Körperfettwertes wird von Messung zu Messung dargestellt. Die Bezugslinie stellt den Durchschnittswert aller Körperfettmessungen dar, die Balken zeigen, ob sich die Werte nach oben oder unten verändert haben.	
c) Wasseranteil  Schalten Sie mit der Taste [] zum Verlauf der Wasseranteils . Die Entwicklung Ihres Wasseranteils wird von Messung zu Messung dargestellt. Die Bezugslinie stellt den Durchschnittswert aller Wasseranteilmessungen dar, die Balken zeigen, ob sich die Werte nach oben oder unten verändert haben.	
d) Muskelanteil  Schalten Sie mit der Taste [] zum Verlauf des Muskelanteils . Die Entwicklung Ihres Muskelanteils wird von Messung zu Messung dargestellt. Die Bezugslinie stellt den Durchschnittswert aller Muskelanteile dar, die Balken zeigen, ob sich die Werte nach oben oder unten verändert haben.	


M Speicherwerte anzeigen

- Drücken Sie die Menü-Taste [] so oft, bis M markiert ist. Im Display erscheint der zuletzt gemessene Speicherwert. Oben steht das Datum der Messung sowie die Speicherplatz-Nummer (03-03) z.B. der dritte = letzte Speicherplatz von insgesamt 3 belegten Speicherplätzen. - Schalten Sie mit den Tasten [ , ] durch die Speicherplätze.	
--	--

Mittelwerte


- Drücken Sie die Menü-Taste [] so oft, bis  markiert ist. Im Display werden sämtliche Mittelwerte aus den gespeicherten Messungen dargestellt.

 Oben steht das Datum der ersten sowie der letzten Messung.



Kalorienverbrauch

- Drücken Sie die Menü-Taste [] so oft, bis  markiert ist. Der theoretisch berechnete Grundumsatz BMR sowie Aktivitätsumsatz AMR werden in Kcal dargestellt.



Waage ausschalten (Standby-Modus)

- Warten Sie, bis sich das Display selbstständig ausschaltet oder drücken Sie die Taste [] am Bedienteil, um das Display manuell auszuschalten. Datum und Uhrzeit bleiben sichtbar.

10. ERGEBNISSE BEWERTEN

Körperfettanteil

Die Körperfettwerte werden im Display dargestellt und mit dem Balkendiagramm bewertet. Nachfolgende Körperfettwerte in % geben Ihnen eine Richtlinie (für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt!).

Mann

				
Alter	wenig	normal	viel	sehr viel
10–14	<11 %	11–16 %	16,1–21 %	>21 %
15–19	<12 %	12–17 %	17,1–22 %	>22 %
20–29	<13 %	13–18 %	18,1–23 %	>23 %
30–39	<14 %	14–19 %	19,1–24 %	>24 %
40–49	<15 %	15–20 %	20,1–25 %	>25 %
50–59	<16 %	16–21 %	21,1–26 %	>26 %
60–69	<17 %	17–22 %	22,1–27 %	>27 %
70–100	<18 %	18–23 %	23,1–28 %	>28 %

Frau

				
Alter	wenig	normal	viel	sehr viel
10–14	<16 %	16–21 %	21,1–26 %	>26 %
15–19	<17 %	17–22 %	22,1–27 %	>27 %
20–29	<18 %	18–23 %	23,1–28 %	>28 %
30–39	<19 %	19–24 %	24,1–29 %	>29 %
40–49	<20 %	20–25 %	25,1–30 %	>30 %
50–59	<21 %	21–26 %	26,1–31 %	>31 %
60–69	<22 %	22–27 %	27,1–32 %	>32 %
70–100	<23 %	23–28 %	28,1–33 %	>33 %

Bei Sportlern ist oft ein niedrigerer Wert festzustellen. Je nach betriebener Sportart, Trainingsintensität und körperlicher Konstitution können Werte erreicht werden, die noch unterhalb der angegebenen Richtwerte liegen. Bitte beachten Sie jedoch, dass bei extrem niedrigen Werten Gesundheitsgefahren bestehen können.

Viszeralfett (Organfett / Bauchfett)

Als Viszeralfett bezeichnet man Fett, das die inneren Organe in der Bauchhöhle umschließt. Viszeralfett steht im Verdacht, Krankheiten wie Bluthochdruck oder Diabetes zu begünstigen.

Das Viszeralfett wird im Display mit einer Kennzahl zwischen 1 und 59 dargestellt.

Kennzahl Viszeralfettanteil	Bewertung
1–12	Ihr Viszeralfettanteil liegt im normalen Bereich.
13–59	Ihr Viszeralfettanteil ist zu hoch.

Körperwasseranteil

Der Anteil des Körperwassers in % liegt normalerweise in folgenden Bereichen:

Mann

-- ok +			
Alter	schlecht	gut	sehr gut
10–100	<50 %	50–65 %	>65 %

-- ok +			
Alter	schlecht	gut	sehr gut
10–100	<45 %	45–60 %	>60 %

Körperfett beinhaltet relativ wenig Wasser. Deshalb kann bei Personen mit einem hohen Körperfettanteil der Körperwasseranteil unter den Richtwerten liegen. Bei Ausdauer-Sportlern hingegen können die Richtwerte aufgrund geringer Fettanteile und hohem Muskelanteil überschritten werden.

Die Körperwasserermittlung mit dieser Waage ist nicht dazu geeignet, medizinische Rückschlüsse auf z.B. altersbedingte Wasserreinerlagerungen zu ziehen. Fragen sie gegebenenfalls Ihren Arzt. Grundsätzlich gilt es, einen hohen Körperwasseranteil anzustreben.

Muskelanteil

Bei der Messung des Muskelanteils wird die Skelettmuskelmasse gemessen. Es werden keine organischen Muskeln berücksichtigt. Der Muskelanteil in % liegt normalerweise in folgenden Bereichen:

Mann

-- ok +			
Alter	wenig	normal	viel
10–14	<44%	44–57 %	>57 %
15–19	<43%	43–56 %	>56 %
20–29	<42%	42–54 %	>54 %
30–39	<41%	41–52 %	>52 %
40–49	<40%	40–50 %	>50 %
50–59	<39%	39–48 %	>48 %
60–69	<38%	38–47 %	>47 %
70–100	<37%	37–46 %	>46 %

Frau

-- ok +			
Alter	wenig	normal	viel
10–14	<36%	36–43 %	>43 %
15–19	<35%	35–41 %	>41 %
20–29	<34%	34–39 %	>39 %
30–39	<33%	33–38 %	>38 %
40–49	<31%	31–36 %	>36 %
50–59	<29%	29–34 %	>34 %
60–69	<28%	28–33 %	>33 %
70–100	<27%	27–32 %	>32 %

Knochenmasse

Unsere Knochen sind wie der Rest unseres Körpers natürlichen Aufbau-, Abbau- und Alterungsprozessen unterworfen. Die Knochenmasse nimmt im Kindesalter rasch zu und erreicht mit 30 bis 40 Jahren das Maximum. Mit zunehmendem Alter nimmt die Knochenmasse dann wieder etwas ab. Mit gesunder Ernährung (insbesondere Kalzium und Vitamin D) und regelmäßiger körperlicher Bewegung können Sie diesem Abbau ein Stück weit entgegen wirken. Mit gezieltem Muskelaufbau können Sie die Stabilität Ihres Knochengerüstes zusätzlich verstärken. Beachten Sie, dass diese Waage den Mineralanteil des Knochens ausweist. Die Knochenmasse lässt sich kaum beeinflussen, schwankt aber geringfügig innerhalb der beeinflussenden Faktoren (Gewicht, Größe, Alter, Geschlecht). Es sind keine anerkannten Richtlinien und Empfehlungen vorhanden.



Bitte verwechseln Sie nicht die Knochenmasse mit der Knochendichte. Die Knochendichte kann nur bei medizinischer Untersuchung (z.B. Computertomographie, Ultraschall) ermittelt werden. Deshalb sind Rückschlüsse auf Veränderungen der Knochen und der Knochenhärte (z.B. Osteoporose) mit dieser Waage nicht möglich.

BMR

Der Grundumsatz (BMR = Basal Metabolic Rate) ist die Energiemenge, die der Körper bei völliger Ruhe zur Aufrechterhaltung seiner Grundfunktionen benötigt (z.B. wenn man 24 Stunden im Bett liegt). Dieser Wert ist im Wesentlichen vom Gewicht, der Körpergröße und dem Alter abhängig. Er wird bei der Diagnosewaage in der Einheit kcal/Tag angezeigt und anhand der wissenschaftlich anerkannten Mifflin-St.Jeor-Formel berechnet.

Diese Energiemenge benötigt Ihr Körper auf jeden Fall und muss in Form von Nahrung dem Körper wieder zugeführt werden. Wenn Sie längerfristig weniger Energie zu sich nehmen, kann sich dies gesundheitsschädlich auswirken.

AMR

Der Aktivitätsumsatz (AMR = Active Metabolic Rate) ist die Energiemenge, die der Körper im aktiven Zustand pro Tag verbraucht. Der Energieverbrauch eines Menschen steigt mit zunehmender körperlicher Aktivität an und wird bei der Diagnosewaage über den eingegebenen Aktivitätsgrad (1–5) ermittelt.

Um das aktuelle Gewicht zu halten, muss die verbrauchte Energie dem Körper in Form von Essen und Trinken wieder zugeführt werden. Wird über einen längeren Zeitraum hinweg weniger Energie zugeführt als verbraucht, holt sich der Körper die Differenz im wesentlichen aus den angelegten Fett-Speichern, das Gewicht nimmt ab. Wird hingegen über einen längeren Zeitraum hinweg mehr Energie zugeführt als der berechnete Aktivitätsumsatz (AMR) kann der Körper den Energieüberschuss nicht verbrennen, der Überschuss wird als Fett im Körper eingelagert, das Gewicht nimmt zu.

Zeitlicher Zusammenhang der Ergebnisse



Beachten Sie, dass nur der langfristige Trend von Bedeutung ist. Kurzfristige Gewichtsabweichungen innerhalb von wenigen Tagen sind in der Regel durch Flüssigkeitsverlust bedingt.

Die Deutung der Ergebnisse richtet sich nach den Veränderungen des Gesamtgewichts und der prozentualen Körperfett-, Körperwasser- und Muskelanteile, sowie nach der Zeitdauer mit welcher diese Änderungen erfolgen. Rasche Veränderungen im Bereich von Tagen sind von mittelfristigen Änderungen (im Bereich von Wochen) und langfristigen Änderungen (Monaten) zu unterscheiden. Als Grundregel kann gelten, dass kurzfristige Veränderungen des Gewichts fast ausschließlich Änderungen des Wassergehalts darstellen, während mittel- und langfristige Veränderungen auch den Fett- und Muskelanteil betreffen können.

- Wenn kurzfristig das Gewicht sinkt, jedoch der Körperfettanteil steigt oder gleich bleibt, haben Sie lediglich Wasser verloren – z.B. nach einem Training, Saunagang oder einer nur auf schnellen Gewichtsverlust beschränkten Diät.
- Wenn das Gewicht mittelfristig steigt, der Körperfettanteil sinkt oder gleich bleibt, könnten Sie hingegen wertvolle Muskelmasse aufgebaut haben.
- Wenn Gewicht und Körperfettanteil gleichzeitig sinken, funktioniert Ihre Diät – Sie verlieren Fettmasse.
- Idealerweise unterstützen Sie Ihre Diät mit körperlicher Aktivität, Fitness- oder Krafttraining. Damit können Sie mittelfristig Ihren Muskelanteil erhöhen.
- Körperfett, Körperwasser oder Muskelanteile dürfen nicht addiert werden (Muskelgewebe enthält auch Bestandteile aus Körperwasser).

11. MESSWERTE ÜBERTRAGEN PER APP

Falls die App nicht geöffnet ist, werden neu zugewiesene Messungen in der Waage gespeichert. Maximal 30 Messungen pro Benutzer können in der Waage gespeichert werden. Die gespeicherten Messwerte werden automatisch zur App übertragen, wenn Sie die App innerhalb der *Bluetooth*®-reichweite öffnen. Eine automatische Übertragung im ausgeschalteten Zustand der Waage ist möglich wenn *Bluetooth*® in den Geräteeinstellungen angeschaltet ist.

12. WEITERE INFORMATIONEN

Waagedaten löschen

a) Benutzer mit allen Einstellungen und Speicherwerten löschen

- Wählen Sie nach dem Einschalten Ihren Benutzer durch Drücken der Taste []. Dazu Taste ggf. wiederholt drücken und mit [SET] bestätigen.
- Drücken Sie, wenn die Anzeige **0.0** erscheint, die Taste [SET] 12 Sekunden lang, um den Benutzer zu löschen.
- Wählen Sie mit den Tasten [,] „JA“ und bestätigen Sie die Abfrage mit der Taste [SET]. Falls Sie den Benutzer nicht löschen möchten, bestätigen Sie „NEIN“ mit der Taste [SET].



Alle gespeicherten Werte und Einstellungen dieses Benutzers werden gelöscht.

b) Einzelnen Speicherwert eines Benutzers löschen

- Wählen Sie im Benutzerspeicher [M] einen Messwert und drücken Sie die Taste [SET] am Bedienteil kurz, um den angezeigten Speicherwert zu löschen.
- Dies können Sie auch direkt nach der Messung durchführen.
- Wählen Sie mit den Tasten [,] „JA“ und bestätigen Sie die Abfrage mit der Taste [SET]. Falls Sie den Wert nicht löschen möchten, bestätigen Sie „NEIN“ mit der Taste [SET].

c) Alle Speicherwerte eines Benutzers löschen

- Rufen Sie den Benutzerspeicher [M] auf und drücken Sie die Taste [SET] am Bedienteil für ca. 5 Sekunden, um alle Werte zu löschen.
- Wählen Sie mit den Tasten [,] „JA“ und bestätigen Sie die Abfrage mit der Taste [SET]. Falls Sie nichts löschen möchten, bestätigen Sie „NEIN“ mit der Taste [SET].

Batterien wechseln

Das Bedienteil ist mit einer Batteriewechselanzeige ausgestattet. Im Display erscheint „BATTERIE LEER“, wenn die Batterien der Waage zu schwach sind. Die Batterien müssen in diesem Fall ersetzt werden. Danach erneut die Waage mit der App verbinden. Die Systemzeit wird aktualisiert.



Hinweis:

- Verwenden Sie bei jedem Batteriewechsel Batterien gleichen Typs, gleicher Marke und gleicher Kapazität.
- Verwenden Sie keine wiederaufladbaren Akkus.
- Verwenden Sie schwermetallfreie Batterien.

13. REINIGUNG UND PFLEGE

Reinigen Sie die Waagenoberfläche von Zeit zu Zeit mit einem leicht angefeuchteten Tuch. Verwenden Sie die Waage erst wieder, sobald die Waagenoberfläche vollständig getrocknet ist.



Hinweis:

- Benutzen Sie keine scharfen Reinigungsmittel.
- Tauchen Sie die Waage niemals in Wasser. Spülen Sie die Waage niemals unter fließendem Wasser ab.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf der Waage ab, wenn sie nicht benutzt wird.
- Schützen Sie die Waage vor Stößen, Feuchtigkeit, Staub, Chemikalien, starken Temperaturschwankungen und zu nahen Wärmequellen (Ofen, Heizkörper).

14. ENTSORGUNG

Die verbrauchten, vollkommen entladenen Batterien müssen Sie über speziell gekennzeichnete Sammelbehälter, Sondermüllannahmestellen oder über den Elektrohändler entsorgen. Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, die Batterien zu entsorgen.

Diese Zeichen finden Sie auf schadstoffhaltigen Batterien:

Pb = Batterie enthält Blei,

Cd = Batterie enthält Cadmium,

Hg = Batterie enthält Quecksilber.

Im Interesse des Umweltschutzes darf das Gerät am Ende seiner Lebensdauer nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Die Entsorgung kann über entsprechende Sammelstellen in Ihrem Land erfolgen.

Entsorgen Sie das Gerät gemäß der Elektround Elektronik Altgeräte EG-Richtlinie–WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Bei Rückfragen wenden Sie sich an die für die Entsorgung zuständige kommunale Behörde.



Hinweise für Verbraucher zur Altgeräteentsorgung und Verschrottung in Deutschland:

Besitzer von Altgeräten können diese im Rahmen der durch die öffentlichrechtlichen Entsorgungsträger eingerichteten und zur Verfügung stehenden Möglichkeiten der Rückgabe oder Sammlung von Altgeräten unentgeltlich abgeben, damit eine ordnungsgemäße Entsorgung der Altgeräte sichergestellt ist.

Die Rückgabe ist gesetzlich vorgeschrieben.

Außerdem ist die Rückgabe unter bestimmten Voraussetzungen auch bei Vertreibern möglich.

Gemäß Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) sind die folgenden Vertreter zur unentgeltlichen Rücknahme von Altgeräten verpflichtet:

- Elektro-Fachgeschäfte, mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400 Quadratmetern
- Lebensmittelläden mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 Quadratmetern, die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektround Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen.
- Versandhandel, wobei die Pflicht zur 1:1-Rücknahme im privaten Haushalt nur für Wärmeüberträger (Kühl-/Gefriergeräte, Klimageräte u.a.), Bildschirmgeräte und Großgeräte gilt.
Für die 1:1-Rücknahme von Lampen, Kleingeräten und kleinen IT- u. Telekommunikationsgeräten sowie die 0:1-Rücknahme müssen Versandhändler Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum Endverbraucher bereitstellen.

Diese Vertreter sind verpflichtet,

- bei der Abgabe eines neuen Elektro- oder Elektronikgerätes an einen Endnutzer ein Altgerät des Endnutzers der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, am Ort der Abgabe oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen und
- auf Verlangen des Endnutzers Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, im Einzelhandelsgeschäft oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen; die Rücknahme darf nicht an den Kauf eines Elektro- oder Elektronikgerätes geknüpft werden und ist auf drei Altgeräte pro Geräteart beschränkt.

Enthalten die Produkte Batterien und Akkus oder Lampen, die aus dem Altgerät zerstörungsfrei entnommen werden können, müssen diese vor der Entsorgung entnommen werden und getrennt als Batterie bzw. Lampe entsorgt werden.

Sofern das alte Elektro- bzw. Elektronikgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich, bevor Sie es zurückgeben.

15. WAS TUN BEI PROBLEMEN?

Stellt die Waage bei der Messung einen Fehler fest, wird folgendes angezeigt:

Displayanzeige	Ursache	Behebung
„ÜBERLASTUNG!“	Die maximale Tragkraft von 200 kg wurde überschritten.	Nur bis 200 kg belasten.
„BATTERIE_LEER„	Die Batterien sind fast leer.	Wechseln Sie die Batterien (siehe Kapitel „Batterien wechseln“).
„SPEICHER_VOLL“	Es sind 30 Messungen gespeichert.	Übertragen Sie die Messwerte.
„KONTAKTFEHLER!“ „ERROR“	Der elektrische Widerstand zwischen den Elektroden und Fußsohle ist zu hoch (z.B. bei starker Hornhaut).	Die Messung bitte barfuß wiederholen. Feuchten Sie ggf. Ihre Fußsohlen leicht an. Entfernen Sie ggf. die Hornhaut an den Fußsohlen. Halten Sie die Handelektroden mit den Fingern hinten und mit dem Handballen vorne.

Displayanzeige	Ursache	Behebung
„MESSBEREICH!“	Die BIA-Messung war zwar erfolgreich, aber der Fettanteil liegt außerhalb des messbaren Bereichs (kleiner 3% oder größer 65%).	Die Messung bitte barfuß wiederholen oder feuchten Sie ggf. Ihre Fußsohlen leicht an. Ändern Sie ggf. Ihren eingestellten Aktivitätsgrad.
Keine Anzeige	Die Batterien sind vollständig leer.	Wechseln Sie die Batterien (siehe Kapitel „Batterien wechseln“).
	Die Batterien sind nicht richtig eingelegt.	Überprüfen Sie die korrekte Polung, (siehe „Inbetriebnahme“ -> „Batterien wechseln“).
Nur Gewichtsanzeige, Diagnose fehlt	Unbekannte Messung, da außerhalb Grenze Benutzerzuordnung oder keine eindeutige Zuordnung möglich ist.	Benutzer an der Waage mit Taste [] auswählen oder Benutzerzuweisung in der App wiederholen. Halten Sie die Elektroden des Handteils und stehen Sie barfuß auf der Plattform.

Falsche Gewichtsmessung

Mögliche Fehler	Behebung
Waage hat falschen Nullpunkt.	Waage einschalten, ca. 5 Sekunden warten und Messung wiederholen.
Waage steht auf Teppichboden.	Waage auf ebenen und festen Boden stellen. Stehen Sie möglichst weit nach außen ohne die Waage zu kippen.
Falsches Gewicht wird angezeigt.	Stehen Sie möglichst still.
Falsches Gewicht wird angezeigt.	Abwarten bis Waage selbst wieder ausschaltet. Dann Messung wiederholen.

Keine Bluetooth®-Verbindung (Ⓢ-Symbol fehlt)

Mögliche Fehler	Behebung
Funkverbindung	Mindestreichweite im freien Feld sind ca. 10 m. Wände und Decken verringern die Reichweite. Andere Funkwellen können die Übertragung stören. Stellen Sie die Waage deshalb nicht in der Nähe von Geräten wie z.B. WIFI Router, Mikrowelle, Induktionskochfeld auf.
Bluetooth®-Verbindung	Schließen Sie die App komplett (auch im Hintergrund). Schalten Sie Bluetooth® aus und wieder an. Schalten Sie das Smartphone aus und wieder an. Batterien in der Waage kurz entfernen und wieder einsetzen. Siehe FAQ bei www.beurer.com .
Verbindungsaufbau dauert zu lange	Schnellerer Bluetooth®intervall bei eingeschalteter Waage.

16. TECHNISCHE ANGABEN

Abmessungen der Waage	380 x 390 x 1000 mm
Batterien Waage	4 x 1,5V Typ AA
Messbereich	8 kg bis 200 kg
Displayanzeige:	Die Ablesbarkeit der Displayanzeige erfolgt in 0,05kg Schritten.
Wiederholgenauigkeit:	Die Messtoleranz bei Wiederholmessungen beträgt +/- 0,3kg (Messung mehrmals direkt hintereinander auf der selben Waage mit möglichst gleicher Standposition von Waage und Person).
Absolute Genauigkeit:	Der Messwert im Vergleich zu einem geeichten Gewicht beträgt +/- 0,5% +0,05kg. Z.B. bei 50kg entspricht dies +/- 0,3kg, bei 100kg entspricht dies +/- 0,55kg.
Datenübertragung per Bluetooth® wireless technology	Das Produkt verwendet Bluetooth® low energy technology, Frequenzband 2,402–2,480 GHz, Sendeleistung max. 0 dBm, kompatibel mit Bluetooth® 4.0 Smartphones / Tablets

Systemvoraussetzungen und Liste der kompatiblen Geräte
für die App „beurer HealthManager Pro“*



Technische Änderungen vorbehalten.

*Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen Richtlinien.
Wir bestätigen hiermit, dass dieses Produkt der europäischen RED Richtlinie 2014/53/EU entspricht.
Die CE-Konformitätserklärung zu diesem Produkt finden Sie unter:
<https://www.beurer.com/web/we-landingpages/de/cedclarationofconformity.php>

17. GARANTIE / SERVICE

Nähere Informationen zur Garantie und Garantiebedingungen finden Sie im mitgelieferten Garantie-Faltblatt.



Read these instructions for use carefully. Observe the warnings and safety notes. Keep these instructions for use for future reference. Make the instructions for use accessible to other users. If the device is passed on, provide the instructions for use to the next user as well.

Contents

1. Included in delivery	17	10. Evaluating the results	26
2. Signs and symbols	18	11. Transferring measurements via app	28
3. Warnings and safety notes	18	12. Additional information	28
4. Device description	20	13. Cleaning and maintenance	28
5. Initial use	21	14. Disposal	29
6. Configuring the diagnostic bathroom scale with an app ..	21	15. What if there are problems?	29
7. Alternatively: configuring the diagnostic bathroom scale without an app	22	16. Technical specifications	30
8. Carrying out the measurement	23	17. Warranty / service	30
9. Analysis of measured values	24		

Getting to know your device

Functions of the device

The purpose of this digital scale is weighing and calculating your personal fitness data.

It is intended for private use.

The scale is equipped with the following functions, which can be used by up to 10 different people:

- Body weight measurement
- Body fat percentage calculation
- Visceral fat percentage calculation (organ fat/abdominal fat)
- Body water content calculation
- Muscle percentage calculation
- Bone mass calculation
- Basal metabolic rate and active metabolic rate calculation.

The scale also includes the following additional features:

- Cross measurement with 8 electrodes allows for segment analysis, i.e. a separate display of individual body parts (arms, legs, torso)
- Innovative menu navigation on large display (in 5 languages),
- Switch between kilograms "kg", pounds "lb" and stones "st"
- Battery replacement display for low batteries
- Automatic user recognition
- Storage of the last 30 measurements for 10 users if the data cannot be transferred to the app
- Guest mode (without memory function).

The measurement principle

This scale works on the principle of B.I.A. (bioelectrical impedance analysis). This involves the calculation of body content in a matter of seconds, using a current that cannot be felt, is completely harmless and does not pose any risk.

When this measurement of the electrical resistance (impedance) is considered alongside constants and/or individual values (age, height, gender, activity level), the body fat percentage and other variables in the body can be calculated. Muscle tissue and water conduct electricity well and therefore have a lower resistance. In contrast, bones and fat tissue have low conductivity as the fat cells and bones are barely able to conduct the current due to very high levels of resistance.

The electrical contact to the body is enhanced through 4 hand electrodes and 4 foot electrodes to achieve a higher measurement accuracy and better analysis. This sensitive analysis technology means readings may change slightly when measurements are repeated. This is caused by changes during the impedance measurement (e.g. different electrical contact to the electrodes by the hands and feet, different distribution of water in the body).

Please note that the values calculated by the diagnostic bathroom scale only represent an approximation of the actual medical analytical values for the body. Only a specialist doctor can precisely establish the body fat, body water, muscle percentage and bone structure using medical methods (e.g. computer tomography).

1. INCLUDED IN DELIVERY


Check that the exterior of the cardboard delivery packaging is intact and make sure that all contents are present. Before use, ensure that there is no visible damage to the device or accessories and that all packaging material has been removed. If you have any doubts, do not use the device and contact your retailer or the specified Customer Service address.

- Diagnostic bathroom scale with raised display on aluminium stand
- 4 x 1.5V type AA batteries
- These instructions for use

- 2 x quick guide
- Mounting kit (4 screws with 2 replacement screws + Allen key)

2. SIGNS AND SYMBOLS

The following symbols are used on the device, in these instructions for use, on the packaging and on the type plate for the device:

 WARNING Indicates a potentially impending danger. If it is not avoided, death or serious injury will occur.			
	Product information Note on important information		United Kingdom Conformity Assessed Mark
	The device may not be used by people with medical implants (e.g. pacemakers), as this may affect their functionality.		Importer symbol
	CE labelling This product satisfies the requirements of the applicable European and national directives.		Manufacturer
	The products demonstrably meet the requirements of the Technical Regulations of the EAEU		Separate the product and packaging elements and dispose of them in accordance with local regulations.
	The electronic device must not be disposed of with household waste		Consult instructions for use
	Do not dispose of batteries containing hazardous substances with household waste		Marking to identify the packaging material. A = Material code, B = Material number: 1-7 = Plastics, 20-22 = Paper and cardboard
	Danger of slipping! Do not step on the scale if the surface or your feet are wet		Place the scale on a stable, level surface. Do not place the scale on a carpet.
	Danger of tipping! Do not stand on the outer edge.		

3. WARNINGS AND SAFETY NOTES

WARNING

- The device is only intended for weighing humans and for recording your personal fitness data. The device is only intended for private use and not for medical or commercial purposes. The device must only be used for the purpose for which it was designed and in the manner specified in these instructions for use.
- **The device may not be used by people with medical implants (e.g. pacemakers), as this may affect their functionality.**
- **Do not use the device during pregnancy.**
- **Danger of tipping!** Never place the scale on an uneven surface. Never step onto the outer edge of the scale on just one side.
- **Danger of slipping!** Do not step onto the scale with wet feet. Do not step onto the scale when the surface is wet. Do not step onto the scale wearing socks.
- Please note that measuring tolerances are possible for technical reasons as this scale is not calibrated for use in a professional medical context.
- Obtain professional advice from appropriately qualified personnel (e.g. a doctor) when undertaking any treatment or diet to address being overweight or underweight. The health values determined using the scale can assist the qualified personnel in their diagnoses.
- Inaccurate or implausible results may occur when determining body fat in children, performance athletes or people with medical/physical limitations (e.g. oedema symptoms, osteoporosis, people who are taking cardiovascular medication or medication which changes the vascular system, people with major anatomical abnormalities on the legs).
- Repairs may only be carried out by Beurer Customer Services or authorised retailers. Never open the scale yourself.



Safety notes on handling batteries

- Always insert the batteries correctly, taking into account the polarity (+ / -). Keep batteries clean and dry and away from water. Always select the correct battery type.
- Never short-circuit batteries and battery compartment contacts.
- Never charge, forcibly discharge, heat, disassemble, deform, encapsulate or modify batteries.
- Never weld or solder on batteries.
- Never mix batteries of different manufacturers, capacities (new and used), size and type within a device.
- **Risk of explosion!** Failure to comply with the points mentioned above can result in personal injury, overheating, leakage, venting, breakage, explosion or fire.
- If a battery has leaked, put on protective gloves and clean the battery compartment with a dry cloth.
- If your skin or eyes come into contact with battery fluid, rinse the affected areas with water and seek medical assistance.
- **Choking hazard!** Keep batteries out of the reach of children. Seek medical attention immediately if swallowed.
- Never allow children to replace batteries without adult supervision.
- Store batteries away from metal objects in a well-ventilated, dry and cool place.
- Never expose batteries to direct sunlight or rain.
- Remove batteries from the device if it is not going to be used for a long period of time.
- Dispose of discharged batteries immediately and properly. Never dispose of batteries in fire.
- When disposing of batteries, keep batteries with different electrochemical systems separate.


General notes

- The scale's maximum capacity is 200 kg (440 lb/31 st). The results for weight measurement are displayed in increments of 50 g (0.1 lb).
- Measurements of body fat, body water and muscle content are displayed in increments of 0.1%.
- The calorie requirement is indicated in increments of 1 kcal.
- When supplied to the customer, the scale is set to weigh and measure in "cm" and "kg". You can change the unit settings during initial use with the app.

General tips


- As far as possible, weigh yourself at the same time every day (ideally in the morning), after having been to the toilet, on an empty stomach and without clothing, in order to obtain results which can be compared.
- Important point regarding the measurement: the calculation of body fat may only be carried out using measurement with the hands and bare feet; the soles of the feet may be lightly dampened where appropriate.
- Results may be unsatisfactory if the soles of the feet are completely dry or have a large amount of hard skin since conductivity will be impaired.
- Stand up straight and still during measurement.
- Wait a few hours after any physical exertion to which your body is unaccustomed.
- Wait approx. 15 minutes after getting up so that the water stored in your body can disperse.
- Remember that only the long-term trend is important. Short-term changes in weight within a few days are normally caused by loss of fluids; however, body water plays an important role in terms of well-being.

4. DEVICE DESCRIPTION

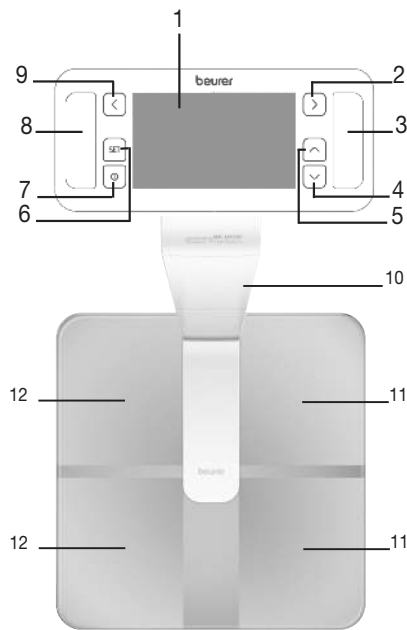

1. Display
2. > Menu: right button (sensor button)
3. Electrodes, right hand
4. < Menu: down button (sensor button)
5. ^ Menu: up button (sensor button)
6. [SET] Set button, confirm the entry (sensor button)
7. [ON/OFF] ON/OFF button (sensor button)
8. Electrodes, left hand
9. < Menu: left button (sensor button)
10. Aluminium stand
11. Foot electrodes, right foot
12. Foot electrodes, left foot

Display

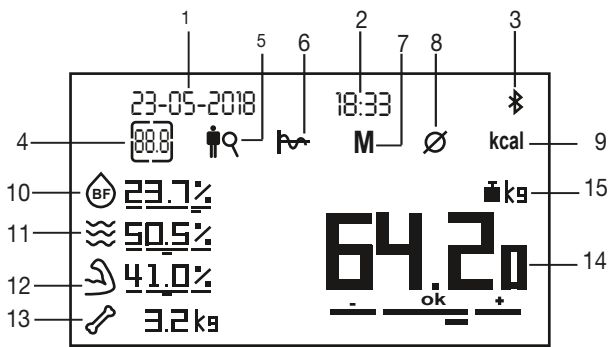


1. Date	2. Time
3. Bluetooth®	4. General overview
5. Segment analysis	6. Graphic representation
7. User memory	8. Average values
9. Calorie consumption	10. Body fat percentage with interpretation
11. Body water content with interpretation	12. Muscle percentage with interpretation
13. Bone mass with interpretation	14. Body weight with BMI interpretation
15. Weight unit (kg, lb or st)	


5. INITIAL USE

Positioning the scale


Place the scale on a flat and stable surface. A solid surface is a prerequisite for a precise measurement.

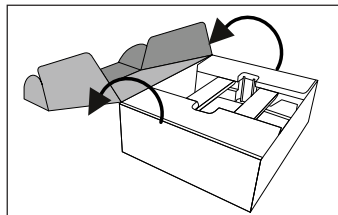


1. Open the cardboard box.

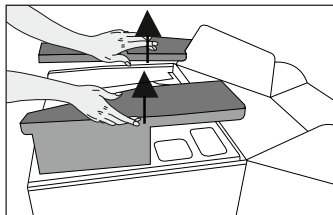


2. Remove the polystyrene cover on the left and right.

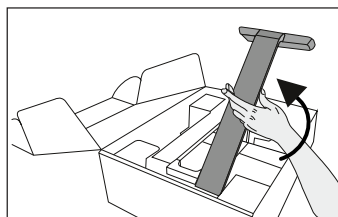


3. Lift up the upper and lower part of the aluminium stand at the same time.

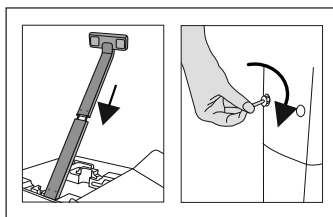


4. Insert the upper part of the aluminium stand into the lower part and secure with screws at the top.

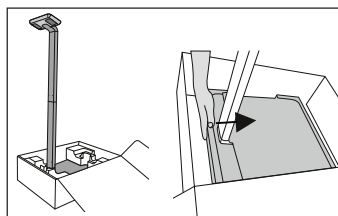


5. Position the aluminium stand upright in the cardboard box. Slide the scale to the edge...

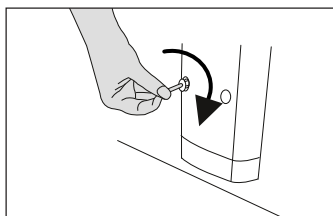

6. ...and secure with screws at the bottom.

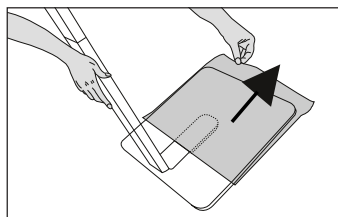

7. Hold the stand in place with one hand and remove the film with the other.

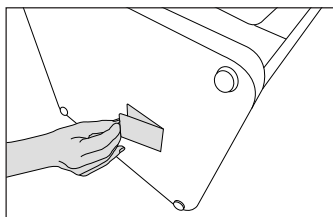

8. Insert batteries the correct way round in the underside of the scale (+/-). Stand the scale upright on a flat surface.

6. CONFIGURING THE DIAGNOSTIC BATHROOM SCALE WITH AN APP

To calculate your body fat percentage and additional body values, you must save the personal user data on the scale.

The scale has 10 user memory spaces which allows, for example, you and your family members to save personal settings.

It is also possible to activate users via other mobile end devices on which the "beurer HealthManager Pro" app has been installed or by changing the user profile in the app (see the app settings).

Keep the smartphone close to the scale in order to maintain an active *Bluetooth®* connection during initial use.

- **Activate *Bluetooth®* in your smartphone's settings.**
- **Download the free "beurer HealthManager Pro" app from the Apple App Store (iOS) or from Google Play (Android™).**
- **Start the app and follow the instructions.**
 - The following settings must be set or entered in the "beurer HealthManager Pro" app:

User data	Set values												
Initials	Max. 3-digit (A-Z, 0-9)												
Gender	Male (♂), female (♀)												
Height	100 to 250 cm (3' 03" to 8' 02")												
Date of birth	Year, month, day												
Activity level	The medium-term and long-term perspective is decisive when selecting the activity level:												
	<table><tr><td></td><td>Physical activity</td></tr><tr><td>1</td><td>None.</td></tr><tr><td>2</td><td>Low: little and light physical exertion (e.g. going for walks, light gardening, simple gymnastics).</td></tr><tr><td>3</td><td>Medium: physical exertion, at least 2 to 4 times a week for 30 minutes each.</td></tr><tr><td>4</td><td>High: physical exertion, at least 4 to 6 times a week for 30 minutes each.</td></tr><tr><td>5</td><td>Very high: intensive physical exertion, intensive training or hard physical work for at least 1 hour every day.</td></tr></table>		Physical activity	1	None.	2	Low: little and light physical exertion (e.g. going for walks, light gardening, simple gymnastics).	3	Medium: physical exertion, at least 2 to 4 times a week for 30 minutes each.	4	High: physical exertion, at least 4 to 6 times a week for 30 minutes each.	5	Very high: intensive physical exertion, intensive training or hard physical work for at least 1 hour every day.
		Physical activity											
	1	None.											
	2	Low: little and light physical exertion (e.g. going for walks, light gardening, simple gymnastics).											
	3	Medium: physical exertion, at least 2 to 4 times a week for 30 minutes each.											
4	High: physical exertion, at least 4 to 6 times a week for 30 minutes each.												
5	Very high: intensive physical exertion, intensive training or hard physical work for at least 1 hour every day.												
Target weight	kg/lb/st (for progress graph)												

- The app assigns the next free user memory space (person 1 to person 10) to you.
- Carrying out the measurement: For automatic personal recognition, the first measurement must be assigned to your personal user data. The app will prompt you to do this. For how to do this, please see chapter "8. Carrying out the measurement".

7. ALTERNATIVELY: CONFIGURING THE DIAGNOSTIC BATHROOM SCALE WITHOUT AN APP

We recommend using the app for the initial use and implementing all settings. See chapter "6. Configuring the diagnostic bathroom scale with an app". However, this can also be carried out on the device itself.
Specify device/time/user settings on the control unit. To do so, use the [] and [] buttons to make your selection and confirm with [SET] respectively.

a.) Setting the time

[SET] → "SET TIME" → [SET]

Sequence	Set values
Date	Year–Month–Day
Time	Hours–Minutes

b.) Specifying device settings

[SET] → "SET UNIT" → [SET]

Sequence	Set values
Language	    
Measurement unit	kg–lb–st
Time	24 h–12 h
Guest mode	ON–OFF
<i>Bluetooth®</i>	ON–OFF  When set to "OFF", a <i>Bluetooth®</i> connection is only possible if the scale is switched on. This can be useful for extending the battery life or to prevent undesirable radio radiation.

c.) Setting user data

[SET] → "SET USER" → [SET]

User data	Set values
Initials	Max. 3-digit (A-Z, 0-9)
Gender	Male (♂), female (♀)
Height	100 to 250 cm (3' -03" to 8' -02")
Date of birth	Year, month, day
Activity level	1 to 5 (see section 6)
Target weight	kg/lb/st (for progress graph)
User PIN	Assigned automatically for Bluetooth® use at a later time. This information is only required for app set-up in the future, if existing scale users are to be added during app installations at a later time.



Logging in to the app at a later time

If you have carried out the initial use of the scale without using the app, you can add your existing scale user to the "beurer HealthManager Pro" app. This requires you to enter your 4-digit user "PIN". This process is described in the app.

8. CARRYING OUT THE MEASUREMENT

8.1 Body weight measurement

- Press the button on the control unit. „0.0“ kg appears in the display.
- The scale is then ready to take a weight measurement. To measure your weight, step onto the scale with your weight distributed evenly on both feet. The weight data will not be stored; user allocation will not be possible, as there is no BIA measurement via the hands or feet.

8.2 Carrying out guest measurement

For one-time measurement or if no user data is to be stored. For this, guest mode must be switched on in the device settings.

[>] → "Guest" → [SET] or switch scale on


User data	Set values
Gender	Male (♂), female (♀)
Height	100 to 250 cm (3' -03" to 8' -02")
Date of birth	Year, month, day
Activity level	1 to 5 (see section 6)

8.3 User measurement, total body analysis

- Press the button on the control unit. „0.0“ kg appears in the display.
- If guest mode has been activated in the scale settings, step onto the scale when it is switched off.
- Stand on the scale barefoot holding the control unit in your hands. Hold the control unit with the underside of your thumbs on the front electrodes and with your fingers pressed firmly against the back electrodes.
- Stand still with your weight distributed equally on both feet. Make sure there is no skin contact between your two feet, legs, calves and thighs.



- If the scale recognises you automatically, the impedance for the analysis will be measured after the weight measurement. This is indicated by the symbol showing current passing through the body.
- As soon as the total body analysis is complete, the overview will be shown. The measurement is automatically stored.




Initials

Segment analysis

**Note:**

The measurement will not be saved if the following applies:


- The user is not automatically detected. This happens if your measured weight differs from the previous measurement by +/- 3 kg or if another user has similar values (+/- 3 kg) to yours. In this case, press the [] button to select the user manually and to carry out the measurement again.
- The user is standing on the scale with shoes on.
- The user is not holding the handheld unit with their hands.

9. ANALYSIS OF MEASURED VALUES


The results will be analysed automatically after taking the measurement or after selecting the user manually on the control unit. Select your user using the [] button. Confirm using the [SET] button or wait 3 seconds.

**General overview**


The general overview appears at a glance in the display either before or after a total body analysis for your user.

**Segment analysis for body fat and muscle percentage****a) Body fat in left and right arm**


- Press the menu button [] until is selected. The segment analysis for body fat in the left and right arm appears in the display.

**b) Body fat in left and right leg**


- Use the [] button to select the detailed display of body fat for the left and right leg.

**c) Body fat in the torso**


- Use the [] button to select the detailed display of body fat in the torso.


**d) Visceral fat (organ fat/abdominal fat)**

- Use the [] button to select the detailed display of visceral fat.

**e) Muscle percentage in left and right arm**





- Use the [] button to select the detailed display of muscle percentage in the left and right arm.




f) Muscle percentage in left and right leg 1. Use the [] button to select the detailed display of muscle percentage in the left and right leg.	
g) Muscle percentage in torso • Use the [] button to select the detailed display of muscle percentage in the torso.	

 No visceral fat or muscle percentages in specific segments of the body (arm/leg/torso) will be displayed for users aged 10 – 17 years.


Graphic representation

a) Body weight • Press the menu button [] until  is selected. The trend for your body weight appears in the display. The trend for your body weight is shown from measurement to measurement. Later measurements are added on the right. The reference line shows your target weight.  You can change your target weight in the user data at any time.	
b) Body fat  • Use the [] button to switch to showing body fat values  . The trend for your body fat values is shown from measurement to measurement. The reference line represents the average value for all body fat measurements; the bars show whether the values have gone up or down.	
c) Water proportion  • Use the [] button to switch to showing water proportion  . The trend for your body's water proportion is shown from measurement to measurement. The reference line represents the average value for all water proportion measurements; the bars show whether the values have gone up or down.	
d) Muscle percentage  • Use the [] button to switch to showing muscle percentage  . The trend for your muscle percentage is shown from measurement to measurement. The reference line represents the average value for all muscle percentage measurements; the bars show whether the values have gone up or down.	

M Showing stored measurements

• Press the menu button [] until M is selected. The most recent measured stored measurement appears in the display. The measurement date and the memory space number are shown at the top, e.g. (03-03) means the third memory space = the last of a total of 3 occupied memory spaces. • Use the [], [] buttons to cycle through the memory spaces.	
---	--

Average values

• Press the menu button [] until  is selected. All average values in the stored measurements are shown in the display.  The dates of the first and the last measurement are shown at the top.	
--	--

kcal Calorie consumption

- Press the menu button [>] until **kcal** is selected. The theoretically calculated basal metabolic rate BMR and the active metabolic rate AMR are shown in Kcal.

23-05-2021 18:33



BMR: **1499** KCAL
AMR: **2248** KCAL

Switching off the scale (standby mode)

- Wait until the display switches itself off or press the [⏻] button on the control unit to switch the display off manually. The date and time remain visible.

10. EVALUATING THE RESULTS

Body fat percentage

Body fat values are shown in the display and analysed with the bar chart. The subsequent body fat percentages serve as a guideline (for further information ask your doctor).

Male

-- ak +				
Age	Low	Normal	High	Very high
10-14	<11 %	11-16 %	16.1-21 %	>21 %
15-19	<12 %	12-17 %	17.1-22 %	>22 %
20-29	<13 %	13-18 %	18.1-23 %	>23 %
30-39	<14 %	14-19 %	19.1-24 %	>24 %
40-49	<15 %	15-20 %	20.1-25 %	>25 %
50-59	<16 %	16-21 %	21.1-26 %	>26 %
60-69	<17 %	17-22 %	22.1-27 %	>27 %
70-100	<18 %	18-23 %	23.1-28 %	>28 %

Female

- ak +				
Age	Low	Normal	High	Very high
10-14	<16 %	16-21 %	21.1-26 %	>26 %
15-19	<17 %	17-22 %	22.1-27 %	>27 %
20-29	<18 %	18-23 %	23.1-28 %	>28 %
30-39	<19 %	19-24 %	24.1-29 %	>29 %
40-49	<20 %	20-25 %	25.1-30 %	>30 %
50-59	<21 %	21-26 %	26.1-31 %	>31 %
60-69	<22 %	22-27 %	27.1-32 %	>32 %
70-100	<23 %	23-28 %	28.1-33 %	>33 %

Values will often be lower for fitness enthusiasts. Depending on the sporting activities performed, the training intensity and the physical constitution, the results may still be below the stated standard values. Please note, however, that there may be a risk to health in the case of extremely low values.

Visceral fat (organ fat/abdominal fat)

Visceral fat denotes fat that surrounds the internal organs within the abdominal cavity. Visceral fat is suspected of contributing to conditions such as high blood pressure or diabetes.

Visceral fat is shown in the display as a value between 1 and 59.

Visceral fat percentage value	Rating
1-12	Your visceral fat percentage is in the normal range.
13-59	Your visceral fat percentage is too high.

Body water content

The body water content in % is normally within the following ranges:

Male

-- ak +			
Age	Poor	Good	Very good
10-100	<50 %	50-65 %	>65 %

Female

-- ak +			
Age	Poor	Good	Very good
10-100	<45 %	45-60 %	>60 %

Body fat contains relatively little water, therefore body water content may be below the standard values in persons with a high body fat percentage. On the other hand, endurance athletes may exceed the standard values due to having low levels of fat and a high muscle percentage.

The body water calculation performed using this scale is not suitable for drawing medical conclusions, for example in the case of age-related water retention. Consult your doctor where necessary. A high body water content is generally desirable.

Muscle percentage

The muscle percentage measurement measures the skeletal muscle mass. No organ muscles are taken into account. The muscle percentage is normally within the following ranges:

Male			
			
Age	Low	Normal	High
10-14	<44%	44–57 %	>57 %
15-19	<43%	43–56 %	>56 %
20-29	<42%	42–54 %	>54 %
30-39	<41%	41–52 %	>52 %
40-49	<40%	40–50 %	>50 %
50-59	<39%	39–48 %	>48 %
60-69	<38%	38–47 %	>47 %
70-100	<37%	37–46 %	>46 %

Female			
			
Age	Low	Normal	High
10-14	<36%	36–43 %	>43 %
15-19	<35%	35–41 %	>41 %
20-29	<34%	34–39 %	>39 %
30-39	<33%	33–38 %	>38 %
40-49	<31%	31–36 %	>36 %
50-59	<29%	29–34 %	>34 %
60-69	<28%	28–33 %	>33 %
70-100	<27%	27–32 %	>32 %

Bone mass

Like the rest of our body, our bones are subject to natural growth, shrinking and ageing processes. Bone mass increases rapidly during childhood and reaches its peak between the ages of 30 and 40. As we age, our bone mass then begins to reduce. You can combat this reduction to an extent with the help of a healthy diet (particularly calcium and vitamin D) and regular physical exercise. The stability of the skeleton can be further increased by means of targeted muscle build-up. Note that this scale identifies the mineral content of the bone. It is very difficult to influence the bone mass, although it does fluctuate within the scope of influencing factors (weight, height, age, gender). There are no recognised guidelines or recommendations.



Please do not confuse bone mass with bone density. The bone density can only be determined by means of a medical examination (e.g. computer tomography, ultrasound). It is therefore not possible to draw conclusions on changes to bones and bone hardness (e.g. osteoporosis) using this scale.

BMR

The basal metabolic rate (BMR) is the amount of energy required by the body at complete rest in order to maintain its basic functions (e.g. lying in bed 24 hours a day). This value is primarily dependent on weight, height and age. It is displayed on the diagnostic scale in the unit kcal/day and calculated using the scientifically recognised Mifflin St. Jeor equation. This is the amount of energy that is required by your body under all circumstances and must be re-supplied to the body in the form of food. If your energy intake is below this level in the longer term, this can result in damage to health.

AMR

The active metabolic rate (AMR) is the amount of energy that the active body consumes each day. An individual's energy requirement increases when the level of physical activity increases; the diagnostic bathroom scale calculates this by means of the activity level (1–5) that has been entered. To maintain the current weight, the energy that the body uses must be replaced in the form of food and drink. If less energy is taken in than is used over a long period of time, the body primarily takes the difference from the fat stores with resulting weight loss. However, if the amount of energy taken in exceeds the calculated active metabolic rate (AMR) for a longer period, the body cannot burn off the excess energy. The excess is stored in the body as fat, leading to weight gain.

Temporal context of the results



Please note that only the long-term trend is significant. Brief deviations in weight within a few days are normally caused by loss of fluids.

The interpretation of the results is based on changes in total body weight, percentage of body fat, body water and muscle content, as well as on the length of time over which these changes occur. Rapid changes within the scope of a few days are to be considered separately from medium-term changes (in the scope of weeks) and long-term changes (months). It can be said as a basic rule that short-term changes in weight are almost entirely changes in water content, whereas medium-term and long-term changes may also relate to the fat percentage and the muscle percentage.

- If your weight drops in the short term but your body fat percentage increases or stays the same, you have only lost water, for example following a training session, visit to the sauna or a diet aimed only at fast weight loss.

- On the other hand, if your weight increases in the medium term and your body fat percentage drops or stays the same, you may have built up valuable muscle mass.
- If your weight and body fat percentage both fall at the same time, then your diet is working—you are losing fat mass.
- Ideally, you should support your diet with physical activity, fitness or strength training. This enables you to increase your muscle percentage in the medium term.
- Body fat, body water and muscle percentages should not be totalled (muscle tissue also contains components made of body water).

11. TRANSFERRING MEASUREMENTS VIA APP

If the app is not open, the newly assigned measurements are saved on the scale. A maximum of 30 measurements per user can be saved on the scale. The saved measurements are transferred automatically to the app when you open the app within the *Bluetooth®* range. It is possible to automatically transfer data when the scale is switched off if *Bluetooth®* is enabled in the device settings.

12. ADDITIONAL INFORMATION

Deleting scale data

a) Delete user with all settings and saved values

- After switching on, select your user by pressing the [] button. If necessary, press the button several times and confirm with [SET].
- When **0.0** appears in the display, hold down the [SET] button for 12 seconds to delete the user.
- Use the [], [] buttons to select “YES” and confirm the prompt using the [SET] button. If you do not want to delete the user, confirm “NO” using the [SET] button.



All saved values and settings for this user will be deleted.

b) Delete individual saved value for a user

- Select a measured value in the user memory [M] and briefly press the [SET] button on the control unit to delete the stored value displayed.
- You can also do this immediately after the measurement is taken.
- Use the [], [] buttons to select “YES” and confirm the prompt using the [SET] button. If you do not want to delete the value, confirm “NO” using the [SET] button.

c) Delete all stored values for a user

- Open the user memory [M] and press the [SET] button on the control unit for around 5 seconds to delete all values.
- Use the [], [] buttons to select “YES” and confirm the prompt using the [SET] button. If you do not want to delete, confirm “NO” using the [SET] button.

Changing the batteries

The control unit has a low battery indicator. “LOW BATTERY” appears in the display if the batteries in the scale are too weak. In this case, the batteries should be replaced. Connect the scale to the app again. The system time is updated.



Note:

- When replacing the batteries, use batteries of the same type, make and capacity.
- Do not use rechargeable batteries.
- Use batteries free from heavy metals.

13. CLEANING AND MAINTENANCE

Clean the surface of the scale from time to time using a slightly damp cloth. Do not use the scale again until the surface is completely dry.

**Note:**

- Do not use any abrasive cleaning products.
- Never submerge the scale in water. Never rinse the scale under running water.
- Do not place any objects on the scale when it is not in use.
- Protect the scale from knocks, moisture, dust, chemicals, drastic changes in temperature and nearby sources of heat (ovens, heaters).

14. DISPOSAL

Empty, completely flat batteries must be disposed of through specially designated collection boxes, recycling points or electronics retailers. You are legally required to dispose of the batteries.

The codes below are printed on batteries containing harmful substances:

Pb = Battery contains lead,

Cd = Battery contains cadmium,

Hg = Battery contains mercury.

For environmental reasons, do not dispose of the device in the household waste at the end of its service life. Dispose of the device at a suitable local collection or recycling point in your country.

Dispose of the device in accordance with EC Directive – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). If you have any questions, please contact the local authorities responsible for waste disposal.

**15. WHAT IF THERE ARE PROBLEMS?**

If the scale encounters an error during measurement, the following is displayed:

Display	Cause	Solution
„ERROR:_OVER-LOAD“	Maximum weight capacity of 200 kg exceeded.	Loads must be limited to 200 kg.
„LOW_BATTERY“	Batteries are nearly flat.	Replace the batteries (see section on changing the batteries).
„MEMORY_FULL“	30 measurements have been stored.	Transfer the measured values.
„ERROR:_CONTACT“ „ERROR“	The electrical resistance between the electrodes and the soles of the feet is too high (e.g. with very hard skin).	Repeat the measurement barefoot. Dampen the soles of your feet slightly. If necessary, remove hard skin on the soles. Hold the hand electrodes with the fingers behind and the balls of the thumb in front.
„ERROR:_DATA“	The BIA measurement was successful, but the fat percentage is outside the measurable range (less than 3% or greater than 65%).	Please repeat the measurement barefoot, or with the soles of the feet lightly dampened if necessary. If necessary, change your set activity level.
Empty display	Batteries are completely flat.	Replace the batteries (see section on changing the batteries).
	The batteries are not inserted properly.	Check for correct polarity, (see “Initial use” -> “Changing the batteries”).
Only weight is displayed, no diagnosis	Unknown measurement as it is outside the user assignment limit or a unique assignment is not possible.	Select user on the scale using the [] button or repeat user assignment in the app. Hold the electrodes of the handheld unit and stand barefoot on the scales.

Incorrect weight measurement

Possible faults	Solution
Incorrect zero point of scale.	Switch the scale on, wait approx. 5 seconds and repeat the measurement.
Scale is on a carpet.	Place the scale on a flat, solid surface. Stand on the outside of the scale as far as possible without it tipping.
Incorrect weight is displayed.	Stand as still as possible.
Incorrect weight is displayed.	Wait until the scale switches itself off. Then repeat the measurement.

No Bluetooth® connection (⌘ symbol is missing)

Possible faults	Solution
Radio connection	The range in the open is approx. 10 m. Walls and ceilings reduce the range. Other radio waves may interfere with the transmission. Therefore, do not position the scale near devices such as WIFI routers, microwaves, induction hobs etc.
Bluetooth® connection	Completely close the app (including in the background). Switch Bluetooth® off and back on again. Switch the smartphone off and back on again. Remove the batteries in the scale for a short period and reinsert them. See FAQs at www.beurer.com .
Connection set-up taking too long	Faster Bluetooth® interval when the scale is switched on.

16. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Scale dimensions	380 x 390 x 1000 mm
Scale batteries	4 x 1.5V type AA
Measurement range	8 kg to 200 kg
Display:	The display can be read in increments of 0.05 kg.
Repetition accuracy:	The measuring tolerance for repeated measurements is +/- 0.3 kg (several measurements in direct succession on the same scale with position of scale and person the same as far as possible).
Absolute precision:	In comparison with a calibrated weight, the measured value is +/- 0.5% +0.05 kg. E.g. at 50 kg this corresponds to +/- 0.3 kg; at 100 kg this corresponds to +/-0.55 kg.
Data transfer via Bluetooth® wireless technology	This product uses Bluetooth® low energy technology, frequency band 2.402–2.480 GHz, transmission power max. 0 dBm, compatible with Bluetooth® 4.0 smartphones/tablets

System requirements and list of compatible devices for the "beurer HealthManager Pro" app*



Subject to technical changes.

*This product satisfies the requirements of the applicable European directives.
We hereby confirm that this product complies with the European RED Directive 2014/53/EU.
The CE Declaration of Conformity for this product can be found under:
<https://www.beurer.com/web/we-landingpages/de/cedclarationofconformity.php>

17. WARRANTY / SERVICE

Further information on the warranty and warranty conditions can be found in the warranty leaflet supplied.



Lisez attentivement l'intégralité de ce mode d'emploi. Veuillez lire les avertissements et mises en garde. Conservez le mode d'emploi pour un usage ultérieur. Mettez le mode d'emploi à la disposition des autres utilisateurs. En cas de transmission de l'appareil à un tiers, remettez-lui également le mode d'emploi.

Sommaire

1. Contenu	31	9. Analyse des valeurs de mesure	38
2. Symboles utilisés	32	10. Évaluation des résultats	40
3. Consignes d'avertissement et de mise en garde	32	11. Transfert des mesures via l'application	42
4. Description de l'appareil	34	12. Plus d'informations	42
5. Mise en service	35	13. Nettoyage et entretien	42
6. Utiliser le pèse-personne impédancemètre avec l'application	35	14. Élimination	43
7. Alternative : Utiliser le pèse-personne impédancemètre sans l'application	36	15. Que faire en cas de problèmes ?	43
8. Effectuer la mesure	37	16. Caractéristiques techniques	44
		17. Garantie/Maintenance	44

Familiarisation avec l'appareil

Fonctions de l'appareil

Ce pèse-personne impédancemètre numérique sert à la fois à vous peser et à calculer vos données personnelles de fitness. Il est conçu pour être utilisé dans un cercle privé.

Le pèse-personne dispose des fonctions suivantes pouvant être utilisées par un maximum de 10 personnes :

- mesure du poids,
- du taux de graisse corporelle,
- de la graisse viscérale (graisse abdominale/graisse du ventre),
- du taux d'eau corporelle,
- du taux de masse musculaire,
- de la masse osseuse et
- du volume de base et volume d'activité.

Le pèse-personne dispose en outre des fonctionnalités suivantes :

- mesure croisée grâce à 8 électrodes permettant une analyse sectorielle, c.-à-d. une vue séparée des différentes parties du corps (bras, jambes, torse),
- guidage par menus innovant sur grand écran (disponible en 5 langues),
- conversion entre kilogramme « kg », livre « lb » et stone « st »,
- affichage du changement de piles en cas de piles faibles,
- reconnaissance automatique de l'utilisateur,
- enregistrement des 30 dernières mesures pour 10 personnes, si le transfert vers l'application est impossible,
- mode invité (sans fonction d'enregistrement).

Le principe de mesure

Ce pèse-personne fonctionne selon le principe de la B.I.A., l'analyse bioélectrique de l'impédance. À cet effet, un courant imperceptible, absolument sans risque et sans danger, permet de connaître en quelques secondes le taux des éléments corporels. La mesure de la résistance électrique (impédance) ainsi que la prise en compte de constantes ou de données individuelles (âge, taille, sexe, activité physique) permettent de définir le taux de graisse corporelle et d'autres paramètres physiques. Le tissu musculaire et l'eau ont une bonne conductibilité électrique et présentent donc une faible résistance. Par contre, les os et le tissu adipeux ont une faible conductibilité, car les os et les cellules adipeuses sont très peu conducteurs en raison de leur résistance très élevée. Le contact électrique avec le corps est optimisé au moyen de 4 électrodes « main » et de 4 électrodes « pied », afin d'obtenir une meilleure précision de mesure et donc une meilleure analyse. En raison de la sensibilité de la technique d'analyse, il est possible que les valeurs se modifient légèrement lors de mesures répétées. Cela s'explique par les écarts lors de la mesure de l'impédance (p. ex. contact électrique différent par rapport aux électrodes avec les mains et les pieds, autre répartition de la masse hydrique dans le corps).

Notez que les valeurs déterminées par le pèse-personne impédancemètre ne représentent que des approximations par rapport aux analyses physiques effectives d'ordre médical. Seul un spécialiste équipé de matériel médical (par exemple un tomodynamomètre) est en mesure de déterminer précisément la graisse corporelle, l'eau corporelle, la masse musculaire et la masse osseuse.

1. CONTENU

Vérifiez si l'emballage carton extérieur du kit est intact et si tous les éléments sont inclus. Avant l'utilisation, assurez-vous que l'appareil et les accessoires ne présentent aucun dommage visible et que la totalité de l'emballage a bien été retirée. En cas de doute, ne l'utilisez pas et adressez-vous à votre revendeur ou au service client indiqué.

- Pèse-personne impédancemètre avec écran surélevé sur montant en aluminium
- 4 piles AA 1,5 V
- Le présent mode d'emploi
- 2 manuels abrégés
- Kit de montage (4 vis avec 2 vis de rechange + clé Allen)

2. SYMBOLES UTILISÉS

Les symboles suivants sont utilisés sur le mode d'emploi, sur l'emballage et sur la plaque signalétique de l'appareil :

⚠ AVERTISSEMENT			
Désigne un danger potentiel. S'il n'est pas évité, il peut entraîner la mort ou des blessures graves.			
	Information sur le produit Indication d'informations importantes		Marquage de conformité UKCA
	L'appareil ne doit pas être utilisé par des personnes portant des implants médicaux (p. ex. stimulateur cardiaque). Sinon, leur fonctionnement pourrait être altéré.		Symbole de l'importateur
	Signe CE Ce produit répond aux exigences des directives européennes et nationales en vigueur.		Fabricant
	Les produits sont complètement conformes aux exigences des règlements techniques de l'UEEA.		Séparer le produit et les composants d'emballage et les éliminer conformément aux prescriptions communales.
	Les appareils (électriques) ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères		Consulter le mode d'emploi
	Ne pas jeter les piles à substances nocives avec les déchets ménagers		Étiquette d'identification du matériau d'emballage. A = Abréviation de matériau, B = Référence de matériau : 1 – 7 = plastique, 20 – 22 = papier et carton
	Risque de glissade ! Ne pas monter sur le pèse-personne s'il est mouillé		Posez la balance sur un sol plat et dur. Ne posez pas le pèse-personne sur un tapis.
	Risque de basculement ! Ne montez pas sur le bord.		

3. CONSIGNES D'AVERTISSEMENT ET DE MISE EN GARDE

⚠ AVERTISSEMENT

- L'appareil est uniquement destiné à peser des personnes et à enregistrer vos données personnelles de fitness. L'appareil est prévu pour un usage strictement personnel et non pas pour une utilisation à des fins médicales ou commerciales. N'utilisez l'appareil qu'aux fins pour lesquelles il a été conçu et conformément aux indications données dans ce mode d'emploi.
- **L'appareil ne doit pas être utilisé par des personnes portant des implants médicaux (p. ex. stimulateur cardiaque). Sinon, leur fonctionnement pourrait être altéré.**
- **N'utilisez pas l'appareil pendant une grossesse.**
- **Risque de basculement !** Ne posez jamais le pèse-personne sur une surface non plane. Ne vous tenez pas sur le bord extérieur du pèse-personne.
- **Risque de glissade !** Ne montez pas sur le pèse-personne les pieds mouillés. Ne montez pas sur le pèse-personne si la surface est humide. Ne montez pas sur le pèse-personne avec des chaussettes.
- Notez que des tolérances de mesure techniques sont possibles, car il ne s'agit pas d'un pèse-personne calibré destiné à un usage professionnel ou médical.
- Pour chaque traitement ou régime de surpoids ou de sous-poids, un conseil qualifié doit être prodigué par du personnel spécialisé (p. ex. un médecin). Les valeurs obtenues à l'aide du pèse-personne peuvent être consultées par le personnel qualifié.



- En cas d'enfants, de sportifs de haut niveau ou de personnes présentant des limitations médicales/corporelles (p. ex. symptômes d'œdème, ostéoporose, prise en cas de médecine cardiovasculaire ou vasculaire, personnes présentant des écarts anatomiques importants au niveau des jambes), des résultats imprécis ou non plausibles peuvent apparaître lors de la détermination de la graisse corporelle.
- Seul le service client Beurer ou un opérateur autorisé peut procéder à une réparation. N'ouvrez jamais le pèse-personne vous-même.

Consignes de sécurité relatives aux piles

- Insérez toujours les piles correctement, en tenant compte des polarités (+/-). Maintenir les piles propres et sèches et les maintenir à l'abri de l'eau. Toujours choisir le type de pile correct.
- Ne jamais court-circuiter les piles et les contacts du compartiment à piles.
- Ne jamais charger, décharger de force, chauffer, démonter, déformer, encapsuler ou modifier les piles.
- Ne jamais souder ni braser sur les piles.
- Ne jamais mélanger des piles de différentes fabrications, capacités (neuves et usagées), tailles et types au sein d'un même appareil.
- **Risque d'explosion !** Le non-respect de ces consignes peut entraîner des blessures, une surchauffe, une fuite, une évacuation, une rupture, une explosion ou un incendie.
- Si une pile a coulé, enfiler des gants de protection et nettoyer le compartiment à piles avec un chiffon sec.
- Si du liquide de la cellule de pile entre en contact avec la peau ou les yeux, rincer la zone touchée avec de l'eau et consulter un médecin.
- **Risque d'ingestion !** Conserver les piles hors de portée des enfants. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin.
- Ne laissez pas les enfants changer les piles sans la surveillance d'un adulte.
- Stocker les piles à l'écart d'objets métalliques, dans des locaux frais, secs et bien aérés.
- Ne pas exposer les piles à la lumière directe du soleil ou à la pluie.
- En cas de non-utilisation prolongée, retirer les piles de l'appareil.
- Jeter immédiatement et correctement les piles déchargées. Ne jamais jeter les piles dans le feu.
- Lors de la mise au rebut, les piles doivent être stockées séparément des différents systèmes électrochimiques.


Recommandations générales

- La résistance maximale du pèse-personne est de 200 kg (440 lb, 31 st). Les résultats lors de la mesure du poids sont affichés par graduations de 50 g (0,1 lb).
- Les résultats de mesure des parts de graisse corporelle, d'eau corporelle et de muscle s'affichent par graduations de 0,1 %.
- Le besoin calorique est donné par graduations de 1 kcal.
- À la livraison du pèse-personne, le réglage des unités est en « cm » et « kg ». Lors de la mise en service, vous pouvez modifier les réglages des unités à l'aide de l'application.

Conseils généraux


- Pesez-vous, si possible, à la même heure (de préférence le matin), après être passé aux toilettes, à jeun et nu(e) afin d'obtenir des résultats comparables.
- Important lors de la mesure : la détermination de la graisse corporelle doit toujours être faite pieds nus et par mesure manuelle ; si nécessaire, elle peut s'effectuer la plante des pieds légèrement humide.
- Il se peut que les mesures effectuées avec les pieds complètement secs ne conduisent pas à des résultats satisfaisants, car leur conductibilité est trop faible.
- Tenez-vous droit et ne bougez pas pendant la mesure.
- Attendez quelques heures après un effort physique inhabituel.
- Attendez 15 minutes environ après le lever avant de faire la mesure pour que l'eau puisse se répartir dans le corps.
- Il est important de noter que seule compte la tendance à long terme. Des écarts de poids de courte durée enregistrés en l'espace de quelques jours ne sont dus qu'à une simple perte de liquides dans la plupart des cas ; l'eau corporelle joue un rôle important dans le bien-être.

4. DESCRIPTION DE L'APPAREIL

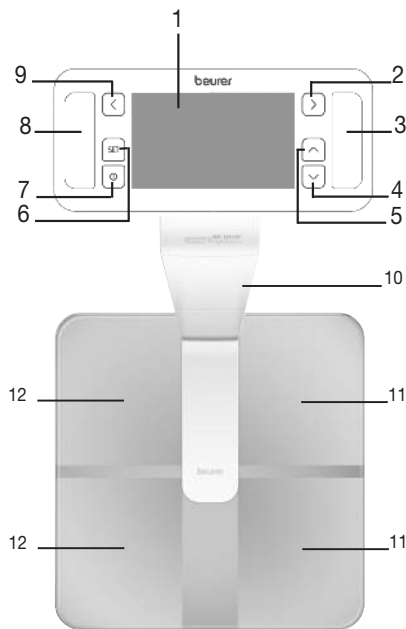

1. Écran
2. > Menu : Touche droite (Touche sensitive)
3. Électrodes pour la main droite
4. < Menu : Touche bas (Touche sensitive)
5. ^ Menu : Touche haut (Touche sensitive)
6. [SET] Touche de réglage, pour confirmer les saisies (Touche sensitive)
7. [ON/OFF] Touche ON/OFF (Touche sensitive)
8. Électrodes pour la main gauche
9. < Menu : Touche gauche (Touche sensitive)
10. Montant en aluminium
11. Électrodes pour le pied droit
12. Électrodes pour le pied gauche

Écran

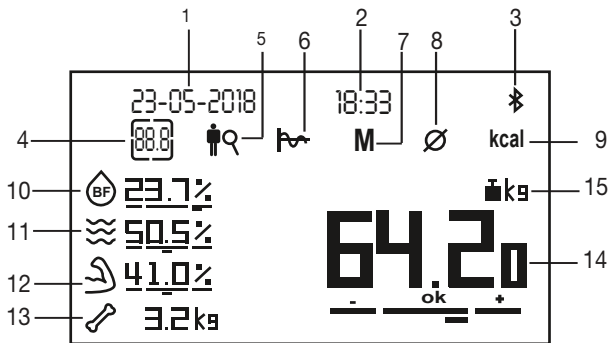


1. Date	2. Heure
3. Bluetooth®	4. Vue d'ensemble
5. Analyse sectorielle	6. Représentation graphique
7. Mémoire utilisateur	8. Valeur moyenne
9. Consommation de calories	10. Taux de graisse corporelle avec interprétation
11. Taux d'eau corporelle avec interprétation	12. Masse musculaire avec interprétation
13. Masse osseuse avec interprétation	14. Poids avec classement de l'IMC
15. Unité de poids (kg, lb ou st)	


5. MISE EN SERVICE

Poser le pèse-personne


Posez le pèse-personne sur une surface plate et dure. Une surface plate est nécessaire pour une mesure correcte.

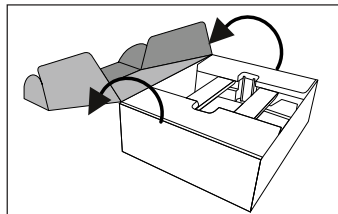


1. Ouvrir l'emballage.

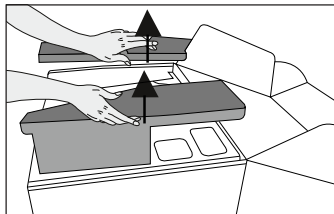


2. Retirer les protections en polystyrène de chaque côté.

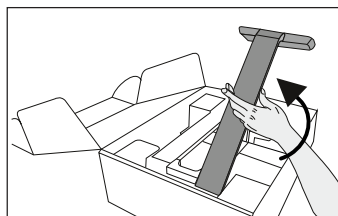


3. Déplier les parties supérieure et inférieure du montant en aluminium en même temps.

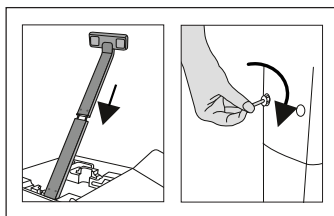


4. Insérer la partie supérieure du montant en aluminium dans la partie inférieure et visser.

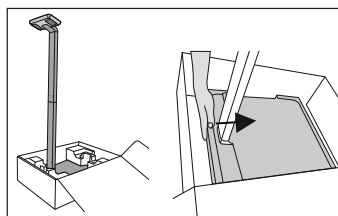


5. Placer le montant en aluminium à la verticale dans l'emballage. Pousser la balance jusqu'au bord...

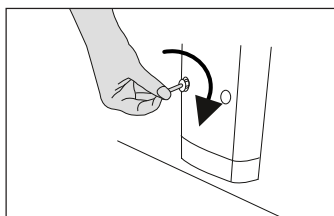

6. ... et visser la partie inférieure du montant.

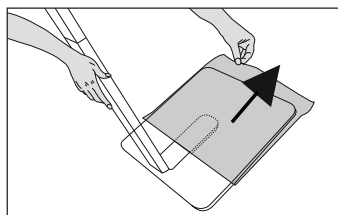

7. Tenir le montant d'une main et retirer le film de protection de l'autre main.

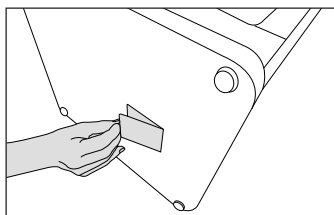

8. Placer les piles sous le pèse-personne en respectant la polarité (+/-). Poser le pèse-personne à la verticale sur une surface plane.

6. UTILISER LE PÈSE-PERSONNE IMPÉDANCEMÈTRE AVEC L'APPLICATION

Pour déterminer le taux de graisse corporelle et les autres paramètres, vous devez enregistrer les données individuelles de l'utilisateur sur le pèse-personne.

Le pèse-personne dispose de 10 emplacements de sauvegarde utilisateur dans lesquels vous et les membres de votre famille pouvez, par exemple, enregistrer vos paramètres personnels.

De plus, d'autres utilisateurs peuvent être affectés depuis des terminaux mobiles où l'application « beurer HealthManager Pro » est installée, ou par le choix du profil utilisateur dans l'application (voir Paramètres de l'application).

Durant la mise en service, laissez le smartphone à proximité du pèse-personne pour que la connexion *Bluetooth*® puisse rester active.

- **Activez la fonction *Bluetooth*® dans les paramètres du smartphone.**
- **Téléchargez l'application gratuite « beurer HealthManager Pro » sur l'Apple App Store (iOS) ou sur Google Play (Android™).**
- **Démarrez l'application et suivez les instructions.**
 - Les réglages suivants doivent être effectués ou entrés dans l'application « beurer HealthManager Pro » :

Données utilisateur	Valeurs de réglage												
Initiales	3 caractères max. (A-Z, 0-9)												
Sexe	homme (♂), femme (♀)												
Taille du corps	100 à 250 cm (3'03" à 8'02")												
Date de naissance	Année, mois, jour												
Niveau d'activité	Le niveau d'activité sera sélectionné en fonction des perspectives à moyen et à long terme :												
	<table><tr><td></td><td>Activité corporelle</td></tr><tr><td>1</td><td>Aucune.</td></tr><tr><td>2</td><td>Faible : peu d'efforts physiques et efforts physiques légers (par ex. : promenades, jardinage simple, exercices de gymnastique).</td></tr><tr><td>3</td><td>Moyenne : efforts physiques, au moins 30 minutes, 2 à 4 fois par semaine.</td></tr><tr><td>4</td><td>Élevée : efforts physiques, au moins 30 minutes, 4 à 6 fois par semaine.</td></tr><tr><td>5</td><td>Très élevée : efforts physiques intenses, entraînement intensif ou travail physique difficile, respectivement d'au moins 1 heure par jour.</td></tr></table>		Activité corporelle	1	Aucune.	2	Faible : peu d'efforts physiques et efforts physiques légers (par ex. : promenades, jardinage simple, exercices de gymnastique).	3	Moyenne : efforts physiques, au moins 30 minutes, 2 à 4 fois par semaine.	4	Élevée : efforts physiques, au moins 30 minutes, 4 à 6 fois par semaine.	5	Très élevée : efforts physiques intenses, entraînement intensif ou travail physique difficile, respectivement d'au moins 1 heure par jour.
		Activité corporelle											
	1	Aucune.											
	2	Faible : peu d'efforts physiques et efforts physiques légers (par ex. : promenades, jardinage simple, exercices de gymnastique).											
	3	Moyenne : efforts physiques, au moins 30 minutes, 2 à 4 fois par semaine.											
4	Élevée : efforts physiques, au moins 30 minutes, 4 à 6 fois par semaine.												
5	Très élevée : efforts physiques intenses, entraînement intensif ou travail physique difficile, respectivement d'au moins 1 heure par jour.												
Poids cible	kg/lb/st (pour représentation de la courbe graphique)												

- L'application vous attribue la prochaine mémoire utilisateur libre (Personne 1 à Personne 10).
- Effectuer la mesure : pour la reconnaissance automatique des utilisateurs, leur première mesure doit être affectée à leurs données d'utilisateur personnelles. Pour cela, suivez les instructions de l'application. Reportez-vous pour cela au chapitre « 8. Effectuer la mesure ».

7. ALTERNATIVE : UTILISER LE PÈSE-PERSONNE IMPÉDANCÉMÈTRE SANS L'APPLICATION

Nous recommandons de faire la mise en service et le réglage de tous les paramètres depuis l'application, comme indiqué au chapitre « 6. Utiliser le pèse-personne impédancemètre avec l'application ». Il est également possible de les effectuer depuis l'appareil. Définir les paramètres de l'appareil/l'heure/l'utilisateur sur l'unité de commande. Sélectionnez votre choix à l'aide des touches [↵] ou [↘] et confirmez avec SET.

a.) Réglage de l'heure

[SET] → « RÉGLAGE DE L'HEURE » → [SET]

Séquence	Valeurs de réglage
Date	Année – Mois – Jour
Heure	Heures – Minutes

b.) Réglage de l'appareil

[SET] → « RÉGLAGE DE L'APPAREIL » → [SET]

Séquence	Valeurs de réglage
Langue	DE EN FR ES IT
Unité de mesure	kg – lb – st
Heure	24 h – 12 h
Mode invité	ACTIVÉ – DÉSACTIVÉ
<i>Bluetooth</i> ®	ACTIVÉ – DÉSACTIVÉ  Si la fonction ne propose que « DÉSACTIVÉ », cela signifie qu'une connexion <i>Bluetooth</i> ® n'est possible que si le pèse-personne est allumé. Cela peut être utile pour prolonger la durée de vie des piles ou pour éviter les ondes radio indésirables.

c.) Réglage des données de l'utilisateur
[SET] → « CHANGER D'UTILISATEUR » → [SET]

Données utilisateur	Valeurs de réglage
Initiales	3 caractères max. (A-Z, 0-9)
Sexe	homme (♂), femme (♀)
Taille	100 à 250 cm (3'03" à 8'02")
Date de naissance	Année, mois, jour
Niveau d'activité	1 à 5 (cf. chapitre 6)
Poids cible	kg/lb/st (pour représentation de la courbe graphique)
Code utilisateur	Attribué automatiquement pour la prochaine utilisation éventuelle de la fonction Bluetooth®. Ces informations ne sont nécessaires que lors de la configuration ultérieure de l'application, lorsque des utilisateurs du pèse-personne existants sont ajoutés lors de l'installation ultérieure de l'application.



Inscription ultérieure à l'application

Si vous souhaitez mettre en service le pèse-personne sans l'application, vous pouvez ajouter un utilisateur existant sur l'application « beurer HealthManager Pro ». Il est nécessaire de saisir votre code utilisateur à 4 chiffres « PIN ». Cette procédure est décrite dans l'application.

8. EFFECTUER LA MESURE

8.1 Mesure du poids

- Appuyez sur la touche [P] de l'unité de commande. „0,0“ kg s'affiche à l'écran.
- Le pèse-personne est alors prêt pour une mesure. Montez sur le pèse-personne en répartissant votre poids de manière égale entre les deux jambes. Les données de poids ne seront pas stockées, l'affectation d'un utilisateur n'est pas possible, car il n'y a pas de mesure BIA au niveau des mains et des pieds.

8.2 Effectuer une mesure en mode invité

Pour une seule mesure ou pour une mesure sans stockage des données utilisateur. Il est alors nécessaire d'activer le mode invité dans les paramètres de l'appareil.

[Invité] → « Invité » → [SET] ou allumer le pèse-personne

Données utilisateur	Valeurs de réglage
Sexe	homme (♂), femme (♀)
Taille	100 à 250 cm (3'03" à 8'02")
Date de naissance	Année, mois, jour
Niveau d'activité	1 à 5 (cf. chapitre 6)

8.3 Analyse complète du corps

- Appuyez sur la touche [P] de l'unité de commande. „0,0“ kg s'affiche à l'écran.

Si le mode invité a été activé dans les paramètres du pèse-personne, montez sur l'appareil alors qu'il est éteint.

- Placez-vous pieds nus sur le pèse-personne et maintenez fermement l'unité de commande dans vos mains. Maintenez l'unité de commande avec la partie inférieure du pouce sur les électrodes avant et serrez fermement les électrodes arrière avec les doigts.
- Restez immobile sur le pèse-personne en répartissant votre poids de manière égale entre les deux jambes. Attention, il ne doit pas y avoir de contact avec la peau entre les deux pieds, jambes, mollets et cuisses.

- Si le pèse-personne vous a reconnu automatiquement, la mesure de l'impédance pour l'analyse a lieu après la mesure du poids. Cet état est signalé par le symbole du corps parcouru par du courant.
- Une fois l'analyse complète du corps terminée, la vue d'ensemble s'affiche. La valeur mesurée est enregistrée automatiquement.

Initials Analyse sectorielle




Remarque :

Les valeurs mesurées ne sont pas enregistrées dans les conditions suivantes :

- L'utilisateur n'est pas reconnu automatiquement. La mesure peut être effectuée si votre poids varie de ± 3 kg max. par rapport à la dernière mesure ou qu'un autre utilisateur pèse le même poids que vous à ± 3 kg. Appuyez alors sur la touche [] pour sélectionner manuellement l'utilisateur et effectuer à nouveau la mesure.
- L'utilisateur est monté sur le pèse-personne avec ses chaussures.
- L'utilisateur ne tient pas l'unité de commande dans les mains.

9. ANALYSE DES VALEURS DE MESURE




Les résultats sont évalués automatiquement après la mesure ou après la sélection manuelle de l'utilisateur sur l'unité de commande. Sélectionnez l'utilisateur à l'aide de la touche []. Appuyez sur la touche [SET] pour confirmer ou attendez 3 secondes



Vue d'ensemble


Avant ou après une analyse complète du corps de l'utilisateur, la vue d'ensemble s'affiche à l'écran.



Analyse sectorielle pour la graisse corporelle et la masse musculaire


a) Graisse corporelle des bras (droit et gauche)

- Appuyez plusieurs fois que la touche Menu [] jusqu'à ce que s'affiche. L'analyse sectorielle de la graisse corporelle des bras droit et gauche s'affiche à l'écran.




b) Graisse corporelle des jambes (droite et gauche)

- Appuyez sur la touche [] pour afficher l'analyse détaillée de la graisse corporelle des jambes droite et gauche.




c) Graisse corporelle du torse

- Appuyez sur la touche [] pour afficher l'analyse détaillée de la graisse corporelle du torse.




d) Graisse viscérale (graisse abdominale/graisse du ventre)


- Appuyez sur la touche [] pour afficher l'analyse détaillée de la graisse viscérale.



e) Masse musculaire des bras (droit et gauche)




- Appuyez sur la touche [] pour afficher l'analyse détaillée de la masse musculaire des bras droit et gauche.




f) Masse musculaire des jambes (droite et gauche) Appuyez sur la touche [] pour afficher l'analyse détaillée de la masse musculaire des jambes droite et gauche.	
g) Masse musculaire du torse Appuyez sur la touche [] pour afficher l'analyse détaillée de la masse musculaire du torse.	

 Pour les utilisateurs âgés de 10 à 17 ans, aucune graisse viscérale et aucune masse musculaire segmentée (bras/jambes/tronc) ne sont affichées.


Représentation graphique

a) Poids Appuyez plusieurs fois que la touche Menu [] jusqu'à ce que  s'affiche. L'évolution du poids s'affiche à l'écran. L'évolution de votre poids est représentée à chaque mesure. Les mesures les plus récentes sont ajoutées sur la droite. La ligne de référence représente le poids cible.  Le poids cible peut être modifié à tout moment dans l'unité de commande.	
b) Graisse corporelle  1. Accédez à la courbe des valeurs de graisse corporelle  à l'aide de la touche []. L'évolution de votre graisse corporelle est représentée à chaque mesure. La ligne de référence représente la valeur moyenne de l'ensemble des mesures de graisse corporelle. Les barres indiquent si les valeurs ont évolué vers le haut ou vers le bas.	
c) Taux d'eau corporelle  Accédez à la courbe des valeurs d'eau corporelle  à l'aide de la touche []. L'évolution de votre eau corporelle est représentée à chaque mesure. La ligne de référence représente la valeur moyenne de l'ensemble des mesures d'eau corporelle. Les barres indiquent si les valeurs ont évolué vers le haut ou vers le bas.	
d) Masse musculaire  Accédez à la courbe de la masse musculaire  à l'aide de la touche []. L'évolution de votre masse musculaire est représentée à chaque mesure. La ligne de référence représente la valeur moyenne de l'ensemble des mesures de masse musculaire. Les barres indiquent si les valeurs ont évolué vers le haut ou vers le bas.	

M Afficher les valeurs de mémoire

- Appuyez plusieurs fois que la touche Menu [] jusqu'à ce que M s'affiche. La dernière valeur mesurée s'affiche à l'écran. La date de la mesure et le numéro d'emplacement de mémoire, p. ex. (03-03) le troisième et dernier emplacement de mémoire sur un total de 3 emplacements de mémoire occupés, s'affichent en haut. - Accédez aux différents emplacements de mémoire à l'aide des touches [], [].	
---	--

Valeur moyenne

Appuyez plusieurs fois que la touche Menu [] jusqu'à ce que  s'affiche. L'ensemble des valeurs moyennes à partir des mesures enregistrées s'affiche à l'écran.  La date de la première et de la dernière mesure s'affiche en haut.	
---	--

kcal Consommation de calories

- Appuyez plusieurs fois que la touche Menu [>] jusqu'à ce que **kcal** s'affiche. Le volume de base BMR théorique calculé ainsi que le volume d'activité AMR sont représentés en Kcal.

23-05-2021 18:33



BMR: **1499** KCAL
AMR: **2248** KCAL

Extinction du pèse-personne (mode veille)

- Attendez que l'écran s'éteigne de lui-même ou appuyez sur la touche [U] de l'unité de commande pour éteindre manuellement l'écran. La date et l'heure restent visibles.

10. ÉVALUATION DES RÉSULTATS

Taux de graisse corporelle

Les valeurs de graisse corporelle sont affichées à l'écran et analysées dans le diagramme à barres. Les valeurs de graisse corporelle suivantes en % vous donnent une ligne de conduite (pour de plus amples informations, veuillez consulter votre médecin).

Homme

Âge	faible	normal	élevé	très élevé
10-14	< 11 %	11-16 %	16,1-21 %	> 21 %
15-19	< 12 %	12-17 %	17,1-22 %	> 22 %
20-29	< 13 %	13-18 %	18,1-23 %	> 23 %
30-39	< 14 %	14-19 %	19,1-24 %	> 24 %
40-49	< 15 %	15-20 %	20,1-25 %	> 25 %
50-59	< 16 %	16-21 %	21,1-26 %	> 26 %
60-69	< 17 %	17-22 %	22,1-27 %	> 27 %
70-100	< 18 %	18-23 %	23,1-28 %	> 28 %

Femme

Âge	faible	normal	élevé	très élevé
10-14	< 16 %	16-21 %	21,1-26 %	> 26 %
15-19	< 17 %	17-22 %	22,1-27 %	> 27 %
20-29	< 18 %	18-23 %	23,1-28 %	> 28 %
30-39	< 19 %	19-24 %	24,1-29 %	> 29 %
40-49	< 20 %	20-25 %	25,1-30 %	> 30 %
50-59	< 21 %	21-26 %	26,1-31 %	> 31 %
60-69	< 22 %	22-27 %	27,1-32 %	> 32 %
70-100	< 23 %	23-28 %	28,1-33 %	> 33 %

Chez les sportifs, on constate souvent une valeur plus faible. Selon le type de sport pratiqué, l'intensité de l'entraînement et la constitution physique, il est possible d'obtenir des valeurs inférieures à la valeur de référence. Veuillez cependant noter que des valeurs extrêmement faibles peuvent entraîner des risques pour la santé.

Graisse viscérale (graisse abdominale/graisse du ventre)

La graisse viscérale est la graisse qui entoure les organes internes de la cavité abdominale. La graisse viscérale est suspectée de favoriser des maladies telles que l'hypertension ou le diabète.

La graisse viscérale s'affiche à l'écran avec un indice compris entre 1 et 59.

Indice de graisse viscérale	Évaluation
1-12	Votre indice de graisse viscérale se trouve dans la moyenne.
13-59	Votre indice de graisse viscérale est trop élevé.

Taux d'eau corporelle

Le taux d'eau corporelle en % se situe normalement dans les plages suivantes :

Homme

Âge	mauvais	bon	excellent
10-100	< 50 %	50-65 %	> 65 %

Femme

Âge	mauvais	bon	excellent
10-100	< 45 %	45-60 %	> 60 %

La graisse corporelle contient relativement peu d'eau. C'est pourquoi, chez les personnes ayant un taux de graisse corporelle élevé, le taux d'eau corporelle peut être inférieur aux valeurs de référence. Pour les sportifs d'endurance, les valeurs de référence peuvent au contraire être dépassées en raison d'un taux de graisse faible et d'un taux de masse musculaire élevé. La détermination du taux d'eau corporelle avec ce pèse-personne ne permet pas de tirer des conclusions médicales concernant par exemple les rétentions d'eau dues à l'âge. Le cas échéant, demandez conseil à votre médecin. En principe, il faut chercher à avoir une part d'eau élevée.

Taux de masse musculaire

La masse musculaire est calculée en mesurant la masse des muscles squelettiques. Aucun muscle organique n'est pris en compte. Le taux de masse musculaire en % se situe normalement dans les plages suivantes :

Homme				Femme			
Âge	faible	normal	élevé	Âge	faible	normal	élevé
10-14	< 44 %	44-57 %	> 57 %	10-14	< 36 %	36-43 %	> 43 %
15-19	< 43 %	43-56 %	> 56 %	15-19	< 35 %	35-41 %	> 41 %
20-29	< 42 %	42-54 %	> 54 %	20-29	< 34 %	34-39 %	> 39 %
30-39	< 41 %	41-52 %	> 52 %	30-39	< 33 %	33-38 %	> 38 %
40-49	< 40 %	40-50 %	> 50 %	40-49	< 31 %	31-36 %	> 36 %
50-59	< 39 %	39-48 %	> 48 %	50-59	< 29 %	29-34 %	> 34 %
60-69	< 38 %	38-47 %	> 47 %	60-69	< 28 %	28-33 %	> 33 %
70-100	< 37 %	37-46 %	> 46 %	70-100	< 27 %	27-32 %	> 32 %

Masse osseuse

Comme le reste de notre corps, nos os sont soumis aux processus naturels de développement, de réduction et de vieillissement. Pendant l'enfance, la masse osseuse augmente rapidement et atteint son maximum vers 30 à 40 ans. L'âge avançant, la masse osseuse diminue légèrement. Avec une alimentation saine (en particulier calcium et vitamine D) et une activité physique régulière, vous pouvez ralentir cette réduction. Avec une construction musculaire appropriée, vous pouvez améliorer la stabilité de votre ossature. Ce pèse-personne indique la teneur en minéraux dans les os. La masse osseuse est peu influençable, mais elle varie légèrement selon certains facteurs (poids, taille, âge, sexe). Il n'existe pas de directives et recommandations reconnues.

Veuillez cependant à ne pas confondre la masse osseuse avec la densité osseuse. La densité osseuse ne peut être calculée que par un examen médical (par ex. tomographie par ordinateur, ultrason). C'est pourquoi des conclusions à propos de modifications des os et de la dureté des os (par ex. ostéoporose) ne sont pas possibles avec un pèse-personne.

BMR

Le volume de base (BMR = Basal Metabolic Rate) représente la quantité d'énergie dont le corps a besoin au repos complet pour maintenir en activité ses fonctions de base (par exemple lorsque l'on est couché au lit pendant 24 heures). Cette valeur dépend essentiellement du poids, de la taille et de l'âge. Elle s'affiche sur le pèse-personne impédancemètre dans l'unité kcal/jour et est calculée à l'aide de la formule de Mifflin-St.Jeor reconnue scientifiquement. Votre organisme a définitivement besoin de cette quantité d'énergie qui doit lui être apportée via l'alimentation. À long terme, un apport d'énergie moindre peut avoir des effets nocifs sur votre santé.

AMR

Le volume d'activité (AMR = Active Metabolic Rate) représente la quantité d'énergie dont le corps a besoin quotidiennement lorsqu'il est actif. Les dépenses énergétiques d'une personne s'accroissent avec l'augmentation de l'activité physique et sont indiquées par le pèse-personne impédancemètre selon le niveau d'activité choisi (1 à 5). Pour maintenir son poids actuel, l'énergie dépensée doit être renouvelée sous forme de nourriture et de boissons. Si, sur une longue durée, le corps reçoit moins d'énergie qu'il n'en dépense, le corps compense la différence en utilisant essentiellement la graisse stockée et le poids diminue. Si au contraire, pendant une longue période de temps, le corps reçoit une quantité d'énergie supérieure au volume d'activité calculé (AMR), il ne peut pas brûler l'excédent énergétique, qui est alors stocké sous forme de graisse et le poids augmente.

Corrélation des résultats dans le temps

Notez que seule compte la tendance à long terme. Des écarts de poids de courte durée enregistrés en l'espace de quelques jours ne sont dus qu'à une simple perte de liquides dans la plupart des cas. L'interprétation des résultats se fait en fonction des modifications du poids global et des taux de graisse et d'eau corporelles et de masse musculaire ainsi qu'en fonction de la durée selon laquelle ces modifications se produisent. Il faut distinguer les modifi-

cations rapides (de l'ordre de quelques jours) des modifications à moyen terme (de l'ordre de quelques semaines) et à long terme (plusieurs mois).

La règle générale peut être la suivante : les modifications de poids à court terme représentent presque exclusivement des changements de la teneur en eau, alors que les modifications à moyen et à long terme peuvent aussi concerner le taux de graisse et de masse musculaire.

- Si votre poids diminue à court terme, alors que le taux de graisse corporelle augmente ou reste stable, vous n'avez perdu que de l'eau, par exemple suite à un entraînement, une séance de sauna ou un régime visant uniquement à une perte de poids rapide.
- Si votre poids augmente à moyen terme, alors que le taux de graisse corporelle diminue ou reste stable, il se pourrait au contraire que vous ayez augmenté la masse musculaire.
- Si votre poids et votre taux de graisse corporelle diminuent simultanément, cela signifie que votre régime fonctionne : vous perdez de la graisse.
- L'activité physique, les séances de mise en forme ou de musculation seront les compléments parfaits de votre régime. Ils vous permettent d'augmenter votre taux de masse musculaire à moyen terme.
- Il ne faut pas additionner la graisse corporelle, le taux d'eau corporelle et la masse musculaire (le tissu musculaire contient aussi des constituants de l'eau corporelle).

11. TRANSFERT DES MESURES VIA L'APPLICATION

Si l'application n'est pas ouverte, les nouvelles mesures affectées sont enregistrées sur le pèse-personne. Un maximum de 30 mesures par utilisateur peuvent être enregistrées sur le pèse-personne. Quand vous ouvrez l'application à portée du *Bluetooth®*, les valeurs enregistrées lui sont automatiquement transférées. Un transfert automatique est possible lorsque le pèse-personne est éteint, si la fonction *Bluetooth®* est activée dans les paramètres de l'appareil.

12. PLUS D'INFORMATIONS

Supprimer les données du pèse-personne

a) Supprimer un utilisateur avec tous les paramètres et toutes les valeurs

- Allumez le pèse-personne, puis sélectionnez l'utilisateur à supprimer en appuyant que la touche []. Appuyez plusieurs fois sur la touche, le cas échéant, puis confirmez à l'aide de la touche [SET].
- Lorsque 0.0 s'affiche à l'écran, appuyez sur la touche [SET] pendant 12 secondes pour supprimer l'utilisateur.
- À l'aide des touches [], [], sélectionnez « OUI », puis confirmez en appuyant sur la touche [SET]. Si vous ne souhaitez pas supprimer l'utilisateur, sélectionnez « NON », puis confirmez en appuyant sur la touche [SET].



Toutes les valeurs et tous les paramètres enregistrés pour cet utilisateur sont supprimés.

b) Supprimer une seule valeur d'un utilisateur

- Dans la mémoire utilisateur [M], sélectionnez une valeur, puis appuyez brièvement sur la touche [SET] de l'unité de commande pour supprimer la valeur affichée.
- Vous pouvez également effectuer cette opération directement après la mesure.
- À l'aide des touches [], [], sélectionnez « OUI », puis confirmez en appuyant sur la touche [SET]. Si vous ne souhaitez pas supprimer la valeur, sélectionnez « NON », puis confirmez en appuyant sur la touche [SET].

c) Supprimer toutes les valeurs d'un utilisateur

- Consultez la mémoire utilisateur [M] et appuyez sur la touche [SET] de l'unité de commande pendant environ 5 secondes pour supprimer toutes les valeurs.
- À l'aide des touches [], [], sélectionnez « OUI », puis confirmez en appuyant sur la touche [SET]. Si vous ne souhaitez rien supprimer, sélectionnez « NON », puis confirmez en appuyant sur la touche [SET].

Remplacer les piles

Votre unité de commande comporte un témoin de remplacement des piles. « BATTERIE FAIBLE » s'affiche à l'écran lorsque les piles sont trop faibles. Dans ce cas, les piles doivent être remplacées. Reconnecter ensuite le pèse-personne à l'application. L'heure système est alors actualisée.



Remarque :

- Lors de chaque changement de piles, utilisez des piles de même type, marque et capacité.
- N'utilisez pas de batteries rechargeables.
- Utilisez des piles sans métaux lourds.

13. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

De temps en temps, nettoyez le pèse-personne avec un chiffon doux légèrement humide. Ne pas utiliser le pèse-personne tant que la surface du pèse-personne n'est pas complètement sèche.



Remarque :

- N'utilisez pas de produits nettoyants abrasifs.
- N'immergez jamais le pèse-personne. Ne rincez jamais la balance sous l'eau courante.
- Ne posez aucun objet sur le pèse-personne lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Protégez le pèse-personne contre les coups, l'humidité, la poussière, les produits chimiques, les fortes variations de température, les champs électromagnétiques et les sources de chaleur trop proches (four, radiateur).

14. ÉLIMINATION

Les piles usagées et complètement déchargées doivent être mises au rebut dans des conteneurs spéciaux ou aux points de collecte réservés à cet usage ou bien déposées chez un revendeur d'appareils électriques. L'élimination des piles est une obligation légale qui vous incombe.

Ces pictogrammes se trouvent sur les piles à substances nocives :

Pb = pile contenant du plomb,

Cd = pile contenant du cadmium,

Hg = pile contenant du mercure.

Dans l'intérêt de la protection de l'environnement, l'appareil ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères à la fin de sa durée de service. L'élimination doit se faire par le biais des points de collecte compétents dans votre pays.

Veuillez éliminer l'appareil conformément à la directive européenne-WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) relative aux appareils électriques et électroniques usagés. Pour toute question, adressez-vous aux collectivités locales responsables de l'élimination et du recyclage de ces produits.



15. QUE FAIRE EN CAS DE PROBLÈMES ?

Si le pèse-personne détecte une erreur au cours d'une mesure, l'écran affiche les messages suivants :

Écran	Cause	Solution
« SURCHARGE! »	La capacité de charge maximale de 200 kg est dépassée.	Ne pas dépasser 200 kg.
« BATTERIE_ FAIBLE »	Les piles sont presque vides.	Remplacer les piles (cf. chapitre « Remplacer les piles »).
« MEM._PLEINE »	30 mesures sont enregistrées.	Transférer les valeurs mesurées.
« ERREUR DE CONT.! » « ERREUR »	La résistance électrique entre les électrodes et la plante du pied est trop élevée (p. ex. en présence de fortes callosités).	Recommencer la mesure pieds nus. Humidifier au besoin légèrement la plante des pieds. Éliminer au besoin les callosités de la plante des pieds. Maintenir fermement les électrodes arrière avec les doigts et avant avec la paume de la main.
« PLAGE DE MESURE! »	La mesure BIA a fonctionné, mais le taux de graisse dépasse les limites de la plage mesurable (inférieur à 3 % ou supérieur à 65 %).	Recommencer la mesure pieds nus ou humidifier légèrement la plante des pieds. Modifier éventuellement le niveau d'activité sélectionné.
Aucun affichage	Les piles sont complètement vides.	Remplacer les piles (cf. chapitre « Remplacer les piles »).
	Les piles ne sont pas correctement insérées.	Vérifier que la polarité est correcte (cf. « Mise en service » -> « Remplacer les piles »).
Affichage du poids uniquement, pas de diagnostic	Mesure inconnue, car elle se situe hors de la limite d'affectation utilisateur ou bien aucune affectation unique n'est possible.	Sélectionner l'utilisateur sur le pèse-personne à l'aide de la touche [^] ou répéter l'affectation utilisateur dans l'application. Tenir les électrodes dans la main et monter pieds nus sur la surface de pesée.

Mesure erronée

Causes possibles d'erreur	Solution
La position 0 du pèse-personne est fausse.	Éteindre le pèse-personne. Attendre environ 5 secondes, puis recommencer la mesure.
Le pèse-personne est posé sur un tapis ou de la moquette.	Poser le pèse-personne sur un sol plat et dur. Placer les jambes le plus possible vers l'extérieur, sans faire basculer le pèse-personne.
Un poids incorrect s'affiche.	Si possible, ne pas bouger.
Un poids incorrect s'affiche.	Attendre que le pèse-personne s'éteigne de nouveau. Répéter la mesure.

Aucune connexion *Bluetooth*® (le symbole ne s'affiche pas)

Causes possibles d'erreur	Solution
Liaison radio	Dans un espace dégagé, la portée est d'environ 10 m. Les murs et les plafonds diminuent la portée. D'autres ondes radio peuvent perturber la transmission. Par conséquent, ne placez pas le pèse-personne à proximité d'appareils tels qu'un routeur sans fil, un micro-ondes, des plaques de cuisson à induction, etc.
Connexion <i>Bluetooth</i> ®	Fermez complètement l'application (en arrière-plan également). Désactivez la fonction <i>Bluetooth</i> ®, puis réactivez-la. Éteignez le smartphone puis rallumez-le. Retirez brièvement les piles du pèse-personne et réinsérez-les ensuite. Vous pouvez consulter la FAQ sur le site www.beurer.com .
La connexion est trop lente	Intervalle <i>Bluetooth</i> ® plus rapide lorsque le pèse-personne est allumé.

16. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions du pèse-personne	380 x 390 x 1 000 mm
Piles du pèse-personne	4 piles AA 1,5 V
Plage de mesure	8 kg à 200 kg
Affichage:	Les valeurs sont exprimées par graduations de 0,05 kg.
Précision de répétition :	La tolérance de mesure pour la précision de répétition est de +/- 0,3 kg (plusieurs mesures consécutives avec le même pèse-personne, la même position de l'appareil sur le sol et de la personne sur le pèse-personne).
Précision absolue :	La valeur mesurée par rapport à un même poids est de +/- 0,5 % +0,05 kg. Par ex. pour 50 kg, cela correspond à +/- 0,3 kg, pour 100 kg, cela correspond à +/- 0,55 kg.
Transfert de données par technologie sans fil <i>Bluetooth</i> ®	Ce produit utilise la technologie <i>Bluetooth</i> ® low energy technology, la fréquence 2 402–2 480 GHz, la puissance d'émission max. 0 dBm et il est compatible avec les smartphones et tablettes <i>Bluetooth</i> ® 4.0

Configuration requise et liste des appareils compatibles pour l'application « beurer HealthManager Pro »*



Sous réserve de modifications techniques.

*Ce produit répond aux exigences des directives européennes en vigueur.
Nous garantissons par la présente que ce produit est conforme à la directive européenne RED 2014/53/UE.
Vous pouvez trouver la déclaration de conformité CE de ce produit à l'adresse suivante :
<https://www.beurer.com/web/we-landingpages/de/cedclarationofconformity.php>

17. GARANTIE/MAINTENANCE

Pour plus d'informations sur la garantie et les conditions de garantie, veuillez consulter la fiche de garantie fournie.

Sous réserve d'erreurs et de modifications



Lea detenidamente estas instrucciones de uso. Siga las indicaciones de advertencia y de seguridad. Conserve estas instrucciones de uso para futuras consultas. Ponga estas instrucciones de uso a disposición de otros usuarios. Si entrega el aparato a un tercero, incluya también las instrucciones de uso.

Índice

1. Artículos suministrados	46	9. Análisis de los valores medidos	52
2. Símbolos	46	10. Evaluación de los resultados	54
3. Indicaciones de advertencia y de seguridad	46	11. Transferir valores medidos mediante app	56
4. Descripción del aparato	48	12. Más información	56
5. Puesta en funcionamiento	49	13. Limpieza y cuidado	57
6. Configuración de la báscula diagnóstica con app	49	14. Eliminación	57
7. Alternativa: configuración de la báscula diagnóstica sin app	50	15. Solución de problemas	57
8. Realizar la medición	51	16. Datos técnicos	58
		17. Garantía/asistencia	58

Información general

Funciones del aparato

Esta báscula digital sirve para pesarse y para determinar sus datos personales de forma física.

Está concebida para el uso particular en el ámbito privado.

La báscula dispone de las siguientes funciones, que pueden usar un máximo de 10 personas:

- medición del peso corporal;
- determinación de la proporción de grasa corporal;
- proporción de grasa visceral (grasa que envuelve los órganos internos/grasa abdominal);
- proporción de agua corporal,
- masa muscular;
- masa ósea y
- metabolismo basal y activo.

Además, la báscula dispone de las siguientes funciones:

- la medición cruzada con 8 electrodos permite el análisis segmentado, es decir, una representación separada de las distintas partes del cuerpo (brazos, piernas y tronco);
- innovadora guía de menús en la pantalla de gran tamaño (disponible en 5 idiomas);
- conmutación entre kilogramo “kg”, libra “lb” y stone “st”;
- indicación de cambio de pila en caso de pilas gastadas;
- identificación automática de usuarios;
- almacenamiento de las 30 últimas mediciones para 10 personas, si no es posible la transferencia a la app;
- modo de invitado (sin función de almacenamiento).

Principio de medición

Esta báscula funciona según el principio del análisis de impedancia bioeléctrica (BIA). De este modo, es posible determinar en cuestión de segundos las proporciones corporales a través de una corriente no perceptible, inocua y segura.

Con esta medición de la resistencia eléctrica (impedancia) y el cálculo de las constantes o de los valores individuales (edad, estatura, sexo, grado de actividad) pueden determinarse la proporción de grasa corporal y otros parámetros corporales. El tejido muscular y el agua poseen una buena conductividad eléctrica y, por tanto, presentan una resistencia menor. Por el contrario, los huesos y los tejidos grasos poseen una menor conductividad, ya que las células grasas y los huesos apenas conducen la electricidad debido a una resistencia muy elevada.

El contacto eléctrico con el cuerpo se optimiza mediante 4 electrodos de mano y 4 electrodos de pie para conseguir una mayor precisión en la medición y, por tanto, un mejor análisis. Esta técnica de análisis es tan precisa que es posible que los valores puedan variar ligeramente al repetir las mediciones. El motivo son divergencias durante la medición de impedancia (p. ej., otro contacto eléctrico con los electrodos con manos y pies, una distribución distinta del agua en el cuerpo).

Tenga en cuenta que los valores calculados por la báscula diagnóstica solo representan una aproximación a los valores obtenidos mediante análisis médicos reales del cuerpo. Solo un médico especialista puede establecer las proporciones exactas de grasa corporal, agua corporal, masa muscular y estructura ósea recurriendo a métodos profesionales (p. ej., mediante tomografía computarizada).

1. ARTÍCULOS SUMINISTRADOS

Compruebe que el embalaje de los artículos suministrados esté intacto y que su contenido esté completo. Antes de utilizar el aparato deberá asegurarse de que ni este ni los accesorios presentan daños visibles y de que se retire el material de embalaje correspondiente. En caso de duda, no lo use y póngase en contacto con su distribuidor o con la dirección de atención al cliente indicada.

- Báscula diagnóstica con pantalla elevada en soporte de aluminio
- 4 pilas de 1,5V tipo AA
- Estas instrucciones de uso
- 2 guías rápidas
- Set de montaje (4 tornillos con 2 tornillos de repuesto + llave Allen)

2. SÍMBOLOS

En el aparato, en las instrucciones de uso, en el embalaje y en la placa de características del aparato se utilizan los siguientes símbolos:

⚠ ADVERTENCIA Indica un posible peligro inminente. Si no se evita, puede causar la muerte o lesiones muy graves.			
	Información sobre el producto Indicación de información importante		Markado UKCA (Conformidad Evaluada del Reino Unido, por sus siglas en inglés)
	Las personas que lleven implantes médicos (p. ej., marcapasos) no podrán utilizar el aparato, ya que estos pueden afectar negativamente a su funcionamiento.		Símbolo del importador
	Markado CE Este producto cumple los requisitos de las directrices europeas y nacionales vigentes.		Fabricante.
	Está demostrado que los productos cumplen los requisitos de las normas técnicas de la Unión Económica Euroasiática.		Separe el producto y los componentes del envase y elimínelos conforme a las disposiciones municipales.
	No está permitido eliminar los aparatos (electrónicos) junto con la basura doméstica		Consultar las instrucciones de uso
	No desecho con la basura doméstica pilas que contengan sustancias tóxicas		Etiquetado para identificar el material de embalaje. A = abreviatura del material, B = número de material: 1-7 = plásticos, 20-22 = papel y cartón
	¡Peligro de vuelco! No se apoye sobre el borde exterior.		Coloque la báscula sobre una superficie plana y estable. No coloque la báscula sobre una alfombra.
	¡Peligro de resbalones! No pise la báscula con los pies mojados.		

3. INDICACIONES DE ADVERTENCIA Y DE SEGURIDAD

⚠ ADVERTENCIA

- El aparato se ha diseñado únicamente para pesar personas y para registrar sus datos personales de forma física. El aparato se ha concebido únicamente para el uso propio, no para el uso médico o comercial. Utilícelo para el fin para el que ha sido diseñado y del modo indicado en estas instrucciones de uso.
- Las personas que lleven implantes médicos (p. ej., marcapasos) no podrán utilizar el aparato, ya que estos pueden afectar negativamente a su funcionamiento.
- No utilice el aparato durante el embarazo.
- ¡Peligro de vuelco! Nunca coloque la báscula sobre una superficie irregular. No suba nunca por un solo lado sobre el borde exterior de la báscula.



- **¡Peligro de resbalones!** No se suba a la báscula con los pies mojados. No pise la báscula si la superficie está húmeda. No se suba a la báscula con calcetines.
- Tenga en cuenta que es posible que haya tolerancias de medición de carácter técnico, puesto que no se trata de una báscula calibrada para uso médico profesional.
- En el caso de tratamientos o dietas para personas con sobrepeso o bajo peso, personal especializado adecuado (p. ej., un médico) deberá ofrecer asesoramiento cualificado. Los valores calculados con la báscula pueden ayudar a los especialistas.
- En niños, deportistas de alto rendimiento o personas con limitaciones médicas o físicas (p. ej., síntomas de edema, osteoporosis, que estén tomando tratamiento cardiovascular o vascular, personas con desviaciones anatómicas considerables en las piernas), pueden producirse resultados inexactos o inverosímiles al determinar la grasa corporal.
- Las reparaciones quedan reservadas exclusivamente al servicio de atención al cliente de Beurer o a distribuidores autorizados. No abra nunca la báscula por su cuenta.

Indicaciones de seguridad para el manejo de las pilas

- Colocar las pilas correctamente teniendo en cuenta la polaridad (+/-). Mantener las pilas limpias y secas y alejadas del agua. Seleccionar siempre el tipo de pila correcto.
- No cortocircuite nunca las pilas ni los contactos del compartimento de las pilas.
- No cargue, descargue, caliente, desmonte, deforme, encapsule ni modifique nunca las pilas.
- No suelde nunca nada a las pilas.
- No mezcle pilas de distintos fabricantes, capacidades (nuevas y usadas), tamaños y tipos en un mismo aparato.
- **¡Peligro de explosión!** El incumplimiento de estas indicaciones podría producir lesiones personales, sobrecalentamiento, fugas, escapes, roturas, explosión o incendio.
- Si se derrama el líquido de una pila, póngase guantes protectores y limpie el compartimento de las pilas con un paño seco.
- En caso de que el líquido de una pila entre en contacto con la piel o los ojos, lave la zona afectada con agua y busque asistencia médica.
- **¡Peligro de asfixia!** Mantener las pilas fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión, acuda inmediatamente a un médico.
- No permita nunca que los niños cambien las pilas sin la supervisión de un adulto.
- Guarde las pilas alejadas de los objetos metálicos, en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
- No exponga las pilas a la luz solar directa ni a la lluvia.
- Si no va a utilizar el aparato durante un periodo de tiempo prolongado, retire las pilas.
- Las pilas descargadas deben desecharse de forma inmediata y adecuada. Nunca arroje las pilas al fuego.
- Cuando deseche las pilas, guárdelas por separado en función de los distintos sistemas electroquímicos.


Indicaciones generales

- La capacidad de carga de la báscula es de 200 kg (440 lb, 31 st) como máximo. Durante la medición del peso los resultados se muestran en intervalos de 50 g (0,1 lb).
- Los resultados de medición de la proporción de grasa corporal, agua corporal y masa muscular se muestran en intervalos de 0,1 %.
- La necesidad de calorías se indica en intervalos de 1 kcal.
- En el estado de suministro, en la báscula están ajustadas las unidades "cm" y "kg". Durante la puesta en funcionamiento con la app es posible modificar los ajustes de las unidades.

Consejos generales


- Pésese a ser posible a la misma hora del día (lo ideal es que sea por la mañana) después de ir al baño, en ayunas y sin ropa para lograr resultados comparables.
- Importante a la hora de medir: la grasa corporal solo se puede calcular con medición en la mano y con los pies descalzos y las plantas de los pies ligeramente humedecidas.
- Unas plantas totalmente secas o queratinizadas pueden producir errores en los resultados, ya que presentan una conductividad demasiado baja.
- Durante el proceso de medición, permanezca quieto y en posición recta.
- Espere unas horas después de hacer algún esfuerzo físico no habitual.
- Espere unos 15 minutos después de levantarse para que el agua del cuerpo pueda distribuirse.
- Es importante que solo se considere la tendencia a largo plazo. Por lo general, las diferencias de peso rápidas en el plazo de pocos días son debidas a la pérdida de líquidos; sin embargo, el agua corporal desempeña un papel importante en el bienestar.

4. DESCRIPCIÓN DEL APARATO

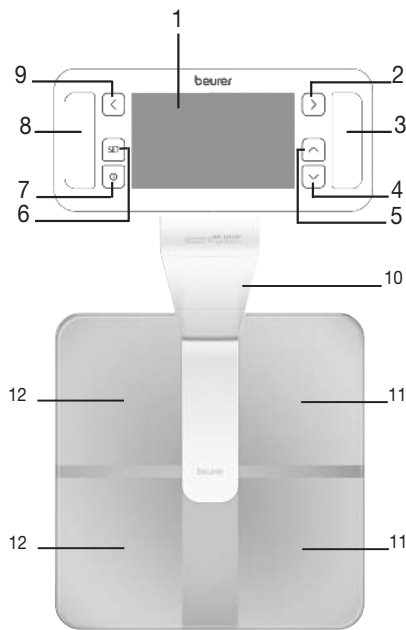

1. Pantalla
2. Menú : botón hacia la derecha (tecla táctil)
3. Electrodos, mano derecha
4. Menú : botón para bajar (tecla táctil)
5. Menú : botón para subir (tecla táctil)
6. Botón de ajuste , confirmar entradas (tecla táctil)
7. Botón ON/OFF (tecla táctil)
8. Electrodos, mano izquierda
9. Menú : botón hacia la izquierda (tecla táctil)
10. Soporte de aluminio
11. Electrodos de pie, pie derecho
12. Electrodos de pie, pie izquierdo

Pantalla

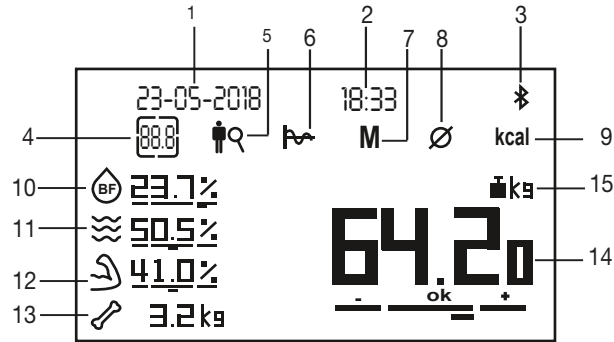


1. Fecha	2. Hora
3. Bluetooth®	4. Vista de conjunto
5. Análisis segmentado	6. Representación gráfica
7. Registros de usuario	8. Valores medios
9. Consumo de calorías	10. Proporción de grasa corporal con interpretación
11. Proporción de agua corporal con interpretación	12. Proporción de masa muscular con interpretación
13. Masa ósea con interpretación	14. Peso corporal con interpretación del IMC
15. Unidad de peso (kg, lb o st)	


5. PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

Colocación de la báscula


Coloque la báscula sobre una superficie estable y plana. Una superficie estable es el requisito para una medición correcta.

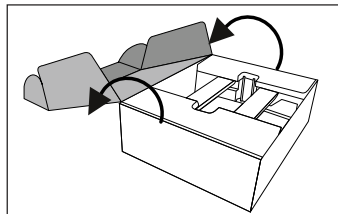


1. Abrir la caja.

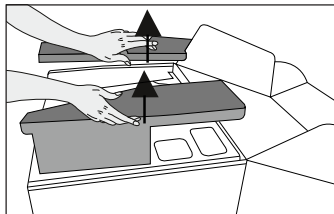


2. Retirar la cubierta de poliestireno a izquierda y derecha.

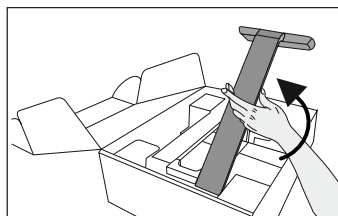


3. Levantar simultáneamente la parte superior e inferior del soporte de aluminio.

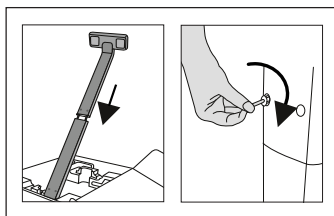


4. Encajar la parte superior del soporte en la parte inferior y atornillar en la parte superior.

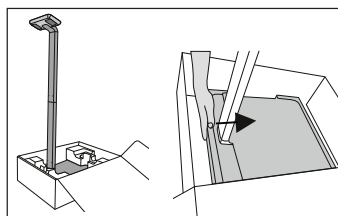


5. Colocar el soporte de aluminio en posición vertical dentro de la caja. Desplazar la báscula hacia el borde...

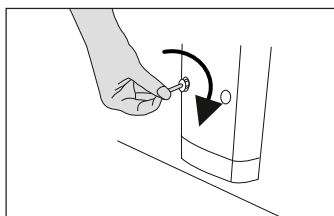

6. ...y atornillar en la parte inferior.

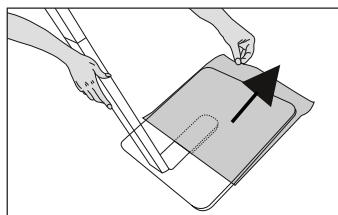

7. Sujetar con una mano el soporte y retirar la lámina con la otra mano.

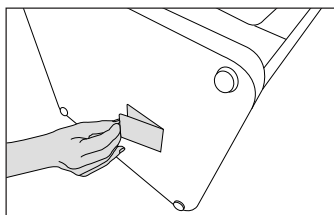

8. Insertar las pilas en la parte inferior de la báscula con la polaridad correcta (+/-). Y colocar la báscula en posición vertical sobre una superficie plana.

6. CONFIGURACIÓN DE LA BÁSCULA DIAGNÓSTICA CON APP

Para poder determinar su proporción de grasa corporal y otros valores corporales deberá memorizar sus datos de usuario personales en la báscula.

La báscula dispone de 10 posiciones de memoria para usuarios en las que usted y, por ejemplo, los miembros de su familia pueden guardar sus ajustes personales.

Los usuarios también se pueden activar a través de otros dispositivos móviles con la app "beurer HealthManager Pro" instalada o cambiando el perfil de usuario en la app (consulte los ajustes de la app).

Para que durante la puesta en funcionamiento pueda mantenerse activa una conexión *Bluetooth®*, permanezca con el smartphone cerca de la báscula.

- **Active *Bluetooth®* en los ajustes del smartphone.**
- **Descárguese la app gratuita "beurer HealthManager Pro" en el Apple App Store (iOS) o en Google Play (Android™).**
- **Abra la app y siga las instrucciones.**
 - En la app "beurer HealthManager Pro" deben estar configurados o especificarse los siguientes ajustes:

Datos de usuario	Valores de ajuste												
Iniciales	Máx. 3 caracteres (A-Z, 0-9)												
Sexo	Hombre (♂), mujer (♀)												
Estatura	100 a 250 cm (3' 03" a 8' 02")												
Fecha de nacimiento	Año, mes, día												
Grado de actividad	Al elegir el grado de actividad es fundamental considerarlo a medio y largo plazo:												
	<table><tr><td></td><td>Actividad física</td></tr><tr><td>1</td><td>Ninguna.</td></tr><tr><td>2</td><td>Baja: poco ejercicio físico y de poca intensidad (p. ej., paseos, sencillos trabajos en el jardín, ejercicios de gimnasia).</td></tr><tr><td>3</td><td>Media: ejercicio físico en sesiones de 30 minutos de 2 a 4 veces por semana como mínimo.</td></tr><tr><td>4</td><td>Alta: ejercicio físico en sesiones de 30 minutos de 4 a 6 veces por semana como mínimo.</td></tr><tr><td>5</td><td>Muy alta: ejercicios físicos intensivos, entrenamiento intensivo o trabajo corporal agotador, diariamente, al menos 1 hora cada día.</td></tr></table>		Actividad física	1	Ninguna.	2	Baja: poco ejercicio físico y de poca intensidad (p. ej., paseos, sencillos trabajos en el jardín, ejercicios de gimnasia).	3	Media: ejercicio físico en sesiones de 30 minutos de 2 a 4 veces por semana como mínimo.	4	Alta: ejercicio físico en sesiones de 30 minutos de 4 a 6 veces por semana como mínimo.	5	Muy alta: ejercicios físicos intensivos, entrenamiento intensivo o trabajo corporal agotador, diariamente, al menos 1 hora cada día.
		Actividad física											
	1	Ninguna.											
	2	Baja: poco ejercicio físico y de poca intensidad (p. ej., paseos, sencillos trabajos en el jardín, ejercicios de gimnasia).											
	3	Media: ejercicio físico en sesiones de 30 minutos de 2 a 4 veces por semana como mínimo.											
	4	Alta: ejercicio físico en sesiones de 30 minutos de 4 a 6 veces por semana como mínimo.											
5	Muy alta: ejercicios físicos intensivos, entrenamiento intensivo o trabajo corporal agotador, diariamente, al menos 1 hora cada día.												
Peso objetivo	kg/lb/st (para la representación gráfica del proceso)												

- La app le asigna el siguiente registro de usuario libre (persona 1 a persona 10).
- Realizar la medición: para la identificación automática de personas debe asignar la primera medición a sus datos personales. La app le pedirá que lo haga. Consulte al respecto el capítulo "8. Realizar la medición".

7. ALTERNATIVA: CONFIGURACIÓN DE LA BÁSCULA DIAGNÓSTICA SIN APP

Recomendamos poner en funcionamiento y configurar la báscula utilizando la app. Consulte el capítulo "6. Configuración de la báscula diagnóstica con app". No obstante, la báscula también puede ponerse en funcionamiento y configurarse directamente en el aparato.

Realice ajustes del aparato/la hora y fecha/el usuario en el mando. Para ello, realice la selección en general con los botones [] o [] y confirme cada uno de ellos con [SET].

a.) Configurar hora y fecha

[SET] → "CONFIG._TIEMPO" → [SET]

Secuencia	Valores de ajuste
Fecha	Año – Mes – Día
Hora	Horas – Minutos

b.) Configurar aparato

[SET] → "CONFIG._APTO." → [SET]

Secuencia	Valores de ajuste
Idioma	    
Unidad de medida	kg – lb – st
Hora	24 h – 12 h
Modo de invitado	ON – OFF
<i>Bluetooth®</i>	ON – OFF
	 Si el estado es "OFF", solo será posible una conexión por <i>Bluetooth®</i> si la báscula está encendida. Esto puede resultar útil para prolongar la duración de las pilas o para evitar señales radioeléctricas no deseadas.

c.) Configurar datos de usuario

[SET] → "CAMB._USUARIO" → [SET]

Datos de usuario	Valores de ajuste
Iniciales	Máx. 3 caracteres (A-Z, 0-9)
Sexo	Hombre (♂), mujer (♀)
Estatura	100 a 250 cm (3' -03" a 8'-02")
Fecha de nacimiento	Año, mes, día
Grado de actividad	1 a 5 (consulte el capítulo 6)
Peso objetivo	kg/lb/st (para la representación gráfica del proceso)
Pin de usuario	Se asigna automáticamente para una posible utilización posterior de <i>Bluetooth®</i> . Esta información solo se necesita para configurar la app posteriormente si la app se instala posteriormente y se desea agregar usuarios que utilizan la báscula.



Registro posterior en la app

Si ha puesto en funcionamiento la báscula sin la app, podrá agregar a la app "beurer HealthManager Pro" un usuario que ya utilice la báscula. Para ello será necesario introducir el PIN de cuatro dígitos. El proceso se describe en la app.

8. REALIZAR LA MEDICIÓN

8.1 Medición del peso corporal

- Pulse el botón (U) del mando. Aparece „0,0“ kg en la pantalla.
- La báscula está preparada para medir el peso. Súbase a la báscula repartiendo bien el peso entre las dos piernas. Los datos del peso no se guardan, y no es posible asignar el usuario, ya que no se realiza ninguna medición BIA a través de manos y pies.

8.2 Realizar medición de invitado

En la primera medición o si no se desean guardar datos de usuario. Para ello deberá estar activado el modo de invitado en los ajustes del aparato.

[<] → Activar "INVITADO" → [SET] o encender la báscula

Datos de usuario	Valores de ajuste
Sexo	Hombre (♂), mujer (♀)
Estatura	100 a 250 cm (3' -03" a 8'-02")
Fecha de nacimiento	Año, mes, día
Grado de actividad	1 a 5 (consulte el capítulo 6)

8.3 Medición con análisis de todo el cuerpo

- Pulse el botón (U) del mando. Aparece „0,0“ kg en la pantalla.




Si se ha activado el modo de invitado en los ajustes de la báscula, colóquese sobre la báscula apagada.

- Colóquese sobre la báscula descalzo y sujete firmemente el mando entre las manos. Sujete el mando con la parte inferior del pulgar sobre los electrodos delanteros y presione con fuerza con los dedos los electrodos traseros.
- Apóyese cuidadosamente sobre la báscula repartiendo bien el peso entre las dos piernas. Tenga en cuenta que no puede haber contacto entre ambos pies, piernas, pantorrillas y muslos.



- Si la báscula le identifica automáticamente, tras medir el peso se mide la impedancia para el análisis. Esto se indica mediante el símbolo del cuerpo en el que circula corriente.
- En cuanto concluye el análisis de todo el cuerpo, se muestra la vista general. El valor medido se memoriza automáticamente.




Nota:

La medición no se guarda en los siguientes casos:

- El usuario no se identifica automáticamente. Si sucede esto, significa que su peso difiere en ± 3 kg respecto a la última medición o que otro usuario tiene valores similares a los suyos en ± 3 kg. En ese caso pulse el botón [] para seleccionar manualmente el usuario y volver a realizar la medición.
- El usuario está calzado sobre la báscula.
- El usuario no tiene sujeto el mando entre las manos.

9. ANÁLISIS DE LOS VALORES MEDIDOS




Los resultados se evalúan automáticamente tras la medición o tras la selección manual del usuario en el mando. Seleccione su usuario con el botón []. Confirme con el botón [SET] o espere 3 segundos.



Vista de conjunto


Antes o después de un análisis de todo el cuerpo del usuario aparece en la pantalla la vista de conjunto.



Análisis segmentado de grasa corporal y masa muscular


a) Grasa corporal del brazo izquierdo y derecho

- Pulse el botón de menú [] repetidamente hasta que se marque . En la pantalla aparece el análisis segmentado de la grasa corporal del brazo izquierdo y derecho.




b) Grasa corporal de la pierna izquierda y derecha





- Cambie con el botón [] a la representación detallada de la grasa corporal de la pierna izquierda y derecha.



c) Grasa corporal del tronco





- Cambie con el botón [] a la representación detallada de la grasa corporal del tronco.



d) Grasa visceral (grasa que envuelve los órganos internos/grasa abdominal) Cambie con el botón [] a la representación detallada de la grasa visceral.	
e) Masa muscular del brazo izquierdo y derecho Cambie con el botón [] a la representación detallada de la masa muscular del brazo izquierdo y derecho.	
f) Masa muscular de la pierna izquierda y derecha Cambie con el botón [] a la representación detallada de la masa muscular de la pierna izquierda y derecha.	
g) Masa muscular del tronco Cambie con el botón [] a la representación detallada de la masa muscular del tronco.	


 Para los usuarios de 10 a 17 años de edad, no se muestra grasa visceral ni masa muscular segmentaria (brazo/pierna/tronco).

Representación gráfica

a) Peso corporal Pulse el botón de menú [] repetidamente hasta que se marque . En la pantalla aparece la evolución de su peso corporal. La evolución de su peso corporal se representa de medición en medición. Las mediciones más recientes se añaden a la derecha. La línea de referencia representa el peso objetivo.  El peso objetivo se puede modificar cuando se desee en los datos de usuario.	
b) Grasa corporal  Cambie con el botón [] a la evolución de los valores de grasa corporal . La evolución de su valor de grasa corporal se representa de medición en medición. La línea de referencia representa el valor medio de todas las mediciones de grasa corporal, y las barras indican si los valores han aumentado o se han reducido.	
c) Proporción de agua  Cambie con el botón [] a la evolución de la proporción de agua . La evolución de la proporción de agua se representa de medición en medición. La línea de referencia representa el valor medio de todas las mediciones de la proporción de agua, y las barras indican si los valores han aumentado o se han reducido.	
d) Masa muscular  Cambie con el botón [] a la evolución de la masa muscular . La evolución de la proporción de masa muscular se representa de medición en medición. La línea de referencia representa el valor medio de todas las mediciones de masa muscular, y las barras indican si los valores han aumentado o se han reducido.	

M **Mostrar valores guardados**


- Pulse el botón de menú  repetidamente hasta que se marque **M**. En la pantalla aparece el último valor medido guardado. Arriba está la fecha de la medición y el número de posición de memoria (03-03), p. ej. la tercera = última posición de memoria de las 3 posiciones de memoria ocupadas.
- Desplácese con los botones  y  por las posiciones de memoria.



 Valores medios


- Pulse el botón de menú [>] repetidamente hasta que se marque En la pantalla se representan todos los valores medios de las mediciones guardadas.

i Arriba está la fecha de la primera y de la última medición.



kcal Consumo de calorías

- Pulse el botón de menú [>] repetidamente hasta que se marque **kcal**. La tasa metabólica basal BMR calculada teóricamente y la tasa metabólica activa AMR se representarán en Kcal.



Apagar la báscula (modo de reposo)

- Esperar a que la pantalla se apague automáticamente o pulse el botón del mando para apagarla manualmente. La fecha y la hora siguen estando visibles.

10. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS

Proporción de grasa corporal

Los valores de grasa corporal se representan en la pantalla y se valoran con el gráfico de barras. Los siguientes valores de grasa corporal en % le indican una pauta (para más información, consulte a su médico).

Hombre

				
Edad	Nivel bajo	Nivel normal	Nivel alto	Nivel muy alto
10-14	<11 %	11-16 %	16,1-21 %	>21 %
15-19	<12 %	12-17 %	17,1-22 %	>22 %
20-29	<13 %	13-18 %	18,1-23 %	>23 %
30-39	<14 %	14-19 %	19,1-24 %	>24 %
40-49	<15 %	15-20 %	20,1-25 %	>25 %
50-59	<16 %	16-21 %	21,1-26 %	>26 %
60-69	<17 %	17-22 %	22,1-27 %	>27 %
70-100	<18 %	18-23 %	23,1-28 %	>28 %

Mujer

- +				
Edad	Nivel bajo	Nivel normal	Nivel alto	Nivel muy alto
10-14	<16 %	16-21 %	21,1-26 %	>26 %
15-19	<17 %	17-22 %	22,1-27 %	>27 %
20-29	<18 %	18-23 %	23,1-28 %	>28 %
30-39	<19 %	19-24 %	24,1-29 %	>29 %
40-49	<20 %	20-25 %	25,1-30 %	>30 %
50-59	<21 %	21-26 %	26,1-31 %	>31 %
60-69	<22 %	22-27 %	27,1-32 %	>32 %
70-100	<23 %	23-28 %	28,1-33 %	>33 %

Los deportistas suelen presentar valores inferiores. En función de la disciplina que se practique, de la intensidad del entrenamiento y de la constitución física, los valores alcanzados pueden estar por debajo de los valores indicativos. Tenga en cuenta que contar con valores extremadamente bajos puede suponer un riesgo para la salud.

Grasa visceral (grasa que envuelve los órganos internos/grasa abdominal)

Por grasa visceral se entiende la grasa que rodea los órganos internos en la cavidad abdominal. Se sospecha que la grasa visceral favorece enfermedades como la hipertensión o la diabetes.

La grasa visceral se representa en la pantalla con un número entre 1 y 59.

Número de la proporción de grasa visceral	Valoración
1-12	La proporción de grasa visceral está en el rango normal.
13-59	La proporción de grasa visceral es demasiado alta.

Proporción de agua corporal

La proporción de agua corporal en % suele oscilar entre los siguientes rangos:

Hombre				Mujer			
Edad	Nivel malo	Nivel bueno	Nivel muy bueno	Edad	Nivel malo	Nivel bueno	Nivel muy bueno
10-100	<50 %	50-65 %	>65 %	10-100	<45 %	45-60 %	>60 %

La grasa corporal tiene una proporción de agua relativamente baja. Por ello, las personas con una elevada proporción de grasa corporal pueden tener una proporción de agua corporal por debajo de los valores indicativos. En cambio, los deportistas de fondo pueden superar los valores indicativos debido a su baja proporción de grasa y a su elevada proporción de masa muscular. La determinación del agua corporal con esta báscula no está indicada para sacar conclusiones médicas, como, por ejemplo, edemas relacionados con la edad. En caso necesario, consulte a su médico. En general, es conveniente tener una elevada proporción de agua corporal.

Masa muscular

Al medir la proporción de masa muscular, se calcula la masa del músculo esquelético. No se tienen en cuenta los músculos de los órganos. La masa muscular en % suele oscilar entre los siguientes rangos:

Hombre				Mujer			
Edad	Nivel bajo	Nivel normal	Nivel alto	Edad	Nivel bajo	Nivel normal	Nivel alto
10-14	<44 %	44-57 %	>57 %	10-14	<36 %	36-43 %	>43 %
15-19	<43 %	43-56 %	>56 %	15-19	<35 %	35-41 %	>41 %
20-29	<42 %	42-54 %	>54 %	20-29	<34 %	34-39 %	>39 %
30-39	<41 %	41-52 %	>52 %	30-39	<33 %	33-38 %	>38 %
40-49	<40 %	40-50 %	>50 %	40-49	<31 %	31-36 %	>36 %
50-59	<39 %	39-48 %	>48 %	50-59	<29 %	29-34 %	>34 %
60-69	<38 %	38-47 %	>47 %	60-69	<28 %	28-33 %	>33 %
70-100	<37 %	37-46 %	>46 %	70-100	<27 %	27-32 %	>32 %

Masa ósea

Al igual que el resto de nuestro cuerpo, nuestros huesos están sometidos a procesos naturales de crecimiento, degeneración y envejecimiento. Durante la infancia la masa ósea aumenta rápidamente y alcanza su máximo entre los 30 y los 40 años. Conforme aumenta la edad, la masa ósea vuelve a reducirse. Una alimentación saludable (especialmente calcio y vitamina D) y la actividad física regular pueden ser eficaces contra esta reducción. Con un desarrollo muscular específico, puede fortalecer de forma complementaria la estabilidad de su estructura ósea. Tenga en cuenta que esta báscula registra el contenido de minerales de los huesos. Apenas se puede influir sobre la masa ósea, pero esta oscila ligeramente según diversos factores (peso, estatura, edad y sexo). No existen pautas o recomendaciones reconocidas.



No confunda la masa ósea con la densidad ósea. La densidad ósea solo puede determinarse mediante un examen médico (p. ej., tomografía computarizada, ultrasonido). Por ello, con esta báscula no es posible sacar conclusiones de las modificaciones de los huesos y de la dureza de estos (por ejemplo, osteoporosis).

BMR

La tasa metabólica basal (BMR = Basal Metabolic Rate) es la cantidad de energía corporal necesaria para mantener las funciones básicas cuando el organismo se encuentra en un estado de inactividad total (p. ej., si se pasan 24 horas en cama). Este valor

depende fundamentalmente del peso, de la estatura y de la edad. En la báscula diagnóstica, este valor se visualiza en la unidad kcal/día y se calcula mediante la fórmula de Mifflin-St.Jeor, reconocida científicamente.

Esta es la cantidad mínima de energía que necesita el cuerpo y que tiene que recibir en forma de alimento. Si recibe menos energía durante mucho tiempo, puede ser perjudicial para la salud.

AMR

La tasa metabólica activa (AMR = Active Metabolic Rate) es la cantidad de energía diaria que consume el cuerpo en estado de actividad. El consumo de energía de una persona es mayor conforme aumenta la actividad física. En la báscula diagnóstica se determina a través del grado de actividad indicado (1-5).

Para mantener el peso actual se debe aportar al cuerpo la energía consumida en forma de comida y bebida. Si, durante un largo periodo de tiempo, se ingiere menos energía de la consumida, el cuerpo recupera esta diferencia principalmente a partir de las reservas de grasa, lo que provoca una pérdida de peso. Si, en cambio, durante un largo periodo de tiempo se ingiere más energía que la tasa metabólica activa (AMR) calculada, el cuerpo no consigue quemar este exceso de energía, que se almacena en forma de grasa en el cuerpo, lo que provoca un aumento de peso.

Relación temporal de los resultados



Tenga en cuenta que solo es importante la tendencia a largo plazo. Las diferencias de peso rápidas en el plazo de pocos días suelen deberse a la pérdida de líquidos.

La interpretación de los resultados se rige por los cambios del peso total y por los de la proporción de grasa corporal, agua corporal y masa muscular, así como por el tiempo durante el que ocurren dichos cambios. Deben diferenciarse los cambios bruscos en cuestión de días de los cambios a medio plazo (semanas) y los cambios a largo plazo (meses).

Por regla general, los cambios a corto plazo en el peso prácticamente solo suponen cambios en la proporción de agua, mientras que los cambios a medio y largo plazo también pueden afectar a la masa muscular y a la proporción de grasa.

- Si el peso disminuye a corto plazo, pero la proporción de grasa aumenta o permanece igual, significa que solo ha perdido agua (por ejemplo, después de entrenar, de ir a la sauna o de seguir una dieta restrictiva para perder peso rápidamente).
- En cambio, cuando el peso aumenta a medio plazo, pero la proporción de grasa corporal disminuye o permanece igual, puede haber generado una valiosa masa muscular.
- Cuando el peso y la proporción de grasa corporal disminuyen a la vez, es que su dieta está funcionando y está perdiendo masa adiposa.
- Lo ideal es que acompañe su dieta con actividad física, entrenamiento o ejercicios de fuerza. De este modo podrá aumentar su masa muscular a medio plazo.
- La grasa corporal, el agua o la masa muscular no pueden sumarse (el tejido muscular también incluye componentes de agua corporal).

11. TRANSFERIR VALORES MEDIDOS MEDIANTE APP

Si la app no está abierta, las nuevas mediciones asignadas se almacenan en la báscula. En la báscula se pueden almacenar como máximo 30 mediciones por cada usuario. Los valores almacenados se transfieren automáticamente a la app si la abre en el radio de alcance de *Bluetooth®*. También es posible la transferencia automática con la báscula apagada si la función *Bluetooth®* está activada en los ajustes del aparato.

12. MÁS INFORMACIÓN

Borrar datos de la báscula

a) Borrar usuario con todos los ajustes y valores guardados

- Tras encender la báscula seleccione un usuario pulsando el botón []. Pulse en su caso el botón repetidamente y confirme con [SET].
- Si aparece la indicación 0.0, pulse el botón [SET] durante 12 segundos para borrar el usuario.
- Seleccione con los botones [], [] "Sí" y confirme la pregunta con el botón [SET]. Si no desea borrar el usuario, confirme "NO" con el botón [SET].



Se borran todos los ajustes y valores guardados de este usuario.

b) Borrar un valor guardado de un usuario

- Seleccione en el registro de usuarios [M] un valor y pulse el botón [SET] del mando brevemente para borrar el valor visualizado.
- Esto se puede hacer también inmediatamente después de la medición.
- Seleccione con los botones [], [] "Sí" y confirme la pregunta con el botón [SET]. Si no desea borrar el valor, confirme "NO" con el botón [SET].

c) Borrar todos los valores guardados de un usuario

- Acceda al registro de usuarios [M] y pulse el botón [SET] del mando durante aprox. 5 segundos para borrar todos los valores.
- Seleccione con los botones [], [] "Sí" y confirme la pregunta con el botón [SET]. Si no desea borrar nada, confirme "NO" con el botón [SET].

Cambiar las pilas

El mando dispone de un indicador de cambio de pilas. En la pantalla aparece BATERÍA_BAJA si las pilas de la báscula están muy gastadas. En este caso, deben sustituirse las pilas. Después, vuelva a conectar la báscula con la app. La hora del sistema se actualiza.



Nota:

- Cada vez que tenga que cambiar las pilas, hágalo por unas del mismo tipo y de la misma marca y capacidad.
- No utilice pilas recargables.
- Utilice pilas sin metales pesados.

13. LIMPIEZA Y CUIDADO

Limpie la superficie de la báscula de vez en cuando con un paño ligeramente humedecido. No vuelva a utilizar la báscula hasta que la superficie de esta esté completamente seca.



Nota:

- No utilice productos de limpieza corrosivos.
- No sumerja nunca la báscula en agua. No lave nunca la báscula debajo del grifo.
- No coloque ningún objeto sobre la báscula cuando esta no se esté utilizando.
- Proteja la báscula de golpes, humedad, polvo, sustancias químicas, grandes cambios de temperatura y manténgala alejada de fuentes de calor (hornos, radiadores).

14. ELIMINACIÓN

Las pilas usadas y completamente descargadas deben desecharse en contenedores de recogida señalados de forma especial, los puntos de recogida de residuos especiales o entregándolas a un distribuidor de equipos electrónicos. Los usuarios están obligados por ley a desechar las pilas correctamente.

Estos símbolos se encuentran en pilas que contienen sustancias tóxicas:

Pb = la pila contiene plomo,
Cd = la pila contiene cadmio,
Hg = la pila contiene mercurio.



A fin de preservar el medio ambiente, cuando el aparato llegue al final de su vida útil no lo deseche con la basura doméstica. Se puede desechar en los puntos de recogida adecuados disponibles en su zona.

Deseche el aparato según lo dispuesto en la Directiva europea sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Para más información, póngase en contacto con la autoridad municipal competente en materia de eliminación de residuos.



15. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si la báscula detecta un error al realizar la medición, se mostrará lo siguiente:

Indicación en la pantalla	Causa	Solución
"SOBRECARGA"	Se ha superado la capacidad de carga máxima de 200 kg.	Solo pueden pesarse 200 kg.
"BATERÍA_BAJA"	Las pilas están casi gastadas.	Cambie las pilas (consulte el capítulo "Cambiar las pilas").
"MEMORIA_LLENA"	Hay 30 mediciones guardadas.	Transfiera los valores medidos.
"ERROR_CONTACTO" "ERROR"	La resistencia eléctrica entre los electrodos y la planta del pie es demasiado alta (p. ej., en caso de durezas pronunciadas).	Repita la medición descalzo. Humedezca en su caso ligeramente las plantas de los pies. Elimine en su caso las durezas de las plantas de los pies. Sujete los electrodos de mano con los dedos detrás y con la base de la mano delante.
"ERROR_DATOS"	La medición BIA fue correcta pero la proporción de grasa está fuera del rango medible (inferior al 3 % o superior al 65 %).	Repita la medición descalzo o con las plantas de los pies ligeramente húmedas. Modifique en su caso el grado de actividad ajustado.
Ninguna indicación	Las pilas están completamente gastadas.	Cambie las pilas (consulte el capítulo "Cambiar las pilas").
	Las pilas no se han colocado correctamente.	Compruebe que la polaridad sea correcta (consulte "Puesta en funcionamiento" -> "Cambiar las pilas").
Solo se indica el peso, falta el diagnóstico	Medición desconocida, ya que la asignación de usuarios está fuera del límite o no es posible una asignación inequívoca.	Seleccione el usuario en la báscula con el botón [] o repita la asignación de usuario en la app. Sujete los electrodos del mando y súbase descalzo a la plataforma.

Medición de peso errónea

Posibles errores	Solución
El punto cero de la báscula es incorrecto.	Encienda la báscula, espere aprox. 5 segundos y repita la medición.
La báscula está sobre una alfombra o moqueta.	Coloque la báscula sobre un suelo plano y estable. Colóquese hacia fuera todo lo que pueda sin inclinar la báscula.
Se visualiza un peso erróneo.	Quédese quieto.
Se visualiza un peso erróneo.	Espere a que la báscula vuelva a apagarse sola. Repita a continuación la medición.

Sin conexión *Bluetooth*® (falta el símbolo)

Posibles errores	Solución
Conexión inalámbrica	El radio de alcance mínimo al aire libre es de aprox. 10 m. Las paredes y los techos reducen el radio de alcance. La presencia de otras ondas radioeléctricas puede interferir en la transferencia. Por este motivo, no coloque la báscula cerca de otros equipos, como, p. ej., routers WIFI, microondas o cocinas de inducción.
Conexión <i>Bluetooth</i> ®	Cierre por completo la app (también si está abierta en segundo plano). Desactive la función <i>Bluetooth</i> ® y vuelva a activarla. Apague el smartphone y vuelva a encenderlo. Retire brevemente las pilas de la báscula y vuelva a insertarlas. Encontrará las preguntas frecuentes en www.beurer.com .
Se tarda demasiado en establecer la conexión	Intervalo <i>Bluetooth</i> ® más rápido con la báscula encendida.

16. DATOS TÉCNICOS

Dimensiones de la báscula	380 x 390 x 1000 mm
Pilas de la báscula	4 de 1,5V tipo AA
Rango de medición	De 8 a 200 kg
Indicación en la pantalla:	La indicación de la pantalla se lee en pasos de 0,05 kg.
Precisión de repetición:	La tolerancia de medición para mediciones repetidas es de +/- 0,5 kg (medición varias veces consecutivas en la misma báscula con la misma posición, en la medida de lo posible, de la báscula y la persona).
Precisión absoluta:	El valor de medición comparado con un peso calibrado es +/- 0,5 % + 0,05 kg. P. ej., para 50 kg corresponde a +/- 0,3 kg, para 100 kg a +/- 0,55 kg.
Transferencia de datos por <i>Bluetooth</i> ® wireless technology	El producto utiliza <i>Bluetooth</i> ® low energy technology, banda de frecuencias 2,402–2,480 GHz, potencia de emisión máx. 0 dBm, compatible con smartphones/tablets <i>Bluetooth</i> ® 4.0

Requisitos del sistema y lista de aparatos compatibles para la app «Beurer HealthManager Pro» *



Salvo modificaciones técnicas.

*Este producto cumple los requisitos de las directrices europeas vigentes.

Garantizamos que este producto cumple la Directiva europea 2014/53/UE de equipos radioeléctricos.

Encontrará la declaración de conformidad CE de este producto en:

<https://www.beurer.com/web/we-landingpages/de/declarationofconformity.php>

17. GARANTÍA/ASISTENCIA

Encontrará más información sobre la garantía y sus condiciones en el folleto de garantía suministrado.



Leggere le presenti istruzioni per l'uso con attenzione. Attenersi alle avvertenze e alle indicazioni di sicurezza. Conservare le istruzioni per l'uso per riferimento futuro. Rendere accessibili le istruzioni per l'uso ad altri utenti. In caso di cessione dell'apparecchio consegnare anche le istruzioni per l'uso.

Contenuto

1. Fornitura	59	9. Analisi dei valori misurati	66
2. Spiegazione dei simboli	60	10. Valutazione dei risultati	68
3. Segnalazione di rischio e indicazioni di sicurezza	60	11. Trasmissione dei valori misurati tramite app	70
4. Descrizione dell'apparecchio	62	12. Ulteriori informazioni	70
5. Messa in funzione	63	13. Pulizia e cura	70
6. Configurazione della bilancia diagnostica con la app	63	14. Smaltimento	70
7. In alternativa: configurazione della bilancia diagnostica senza app	64	15. Che cosa fare in caso di problemi?	71
8. Esecuzione della misurazione	65	16. Dati tecnici	72
		17. Garanzia/Assistenza	72

Introduzione

Funzioni dell'apparecchio

Questa bilancia digitale consente di pesarsi e di rilevare i dati relativi alla forma fisica dell'utente.

L'apparecchio è destinato all'uso privato.

La bilancia dispone delle seguenti funzioni, utilizzabili da un massimo di 10 persone:

- calcolo del peso
- calcolo della massa grassa
- percentuale di grasso viscerale (grasso sugli organi/sull'addome),
- percentuale di acqua corporea
- percentuale di massa muscolare
- massa ossea nonché
- tasso metabolico basale e attivo.

La bilancia dispone inoltre delle seguenti funzioni:

- misurazione incrociata con 8 elettrodi, che permette l'analisi dei segmenti, cioè una rappresentazione separata delle singole parti del corpo (braccia, gambe, tronco)
- innovativa guida sotto forma di menu su ampio display (disponibile in 5 lingue)
- commutazione tra chilogrammi "kg", libbre "lb" e Stone "st"
- indicazione di sostituzione batterie in caso di batterie scariche
- riconoscimento automatico dell'utente
- memorizzazione delle ultime 30 misurazioni per 10 persone, se non possono essere trasferite alla app
- modalità ospite (senza funzione di memorizzazione).

Principio di misurazione

Questa bilancia utilizza il principio di misurazione B.I.A., l'analisi dell'impedenza bioelettrica. Nel giro di pochi secondi, una corrente impercettibile, assolutamente innocua e non pericolosa, determina le diverse percentuali corporee.

Grazie alla misurazione della resistenza elettrica (impedenza) e prendendo in considerazione costanti e/o valori individuali (età, statura, sesso, livello di attività) è possibile determinare la percentuale di massa grassa e altre caratteristiche corporee. I tessuti muscolari e l'acqua presentano una buona conducibilità elettrica e di conseguenza una resistenza più bassa. Le ossa e i tessuti adiposi sono invece caratterizzati da una scarsa conducibilità in quando le cellule adipose e le ossa presentano un'elevata resistenza che ostacola la conduzione della corrente.

Il contatto elettrico con il corpo attraverso i 4 elettrodi per le mani e i 4 elettrodi per i piedi viene ottimizzato per ottenere una precisione di misurazione più elevata e pertanto un'analisi migliore. Con questa tecnica di analisi sensibile è possibile che in caso di misurazioni ripetute si ottengano valori leggermente diversi. Il motivo risiede nelle differenze durante la misurazione dell'impedenza (ad es. un diverso contatto elettrico tra elettrodi e mani e piedi, una diversa distribuzione dell'acqua nel corpo).

I valori rilevati dalla bilancia diagnostica si avvicinano solo ai valori reali ottenuti con analisi mediche. Solo uno specialista è in grado di eseguire il calcolo esatto di massa grassa, percentuale di acqua, massa muscolare e massa ossea attraverso metodi medici (ad es. la TAC).

1. FORNITURA

Controllare l'integrità esterna della confezione e la completezza del contenuto. Prima dell'uso assicurarsi che l'apparecchio e gli accessori non presentino nessun danno palese e che il materiale di imballaggio sia stato rimosso. In caso di dubbio, non utilizzare l'apparecchio e consultare il proprio rivenditore o contattare il Servizio clienti indicato.

- Bilancia diagnostica con display elevato su supporto in alluminio
- 4 batterie AA da 1,5V
- Le presenti istruzioni per l'uso
- 2 guide rapide
- Kit di montaggio (4 viti con 2 viti di ricambio + chiave per cava esagonale)

2. SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI

I seguenti simboli sono utilizzati nelle istruzioni per l'uso, sull'imballo e sulla targhetta dell'apparecchio:

 AVVERTENZA Identifica un possibile pericolo. Se non evitato, può provocare lesioni gravi o mortali.			
	Informazioni sul prodotto Indicazione di informazioni importanti		Marchio UKCA (valutazione di conformità nel Regno Unito)
	L'apparecchio non può essere utilizzato da persone con impianti medicali (ad es. pacemaker) per non comprometterne il funzionamento.		Simbolo importatore
	Marchio CE Il presente prodotto soddisfa i requisiti delle direttive europee e nazionali vigenti.		Produttore
	I prodotti sono comprovatamente conformi ai requisiti delle normative tecniche dell'UEE		Separare il prodotto e i componenti dell'imballaggio e smaltirli secondo le norme comunali.
	Il dispositivo elettrico non deve essere smaltito nei rifiuti domestici		Consultare le istruzioni per l'uso
	Non smaltire le batterie contenenti sostanze tossiche insieme ai rifiuti domestici		Etichetta di identificazione del materiale di imballaggio. A = abbreviazione del materiale, B = codice materiale: 1-7 = plastica, 20-22 = carta e cartone
	Pericolo di scivolamento! Non salire sulla bilancia in presenza di umidità		Posizionare la bilancia su un fondo piano e solido. Non posizionare la bilancia su un tappeto.
	Pericolo di ribaltamento! Non salire sul bordo esterno.		

3. SEGNALE DI RISCHIO E INDICAZIONI DI SICUREZZA

AVVERTENZA

- L'apparecchio è adatto solo alla pesatura delle persone e a determinare i dati relativi alla forma fisica personali. L'apparecchio è adatto esclusivamente all'uso diretto da parte del cliente e non è previsto un suo utilizzo medico o commerciale. Utilizzare l'apparecchio solo per lo scopo per il quale è stato concepito e come descritto nelle presenti istruzioni per l'uso.
- **L'apparecchio non può essere utilizzato da persone con impianti medicali (ad es. pacemaker) per non comprometterne il funzionamento.**
- **Non utilizzare l'apparecchio in gravidanza.**
- **Pericolo di ribaltamento!** Appoggiare la bilancia su una base in piano. Non salire sul bordo esterno della bilancia e solo su un lato.
- **Pericolo di scivolamento!** Non salire sulla bilancia con i piedi bagnati. Non salire sulla bilancia se la superficie è umida. Non salire sulla bilancia con le calze.
- Tenere presente che sono possibili tolleranze di misurazione poiché non si tratta di una bilancia calibrata per utilizzo medico professionale.
- Per qualsiasi trattamento o dieta dimagrante o ingrassante occorre una consulenza qualificata da parte di personale specializzato (ad es. un medico). I valori rilevati dalla bilancia possono supportare il personale specializzato.



- Nei bambini, negli atleti professionisti o nelle persone con limitazioni mediche o fisiche (ad es. sintomi di edema, osteoporosi, assunzione di farmaci cardiovascolari o vasoattivi, persone con anomalie anatomiche significative delle gambe), il calcolo della massa grassa può generare risultati imprecisi o non plausibili.
- Le riparazioni possono essere effettuate solo dal Servizio clienti di Beurer o da rivenditori autorizzati. Non aprire mai la bilancia da soli.

Avvertenze di sicurezza sull'uso delle batterie

- Inserire sempre le batterie correttamente e rispettando le polarità (+ / -). Tenere le batterie pulite, asciutte e lontano dall'acqua. Scegliere sempre il tipo di batteria corretto.
- Non cortocircuitare mai le batterie e i contatti del vano batterie.
- Non caricare, scaricare in modo forzato, riscaldare, smontare, deformare, incapsulare o modificare le batterie.
- Non saldare o brasare mai le batterie.
- Non utilizzare mai contemporaneamente batterie di diversa fabbricazione, capacità (nuove e usate), dimensioni e tipo all'interno dello stesso apparecchio.
- **Rischio di esplosione!** Il mancato rispetto di questi punti può provocare lesioni personali, surriscaldamento, fuoriuscite di liquido, di gas, rottura, esplosione o incendio.
- In caso di fuoriuscita di liquido dalle batterie, indossare guanti protettivi e pulire il vano batterie con un panno asciutto.
- Se il liquido di una batteria viene a contatto con la pelle o con gli occhi, sciacquare le parti interessate con acqua e consultare un medico.
- **Pericolo d'ingestione!** Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini. In caso di ingestione consultare immediatamente un medico.
- Non permettere mai ai bambini di sostituire le batterie senza la supervisione di un adulto.
- Conservare le batterie lontano da oggetti metallici, in un luogo ben ventilato, fresco e asciutto.
- Non esporre mai le batterie alla luce diretta del sole o alla pioggia.
- In caso di inutilizzo prolungato, rimuovere le batterie dall'apparecchio.
- Smaltire le batterie scariche immediatamente e in modo corretto. Non gettare mai le batterie nel fuoco.
- In fase di smaltimento, tenere separate l'una dall'altra le batterie con diversi sistemi elettrochimici.


Indicazioni generali

- Il carico massimo della bilancia è 200 kg (440 lb, 31 st). La misurazione del peso viene visualizzata in intervalli di 50 g (0,1 lb).
- I risultati relativi a massa grassa, percentuale di acqua e massa muscolare vengono visualizzati in intervalli di 0,1%.
- Il fabbisogno calorico viene indicato in intervalli di 1 kcal.
- Al momento della consegna la bilancia è impostata sulle unità "cm" e "kg". Le impostazioni delle unità possono essere modificate durante la messa in servizio con la app.

Suggerimenti generali


- Per ottenere risultati confrontabili è consigliabile pesarsi possibilmente sempre alla stessa ora (preferibilmente al mattino), a digiuno e senza vestiti.
- Importante durante la misurazione: il calcolo della massa grassa può essere eseguito solo mediante la misurazione con le mani e a piedi nudi ed eventualmente inumidendo leggermente le piante dei piedi.
- Le piante dei piedi completamente asciutte o callose possono produrre risultati insoddisfacenti in quanto presentano una conducibilità insufficiente.
- Restare dritti e fermi durante il processo di pesatura.
- Attendere alcune ore dopo uno sforzo fisico inusuale.
- Attendere circa 15 minuti dopo essersi alzati in modo che l'acqua all'interno del corpo possa distribuirsi.
- Viene considerata solo la tendenza a lungo termine. Generalmente le variazioni di peso a breve termine nell'arco di pochi giorni dipendono da una perdita di liquidi; tuttavia la percentuale di acqua nel corpo è un fattore importante per il benessere.

4. DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO

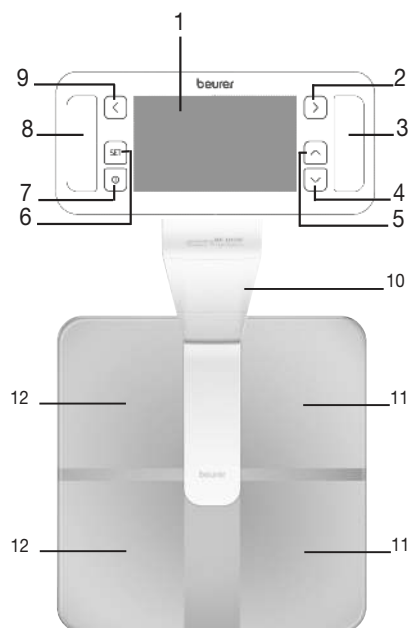

1. Display
2. > Menu: pulsante destra (sensore)
3. Elettrodi, mano destra
4. ▾ Menu: pulsante Giù (sensore)
5. ▲ Menu: pulsante Su (sensore)
6. [SET] Pulsante impostazione, conferma dei valori immessi (sensore)
7. [ON/OFF] Pulsante ON/OFF (sensore)
8. Elettrodi, mano sinistra
9. < Menu: pulsante sinistra (sensore)
10. Supporto in alluminio
11. Elettrodi per piede, piede destro
12. Elettrodi per piede, piede sinistro

Display

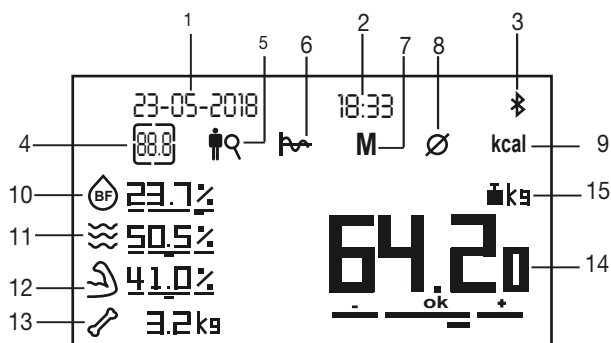


1. Data	2. Ora
3. Bluetooth®	4. Panorama complessiva
5. Analisi dei segmenti	6. Rappresentazione grafica
7. Memoria utente	8. Valori medi
9. Consumo calorico	10. Massa grassa con interpretazione
11. Percentuale di acqua corporea con interpretazione	12. Massa muscolare con interpretazione
13. Massa ossea con interpretazione	14. Peso corporeo con interpretazione IMC
15. Unità di peso (kg, lb o st)	


5. MESSA IN FUNZIONE

Posizionamento della bilancia


Appoggiare la bilancia su una base piana e solida. Una superficie solida è il presupposto per una misurazione corretta.

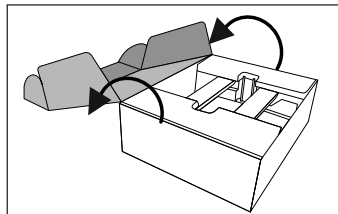


1. Aprire la confezione.

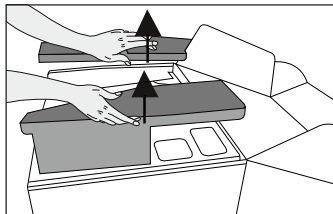


2. Rimuovere la copertura in polistirolo espanso a sinistra e a destra.

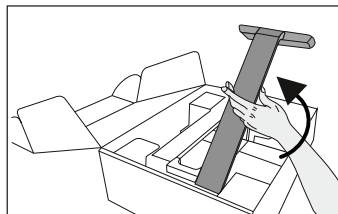


3. Sollevare contemporaneamente la parte superiore e inferiore del supporto in alluminio.

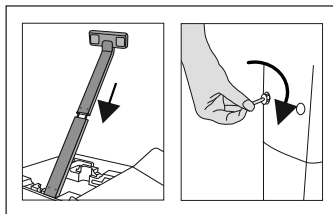


4. Infilare la parte superiore del supporto in alluminio nella parte inferiore e avvitare in alto.

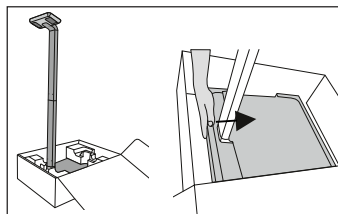


5. Mettere il supporto in alluminio in posizione verticale all'interno della confezione. Spingere la bilancia verso il bordo...

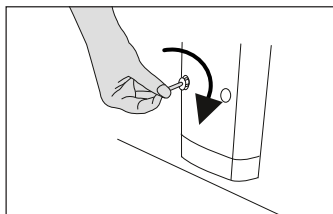

6. ...e avvitare in basso.

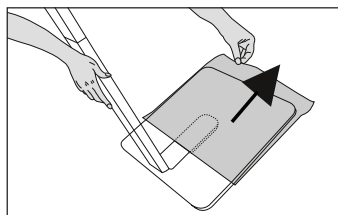

7. Con una mano tenere fermo il supporto e con l'altra rimuovere la pellicola.

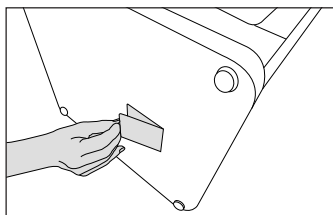

8. Inserire le batterie nella parte inferiore della bilancia con i poli (+/-) posizionati in base alle indicazioni. E appoggiare la bilancia di coltello su una superficie piana.

6. CONFIGURAZIONE DELLA BILANCIA DIAGNOSTICA CON LA APP

Per determinare la massa grassa e altri valori, è necessario memorizzare i dati utente personali sulla bilancia. La bilancia dispone di 10 posizioni di memoria in cui l'utente e i familiari possono memorizzare impostazioni personali.

Inoltre, gli utenti possono essere attivati tramite altri dispositivi mobili dotati dell'app "beurer HealthManager Pro" oppure tramite cambio di profilo nell'app (vedere Impostazioni dell'app).

Per mantenere una connessione *Bluetooth®* attiva durante la messa in funzione, restare con lo smartphone nelle vicinanze della bilancia.

- **Attivare il *Bluetooth®* nelle impostazioni dello smartphone.**
- **Scaricare l'app gratuita "beurer HealthManager Pro" dall'Apple App Store (iOS) oppure da Google Play (Android™).**
- **Avviare l'app e seguire le istruzioni.**
 - Le seguenti impostazioni devono essere effettuate o inserite nella app "beurer HealthManager Pro".

Dati utente	Valori di impostazione												
Iniziali	max 3 caratteri (A-Z, 0-9)												
Sesso	Maschio (♂), femmina (♀)												
Statura	Da 100 a 250 cm (da 3' 03" a 8' 02")												
Data di nascita	anno, mese, giorno												
Liv. attività	Per la selezione del livello di attività si distingue fra osservazione a medio e a lungo termine:												
	<table><tr><td></td><td>Attività fisica</td></tr><tr><td>1</td><td>Nessuna</td></tr><tr><td>2</td><td>Ridotta: attività fisica ridotta e leggera (ad es. passeggiare, lavori di giardinaggio leggeri, esercizi ginnici)</td></tr><tr><td>3</td><td>Media: attività fisica, almeno 2-4 volte alla settimana, 30 minuti per sessione</td></tr><tr><td>4</td><td>Impegnativa: attività fisica, almeno 4-6 volte alla settimana, 30 minuti per sessione</td></tr><tr><td>5</td><td>Molto impegnativa: attività fisica intensa, allenamento intensivo o lavoro fisico pesante, quotidiano, per almeno un'ora</td></tr></table>		Attività fisica	1	Nessuna	2	Ridotta: attività fisica ridotta e leggera (ad es. passeggiare, lavori di giardinaggio leggeri, esercizi ginnici)	3	Media: attività fisica, almeno 2-4 volte alla settimana, 30 minuti per sessione	4	Impegnativa: attività fisica, almeno 4-6 volte alla settimana, 30 minuti per sessione	5	Molto impegnativa: attività fisica intensa, allenamento intensivo o lavoro fisico pesante, quotidiano, per almeno un'ora
		Attività fisica											
	1	Nessuna											
	2	Ridotta: attività fisica ridotta e leggera (ad es. passeggiare, lavori di giardinaggio leggeri, esercizi ginnici)											
	3	Media: attività fisica, almeno 2-4 volte alla settimana, 30 minuti per sessione											
4	Impegnativa: attività fisica, almeno 4-6 volte alla settimana, 30 minuti per sessione												
5	Molto impegnativa: attività fisica intensa, allenamento intensivo o lavoro fisico pesante, quotidiano, per almeno un'ora												
Peso desiderato	kg/lb/st (per rappresentazione grafica dell'andamento)												

- L'app mostra le successive memorie utente della bilancia libere (Persona 1-Persona 10).
- Esecuzione della misurazione: per il riconoscimento automatico della persona, assegnare alla prima misurazione i dati personali dell'utente. L'app li richiede. Al riguardo vedere il capitolo "8. Esecuzione della misurazione".

7. IN ALTERNATIVA: CONFIGURAZIONE DELLA BILANCIA DIAGNOSTICA SENZA APP

Si consiglia di eseguire la messa in funzione e tutte le impostazioni tramite app. Vedere il capitolo "6. Configurazione della bilancia diagnostica con la app". Tuttavia, è possibile anche procedere sull'apparecchio. Effettuare le impostazioni apparecchio/ora/utente sul dispositivo di comando. Selezionare l'opzione desiderata tramite i pulsanti [] o [] e confermare con il pulsante [SET].

a.) Impostazione dell'ora

[SET] → "IMPOSTA ORA" → [SET]

Sequenza	Valori di impostazione
Data	Anno – Mese – Giorno
Ora	Ore – Minuti

b.) Impostazione dell'apparecchio

[SET] → "IMPOSTA APPAR." → [SET]

Sequenza	Valori di impostazione
Lingua	    
Unità di misura	kg – lb – st
Ora	24 h – 12 h
Modalità ospite	ON – OFF
<i>Bluetooth®</i>	ON – OFF  Se "OFF", la connessione <i>Bluetooth®</i> è possibile solo quando la bilancia è accesa. Questo può essere importante per aumentare la durata delle batterie o per evitare l'emissione indesiderata di onde.

c.) Impostazione dei dati utente

[SET] → "CAMBIA PERSONA" → [SET]




Nota

non avviene alcuna memorizzazione della misurazione nelle seguenti condizioni:

- L'utente non viene riconosciuto automaticamente. Se questo accade, il peso misurato potrebbe variare di +/- 3 kg dall'ultima misurazione oppure essere simile a quello di un altro utente con una differenza di +/- 3 kg. Premere quindi il pulsante [↵] per selezionare manualmente l'utente.
- L'utente è salito sulla bilancia con le scarpe.
- L'utente non tiene in mano il dispositivo di comando.

9. ANALISI DEI VALORI MISURATI




L'analisi dei risultati avviene automaticamente dopo la misurazione oppure dopo la selezione utente manuale sul dispositivo di comando. Selezionare l'utente con il pulsante [↵]. Confermare con il pulsante [SET] o attendere 3 secondi.



Panoramica complessiva

Prima o dopo l'analisi del corpo dell'utente, sul display viene visualizzata una panoramica complessiva a colpo d'occhio.



Analisi dei segmenti per massa grassa e massa muscolare


a) Massa grassa del braccio sinistro e del braccio destro

- Premere il pulsante menu [➤] ripetutamente fino a che [👤] viene selezionato. Sul display viene visualizzata l'analisi dei segmenti relativa alla massa grassa del braccio sinistro e destro.




b) Massa grassa delle gambe sinistra e destra

- Con il pulsante [↵] passare alla rappresentazione dettagliata della massa grassa delle gambe sinistra e destra.




c) Massa grassa del tronco

- Con il pulsante [↵] passare alla rappresentazione dettagliata della massa grassa del tronco.




d) Grasso viscerale (grasso sugli organi/sull'addome)



- Con il pulsante [↵] passare alla rappresentazione dettagliata del grasso viscerale.



e) Massa muscolare del braccio sinistro e del braccio destro



- Con il pulsante [↵] passare alla rappresentazione dettagliata della massa muscolare del braccio sinistro e del braccio destro.




f) Massa muscolare delle gambe sinistra e destra Con il pulsante [>] passare alla rappresentazione dettagliata della massa muscolare delle gambe sinistra e destra.	
g) Massa muscolare del tronco Con il pulsante [>] passare alla rappresentazione dettagliata della massa muscolare del tronco.	

 Per gli utenti di età compresa tra 10 e 17 anni il grasso viscerale e la massa muscolare segmentata (braccia/gambe/corpo) non vengono visualizzati.


Rappresentazione grafica

a) Peso corporeo Premere il pulsante menu [>] ripetutamente fino a che  viene selezionato. Sul display viene visualizzato l'andamento del peso corporeo. L'andamento del peso corporeo viene rappresentato di misurazione in misurazione. Le misurazioni più recenti vengono inserite a destra. La linea di riferimento indica il peso desiderato.  Il peso desiderato può essere modificato nei dati utente in qualsiasi momento.	
b) Massa grassa  Con il pulsante [>] passare all'andamento della massa grassa . L'andamento della massa grassa viene rappresentato di misurazione in misurazione. La linea di riferimento rappresenta il valore medio di tutte le misurazioni della massa grassa, le barre indicano se i valori sono variati verso l'alto o verso il basso.	
c) Percentuale di acqua  Con il pulsante [>] passare all'andamento della percentuale di acqua . L'andamento della percentuale di acqua viene rappresentato di misurazione in misurazione. La linea di riferimento rappresenta il valore medio di tutte le misurazioni della percentuale di acqua, le barre indicano se i valori sono variati verso l'alto o verso il basso.	
d) Massa muscolare  Con il pulsante [>] passare all'andamento della massa muscolare . L'andamento della massa muscolare viene rappresentato di misurazione in misurazione. La linea di riferimento rappresenta il valore medio di tutte le misurazioni della massa muscolare, le barre indicano se i valori sono variati verso l'alto o verso il basso.	

M Visualizzazione dei valori memorizzati

- Premere il pulsante menu [>] ripetutamente fino a che  viene selezionato. Sul display viene visualizzato l'ultimo valore misurato. In alto vi è la data della misurazione e il numero della posizione di memoria (03-03) ad es. la terza = l'ultima posizione di memoria di 3 posizioni di memoria impostate in totale. - Con i pulsanti [, >] cambiare posizione di memoria.	
--	--

Valori medi

Premere il pulsante menu [>] ripetutamente fino a che  viene selezionato. Sul display vengono visualizzati tutti i valori medi dalle misurazioni memorizzate.  In alto vi è la data della prima e dell'ultima misurazione.	
--	--

kcal Consumo calorico

- Premere il pulsante menu [] ripetutamente fino a che **kcal** viene selezionato. L'indice metabolico basale BMR e attivo AMR teoricamente calcolati vengono visualizzati in Kcal.

23-05-2021 18:33



BMR: **1499** KCAL
AMR: **2248** KCAL

Spegnimento della bilancia (Modalità standby)

- Attendere finché il display non si spegne automaticamente oppure premere il pulsante [] sul dispositivo di comando per spegnere manualmente il display. Data e ora rimangono visibili.

10. VALUTAZIONE DEI RISULTATI

Percentuale di massa grassa

I valori relativi alla massa grassa vengono visualizzati sul display e valutati in base al diagramma a barre. Di seguito sono riportati i valori percentuali di riferimento per la massa grassa (per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio medico).

Uomo

				
Età	bassa	normale	alta	molto alta
10-14	<11%	11-16%	16,1-21%	>21%
15-19	<12%	12-17 %	17,1-22%	>22%
20-29	<13%	13-18	18,1-23%	>23%
30-39	<14%	14-19	19,1-24%	>24%
40-49	<15%	15-20%	20,1-25%	>25%
50-59	<16%	16-21%	21,1-26%	>26%
60-69	<17%	17-22%	22,1-27%	>27%
70-100	<18%	18-23%	23,1-28%	>28%

Donna

				
Età	bassa	normale	alta	molto alta
10-14	<16%	16-21%	21,1-26%	>26%
15-19	<17%	17-22%	22,1-27%	>27%
20-29	<18%	18-23%	23,1-28%	>28%
30-39	<19%	19-24%	24,1-29%	>29%
40-49	<20%	20-25%	25,1-30%	>30%
50-59	<21%	21-26%	26,1-31%	>31%
60-69	<22%	22-27%	27,1-32%	>32%
70-100	<23%	23-28%	28,1-33%	>33%

Gli sportivi presentano spesso un valore ridotto. A seconda della disciplina sportiva praticata, dell'intensità dell'allenamento e della costituzione è possibile raggiungere valori ancora inferiori ai valori di riferimento indicati. In presenza di valori estremamente bassi possono tuttavia sussistere dei rischi per la salute.

Grasso viscerale (grasso sugli organi/sull'addome)

Per grasso viscerale si intende il grasso che circonda gli organi interni della cavità addominale. Si sospetta che il grasso viscerale possa favorire l'insorgenza di malattie come l'ipertensione o il diabete.

Il grasso viscerale viene rappresentato sul display con un valore compreso tra 1 e 59.

Valore della percentuale di grasso viscerale	Valutazione
1-12	La percentuale di grasso viscerale è a un livello normale.
13-59	La percentuale di grasso viscerale è troppo alta.

Percentuale di acqua corporea

La percentuale di acqua è generalmente compresa nei seguenti range:

Uomo

			
Età	pessima	buona	ottima
10-100	<50%	50-65%	>65%

Donna

			
Età	pessima	buona	ottima
10-100	<45%	45-60%	>60%

Il grasso corporeo non contiene molta acqua. Di conseguenza le persone con una massa grassa elevata possono presentare una percentuale di acqua corporea inferiore ai valori di riferimento. In coloro che praticano sport di resistenza i valori di riferimento possono invece essere superati a causa della massa grassa ridotta e dell'elevata massa muscolare.

Il calcolo dell'acqua corporea con questa bilancia non consente di trarre conclusioni mediche ad es. per quanto riguarda la ritenzione idrica legata all'età. Consultare eventualmente il proprio medico. In generale è consigliabile raggiungere un'elevata percentuale di acqua corporea.

Percentuale di massa muscolare

Per la misurazione della massa muscolare viene misurata la massa muscolo-scheletrica. Non vengono presi in considerazione muscoli organici. La percentuale di massa muscolare è generalmente compresa nei seguenti range:

Uomo				Donna			
							
Età	bassa	normale	alta	Età	bassa	normale	alta
10-14	<44%	44-57%	>57%	10-14	<36%	36-43%	>43%
15-19	<43%	43-56%	>56%	15-19	<35%	35-41%	>41%
20-29	<42%	42-54%	>54%	20-29	<34%	34-39%	>39%
30-39	<41%	41-52%	>52%	30-39	<33%	33-38%	>38%
40-49	<40%	40-50%	>50%	40-49	<31%	31-36%	>36%
50-59	<39%	39-48%	>48%	50-59	<29%	29-34%	>34%
60-69	<38%	38-47%	>47%	60-69	<28%	28-33%	>33%
70-100	<37%	37-46%	>46%	70-100	<27%	27-32%	>32%

Massa ossea

Come il resto del corpo, le ossa sono naturalmente sottoposte a processi di calcificazione, sgretolamento e invecchiamento. La massa ossea cresce rapidamente durante l'infanzia e raggiunge il suo punto massimo all'età di circa 30-40 anni per poi tendere a ridursi con il passare dell'età. Una sana alimentazione (in particolare un corretto apporto di calcio e vitamina D) e una regolare attività fisica possono contrastare lo sgretolamento delle ossa. Un aumento della massa muscolare consente di migliorare ulteriormente la stabilità dello scheletro. Si ricorda che questa bilancia indica la massa minerale ossea. È pressoché impossibile influire sulla massa ossea, che però non presenta significative variazioni per quanto riguarda i fattori determinanti (peso, statura, età, sesso). Non sono disponibili direttive e suggerimenti riconosciuti.



Non confondere la massa ossea con la densità ossea. La densità ossea può essere determinata solo tramite una visita medica (ad esempio tomografia computerizzata, ultrasuoni). La bilancia non è pertanto in grado di diagnosticare eventuali alterazioni delle ossa e della loro durezza (ad esempio l'osteoporosi).

BMR

L'indice metabolico basale (BMR = Basal Metabolic Rate) è la quantità di energia di cui il corpo necessita a riposo per il mantenimento delle funzioni fisiche di base (ad es. se si rimane a letto per 24 ore). Tale valore dipende principalmente dal peso, dalla statura e dall'età. È visualizzato dalla bilancia diagnostica in kcal/giorno e viene calcolato sulla base della formula Mifflin-St.Jeor riconosciuta a livello scientifico.

Si tratta della quantità di energia di cui il corpo ha bisogno in ogni caso e deve essere reintegrata sotto forma di cibo. L'assunzione di una quantità inferiore di energia per un periodo prolungato può causare danni alla salute.

AMR

Il tasso metabolico attivo (AMR = Active Metabolic Rate) è la quantità di energia di cui il corpo ha bisogno ogni giorno quando è in attività. Il consumo energetico di una persona aumenta in base alla maggiore attività fisica e viene determinato dalla bilancia diagnostica mediante il livello di attività impostato (1-5).

Per mantenere il peso attuale, l'energia consumata dal corpo deve essere reintegrata sotto forma di cibo e di liquidi. Se per un lungo periodo l'energia consumata supera quella reintegrata, il corpo preleva la differenza dalle riserve di grassi accantonate e il peso diminuisce. Quando invece per un lungo periodo l'energia reintegrata supera il tasso metabolico attivo (AMR) calcolato, il corpo non è in grado di bruciare l'eccesso di energia che viene accumulato come grasso e il peso aumenta.

Relazione temporale dei risultati



Viene considerata solo la tendenza a lungo termine. Generalmente le variazioni di peso a breve termine nell'arco di pochi giorni dipendono da una perdita di liquidi.

L'interpretazione dei risultati si basa sulle variazioni del peso e delle percentuali di massa grassa, acqua corporea e massa muscolare, nonché sul tempo di realizzazione delle variazioni. È necessario distinguere fra variazioni repentine nell'arco di pochi giorni e variazioni a medio termine (nell'arco di settimane) e a lungo termine (mesi).

Come regola generale si può considerare che le variazioni di peso a breve termine sono determinate esclusivamente da variazioni del contenuto di acqua mentre quelle a medio e lungo termine coinvolgono anche la massa grassa e quella muscolare.

- Se il peso si riduce a breve termine mentre la massa grassa aumenta o resta stabile, si tratta solo di una perdita di liquidi, ad es. dovuta ad allenamento, sauna o a una dieta volta unicamente a una rapida perdita di peso.
- Se il peso aumenta a medio termine mentre la massa grassa diminuisce o resta stabile, può essere intervenuto un aumento della massa muscolare.
- Se il peso e la massa grassa diminuiscono contemporaneamente, significa che la dieta funziona e che si perde peso.
- La dieta deve essere integrata con attività fisica, allenamento e allenamento di potenziamento. Ciò consente di aumentare la massa muscolare a medio termine.
- La massa grassa, la percentuale di acqua o la massa muscolare non possono essere sommate (i tessuti muscolari contengono anche una percentuale di acqua).

11. TRASMISSIONE DEI VALORI MISURATI TRAMITE APP

Se l'app non è attiva, le misurazioni assegnate vengono salvate sulla bilancia. Nella bilancia può essere salvato un massimo di 30 misurazioni per utente. I valori memorizzati vengono inviati automaticamente alla app, se quest'ultima è attiva e a portata di Bluetooth®. La trasmissione automatica è possibile anche a bilancia spenta se il Bluetooth® nelle impostazioni apparecchio è attivo.

12. ULTERIORI INFORMAZIONI

Cancellazione dei dati dalla bilancia

a) Cancellazione dell'utente con tutte le impostazioni e i valori misurati

- Selezionare l'utente dopo l'accensione tramite il pulsante []. A tale scopo, premere ripetutamente il pulsante e confermare con [SET].
- Quando compare **0.0**, premere il pulsante [SET] per 12 secondi per cancellare l'utente.
- Con i pulsanti [], [] scegliere "SI" e confermare la richiesta con il pulsante [SET]. Se non si desidera cancellare l'utente, confermare "NO" con il pulsante [SET].



Tutti i valori e le impostazioni memorizzate di questo utente vengono cancellate.

b) Cancellazione di un singolo valore misurato di un utente

- Selezionare nella memoria utente [M] un valore e premere brevemente il pulsante [SET] sul dispositivo di comando per cancellare il valore memorizzato visualizzato.
- Questa operazione può essere effettuata anche direttamente dopo la misurazione.
- Con i pulsanti [], [] scegliere "SI" e confermare la richiesta con il pulsante [SET]. Se non si desidera cancellare il valore, confermare "NO" con il pulsante [SET].

c) Cancellazione di tutti i valori memorizzati di un utente

- Richiamare la memoria utente [M] e premere il pulsante [SET] sul dispositivo di comando per ca. 5 secondi per cancellare tutti i valori.
- Con i pulsanti [], [] scegliere "SI" e confermare la richiesta con il pulsante [SET]. Se non si desidera cancellare niente, confermare "NO" con il pulsante [SET].

Sostituzione delle batterie

Il dispositivo di comando è dotato di un'icona di sostituzione delle batterie. Sul display viene visualizzato "BATT. SCARICA" se le batterie della bilancia sono troppo scariche. In questo caso è necessario sostituire le batterie. Collegare quindi di nuovo la bilancia con l'app. L'ora del sistema viene aggiornata.



Nota:

- A ogni sostituzione delle batterie, utilizzare batterie dello stesso tipo, della stessa marca e della stessa capacità.
- Non utilizzare batterie ricaricabili.
- Utilizzare preferibilmente batterie prive di metalli pesanti.

13. PULIZIA E CURA

Di tanto in tanto pulire la superficie della bilancia con un panno morbido e leggermente inumidito. Non utilizzare la bilancia finché la superficie non è completamente asciutta.



Nota:

- Non utilizzare detergenti corrosivi.
- Non immergere mai la bilancia in acqua. Non risciacquare mai la bilancia sotto l'acqua corrente.
- Non collocare alcun oggetto sulla bilancia quando non viene utilizzata.
- Non esporre la bilancia a urti, umidità, polvere, prodotti chimici, forti sbalzi di temperatura e fonti di calore troppo vicine (forni, caloriferi).

14. SMALTIMENTO

Smaltire le batterie esauste e completamente scariche presso gli appositi punti di raccolta, i punti di raccolta per rifiuti tossici o i negozi di elettronica. Lo smaltimento delle batterie è un obbligo di legge.

Sulle batterie contenenti sostanze tossiche sono riportati i seguenti simboli:

Pb = batteria contenente piombo,
Cd = batteria contenente cadmio,
Hg = batteria contenente mercurio.

A tutela dell'ambiente, al termine del suo ciclo di vita, l'apparecchio non deve essere smaltito nei rifiuti domestici, ma conferito negli appositi centri di raccolta.

Smaltire l'apparecchio secondo la direttiva europea sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Per eventuali chiarimenti rivolgersi alle autorità comunali competenti per lo smaltimento.



15. CHE COSA FARE IN CASO DI PROBLEMI?

Se durante la misurazione la bilancia riscontra un errore, vengono visualizzate le seguenti indicazioni:

Indicazione sul display	Causa	Soluzione
"SOVRACCARICO!"	È stata superata la portata massima di 200 kg.	Non caricare sulla bilancia pesi superiori a 200 kg.
"BATT. SCARICA"	Batterie quasi esaurite.	Sostituire le batterie (vedere capitolo "Sostituzione delle batterie").
"MEMORIA PIENA"	Sono memorizzate 30 misurazioni.	Trasmettere i valori misurati.
"ERR. CONTATTO!" "ERRORE"	La resistenza elettrica tra gli elettrodi e la pianta dei piedi è troppo alta (ad es. in caso di calli molto spessi).	Ripetere la misurazione a piedi nudi. Inumidire leggermente le piante dei piedi. Rimuovere eventuali calli dalle piante dei piedi. Tenere gli elettrodi per le mani con le dita sul dietro e il palmo sul davanti.
"CAMPO !"	La misurazione dell'impedenza bioelettrica (BIA) è stata effettuata ma la percentuale di grasso è al di fuori dell'intervallo misurabile (inferiore al 3% o superiore al 65%).	Ripetere la misurazione a piedi nudi o eventualmente inumidire leggermente le piante dei piedi. Modificare eventualmente il livello di attività impostato.
Nessuna indicazione	Le batterie sono completamente scariche.	Sostituire le batterie (vedere capitolo "Sostituzione delle batterie").
	Le batterie non sono inserite correttamente.	Verificare la polarità corretta (vedere "Messa in funzione" -> "Sostituzione delle batterie").
Solo indicazione del peso, manca la diagnosi	Misurazione sconosciuta, in quanto al di fuori del limite di assegnazione utente oppure non è possibile un'assegnazione chiara.	Selezionare l'utente sulla bilancia con il pulsante [] oppure ripetere l'assegnazione utente nell'app. Tenere in mano gli elettrodi del dispositivo di comando e stare a piedi nudi sulla piattaforma.

Misurazione del peso errata

Possibile errore	Soluzione
La bilancia presenta un valore di base diverso da 0,0.	Accendere la bilancia, attendere circa 5 secondi, quindi ripetere la misurazione.
La bilancia si trova su un tappeto.	Posizionare la bilancia su una superficie piana e solida. Posizionarsi il più possibile all'esterno senza far ribaltare la bilancia.
Viene visualizzato un peso errato.	Restare fermi il più possibile.
Viene visualizzato un peso errato.	Attendere che la bilancia si spenga da sola. Ripetere quindi la misurazione.

Nessuna connessione Bluetooth® (il simbolo non è visualizzato).

Possibile errore	Soluzione
Collegamento radio	La portata minima in campo libero è di circa 10 m. Pareti e soffitti riducono la portata. Altre onde radio possono disturbare la trasmissione. Non posizionare quindi la bilancia nelle vicinanze di apparecchi come router WIFI, microonde o piani di cottura a induzione.
Connessione Bluetooth®	Chiudere completamente l'app (anche in background). Disattivare e riattivare il Bluetooth®. Spegnere e riaccendere lo smartphone. Rimuovere brevemente le batterie dalla bilancia e reinserirle. Vedere le FAQ sul sito www.beurer.com .

Possibile errore	Soluzione
La creazione della connessione dura troppo a lungo.	Intervallo <i>Bluetooth</i> ® più rapido a bilancia accesa.

16. DATI TECNICI

Dimensioni della bilancia	380 x 390 x 1000 mm
Batterie bilancia	4 batterie da 1,5V tipo AA
Range di misurazione	Da 8 kg a 200 kg
Indicazione sul display:	L'unità minima di leggibilità dei valori sul display è di 0,05 kg.
Precisione di ripetibilità:	La tolleranza di misurazione relativa a misurazioni ripetute è di +/- 0,3 kg (misurazione ripetuta più volte consecutivamente sulla stessa bilancia, mantenendo il più possibile invariata la posizione della bilancia e della persona).
Precisione assoluta:	Il valore della misurazione confrontato con un peso calibrato è di +/- 0,5% +0,05kg. Ad es. per 50 kg corrisponde a +/- 0,3 kg, per 100 kg corrisponde a +/- 0,55 kg.
Trasmissione dei dati tramite <i>Bluetooth</i> ® wireless technology	Il prodotto utilizza <i>Bluetooth</i> ® low energy technology, banda di frequenza 2,402–2,480 GHz, potenza di trasmissione max. 0 dBm, compatibile con smartphone <i>Bluetooth</i> ® 4.0/tablet

Requisiti di sistema ed elenco dei dispositivi compatibili per l'app "beurer HealthManager Pro" *



Salvo modifiche tecniche.

*Il presente prodotto soddisfa i requisiti delle direttive europee vigenti.

Con la presente confermiamo che il prodotto è conforme alla direttiva europea RED 2014/53/EU.

La dichiarazione di conformità CE relativa al presente prodotto è disponibile all'indirizzo:

<https://www.beurer.com/web/we-landingpages/de/declarationofconformity.php>

17. GARANZIA/ASSISTENZA

Per ulteriori informazioni sulla garanzia e sulle condizioni di garanzia, consultare la scheda di garanzia fornita.



Bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun. Uyarılara ve güvenlik yönergelerine uyun. Bu kullanım kılavuzunu ileride başvurmak üzere saklayın. Diğer kullanıcıların da kullanımı kılavuzuna erişebilmesini sağlayın. Cihazı başkalarına verirken kullanım kılavuzunu da birlikte verin.

İçindekiler

1. Teslimat kapsamı.....	73	9. Ölçüm değerlerinin analizi	80
2. İşaretlerin açıklaması	74	10. Sonuçların değerlendirilmesi	82
3. Uyarılar ve güvenlik bilgileri.....	74	11. Ölçüm değerlerinin uygulama ile aktarılması.....	84
4. Cihaz açıklaması.....	76	12. Diğer bilgiler.....	84
5. İlk çalıştırma.....	76	13. Temizlik ve bakım	84
6. Diyagnoz terazisinin uygulama ile ayarlanması	77	14. Bertaraf etme.....	84
7. Alternatif olarak: Diyagnoz terazisinin uygulama olmadan ayarlanması.....	78	15. Sorunların giderilmesi	85
8. Ölçümün yapılması	79	16. Teknik veriler	86
		17. Garanti/servis	86

Ürün özellikleri

Cihazın fonksiyonları

Bu dijital terazi, tartılmanıza ve kişisel zindelik verilerinizi saptamanıza olanak verir. Evde kişisel kullanım için tasarlanmıştır.

Terazi, 10 farklı kişi tarafından kullanılabilen aşağıdaki işlevleri içerir:

- Kilo ölçümü
- Vücut yağ oranı tespiti,
- Visceral yağ oranı (organ yağı/göbek yağı),
- Vücut suyu oranı,
- Kas oranı,
- Kemik kütlesi ve
- Bazal ve aktif metabolizma hızı.

Terazi ayrıca aşağıdaki fonksiyonları içerir:

- 8 elektrot ile gerçekleştirilen çapraz ölçüm sayesinde segment analizi yapılabilir, yani değerler vücudun belirli kısımları (kollar, bacaklar, gövde) için ayrı şekilde görüntülenebilir.
- Büyük ekranlı yenilikçi menü yapısı (5 dil seçeneği),
- Kilogram "kg", Pound "lb" ve Stone "st" ölçü birimleri arasında geçiş yapılabilir,
- Pillerin şarjı azaldığında pil değiştirme göstergesi,
- Otomatik kullanıcı algılaması,
- Uygulamaya aktarlamıyorsa 10 kişi için son 30 ölçümün kaydedilmesi,
- Misafir modu (kayıt fonksiyonu olmadan).

Ölçüm prensibi

Bu terazi B.I.A. (biyoelektrik empedans analizi) prensibiyle çalışır. Bu prensipte hissedilemeyen, tamamen sakıncasız ve tehlikesiz bir akım sayesinde saniyeler içinde vücut oranlarının tespit edilmesi sağlanır.

Bu elektrik direnci (empedans) ölçümüyle ve sabit ya da bireysel değerlerin (yaş, boy, cinsiyet, etkinlik derecesi) hesaplanmasıyla vücut yağ oranı ve vücudun diğer özellikleri tespit edilebilir. Kas dokusunun ve suyun elektrik iletkenliği iyidir ve bu nedenle dirençleri daha düşüktür. Bunlara karşın kemiğin ve yağ dokusunun iletkenliği azdır, çünkü yağ hücreleri ve kemikler dirençlerinin çok yüksek olması nedeniyle neredeyse hiç akım iletmez.

4 el elektrotu ve 4 ayak elektrotu ile gövdeye olan elektrik teması optimize edilerek daha kesin ölçümler ve daha iyi analiz sonuçları elde edilir. Bu hassas analiz teknolojisi sayesinde, tekrar edilen ölçümler arasındaki farkların son derece düşük olması sağlanabilir. Bunun nedeni, empedans ölçümü sırasında farklılıkların olmasıdır (örn. elektrotlar ile eller ve ayaklar arasında farklı elektrik temasının olması, suyun vücutta farklı dağılımı).

Diyagnoz terazisi tarafından saptanan değerlerin, vücudun gerçek, tıbbi analiz değerlerini sadece yaklaşık olarak gösterdiğini göz önünde bulundurun. Yalnızca uzman doktorlar tıbbi yöntemlerle (örn. bilgisayar tomografisi) vücut yağını, vücut suyunu, kas oranını ve kemik yapısı tam olarak belirleyebilir.

1. TESLİMAT KAPSAMI


Teslimat kapsamını kontrol ederek karton ambalajın dıştan hasar görmemiş ve içeriğin eksiksiz olduğundan emin olun. Cihazı kullanmadan önce, cihazda ve aksesuarlarında görünür hasarlar olmadıktan ve tüm ambalaj malzemelerinin çıkarıldığından emin olun. Şüpheli durumlarda kullanmayın ve satıcınıza veya belirtilen müşteri hizmetleri adresine başvurun.

- Alüminyum ayaklı, yüksek ekranlı diyagnoz terazisi
- 4 adet 1,5V Tıp AA pil

- Bu kullanım kılavuzu
- 2 adet kısa kılavuz
- Montaj seti (4 vida ve 2 yedek vida + alyan anahtar)

2. İŞARETLERİN AÇIKLAMASI

Cihazın üzerinde, kullanım kılavuzunda, ambalajında ve model etiketinde aşağıdaki simgeler kullanılmıştır:

⚠ UYARI Olası bir tehlikeyi belirtir. Önlenmemesi ölüme veya en ağır yaralanmalara yol açabilir.			
	Ürün bilgisi Önemli bilgilere yönelik uyarı		Birleşik Krallık İçin Uygunluk Değerlendirmesi Yapıldı İşareti
	Cihaz, tıbbi implant (örn. kalp pili) taşıyan kişiler tarafından kullanılmamalıdır. Aksi halde implantın fonksiyonu olumsuz etkilenebilir.		İthalatçı simgesi
	CE işareti Bu ürün gerekli Avrupa direktiflerinin ve ulusal direktiflerin gerekliliklerini karşılar.		Üretici
	Ürünler, AEB'nin belirlediği teknik kuralların gerektirdiği şartlara kesin bir şekilde uymaktadır.		Ürünü ve ambalaj bileşenlerini ayırın ve belediyenin kurallarına uygun olarak bertaraf edin.
	(Elektrikli) cihazlar, evsel atıklar ile birlikte bertaraf edilemez		Kullanım kılavuzuna başvurun
	Zararlı madde içeren pilleri evsel atıklarla birlikte bertaraf etmeyin		Ambalaj malzemesinin tanımlanması için kullanılan işaret. A = malzeme kısaltması, B = malzeme numarası: 1-7 = plastikler, 20 -22 = kâğıt ve karton
	Kayma tehlikesi! Terazinin üzerine ıslakken çıkmayın		Teraziye düz ve sert bir yüzey üzerine koyun. Teraziyi halı üzerine koymayın.
	Devrilme tehlikesi! En dış kenar üzerine basmayın.		

3. UYARILAR VE GÜVENLİK BİLGİLERİ

⚠ UYARI

- Cihaz sadece insanları tartmak ve insanların kişisel kondisyon verilerini kaydetmek için tasarlanmıştır. Cihaz sadece kişisel kullanım içindir, tıbbi veya ticari kullanıma uygun değildir. Cihazı sadece geliştirilme amacına uygun olarak ve bu kullanım kılavuzunda belirtilen şekilde kullanın.
- **Cihaz, tıbbi implant (örn. kalp pili) taşıyan kişiler tarafından kullanılmamalıdır. Aksi halde implantın fonksiyonu olumsuz etkilenebilir.**
- **Cihazı gebelik esnasında kullanmayın.**
- **Devrilme tehlikesi!** Teraziyi asla düz olmayan bir zemine yerleştirmeyin. Terazinin üzerine asla tek tarafından, en dış kenarına basarak çıkmayın.
- **Kayma tehlikesi!** Terazinin üzerine ıslak ayakla çıkmayın. Yüzeyi nemliyken teraziye çıkmayın. Terazinin üzerine ayağınızda çorap varken çıkmayın.
- Bu cihaz profesyonel, tıbbi kullanım için kalibre edilmiş bir terazi olmadığından teknik özelliklere bağlı ölçüm toleransları olabileceğini göz önünde bulundurun.
- Aşırı veya düşük kiloyla ilgili her türlü tedavi veya diyet, uygun bir uzman (örn. bir hekim) tarafından nitelikli bir danışmanlık verilmelidir. Terazi ile tespit edilen değerler, uzmana yardımcı olabilir.



- Çocuklarda, performans sporcularında veya tıbbi/fiziksel olarak kısıtlı olan kişilerde (örn. ödem belirtileri, osteoporoz, kardiyovasküler rahatsızlıkların tedavisine yönelik olarak veya damar genişletme amacıyla ilaç kullanan kişiler, bacaklarında ciddi anatomik farklılıklar olan kişiler), vücut yağının tespit edilmesinde yanlış veya tutarsız sonuçlar ortaya çıkabilir.
- Onarım işlemleri yalnızca Beurer müşteri servisi veya yetkili satıcılar tarafından yapılabilir. Teraziye asla kendiniz açmayın.

Pillerin kullanımıyla ilgili güvenlik yönergeleri

- Pilleri her zaman kutup yönlerine (+ / -) dikkat ederek doğru şekilde yerleştirin. Pilleri temiz ve kuru şekilde muhafaza edin ve sudan uzak tutun. Her zaman doğru pil tipini seçin.
- Pilleri ve pil bölmesi kontaklarını asla kısa devre yaptırmayın.
- Pilleri asla şarj etmeyin, zorla deşarj etmeyin, ısıtmayın, parçalarına ayırmayın, deforme etmeyin, kapsüllemeyin veya modifiye etmeyin.
- Piller üzerinde asla kaynaklama veya lehimleme yapmayın.
- Bir cihaz içinde asla farklı üreticiye ait, farklı kapasitelere (yeni ve kullanılmış), boyutlara ve tiplere sahip pilleri birlikte kullanmayın.
- **Patlama tehlikesi!** Belirtilen noktalara uyulmaması fiziksel yaralanmalara, aşırı ısınmaya, sızıntıya, hava tahliyesine, kırılmaya, patlamaya veya yangına neden olabilir.
- Bir pil akarsa koruyucu eldiven giyin ve pil bölmesini kuru bir bezle temizleyin.
- Pilden sızan sıvı cilt veya gözlerle temas ettiğinde, ilgili yeri suyla yıkayın ve bir hekime başvurun.
- **Nefes borusuna kaçma tehlikesi!** Pilleri çocukların erişemeyeceği bir yerde muhafaza edin. Yutulması durumunda derhal tıbbi yardım alın.
- Çocukların bir yetişkinin gözetiminde değilken pilleri değiştirmelerine asla izin vermeyin.
- Pilleri metal cisimlerden uzak, iyi havalandırılmış, kuru ve serin ortamlarda muhafaza edin.
- Pilleri asla doğrudan güneş ışığına veya yağmura maruz bırakmayın.
- Uzun süre kullanmayacağınız durumlarda pilleri cihazdan çıkartın.
- Boşalan pilleri derhal ve uygun şekilde bertaraf edin. Pilleri asla ateşe atarak bertaraf etmeyin.
- Pilleri bertaraf ederken, farklı elektrokimyasal sistemlere sahip pilleri ayrı olarak saklayın.


Genel bilgiler

- Terazinin yük kapasitesi maks. 200 kg'dır (440 lb, 31 St). Ağırlık ölçümünde sonuçlar 50 gramlık (0,1 lb) kademelerle gösterilir.
- Vücut yağı, vücut suyu ve kas oranı ölçüm sonuçları %0,1'lik kademelerle gösterilir.
- Kalori ihtiyacı 1 kcal'lik kademelerle gösterilir.
- Terazi "cm" ve "kg" birimlerine ayarlanmış olarak teslim edilir. Uygulama ile ilk çalıştırma sırasında birim ayarlarını değiştirebilirsiniz.

Genel öneriler


- Karşılaştırılabilir sonuçlar elde etmek için mümkün olduğunca günün aynı saatlerinde (en iyisi sabahları), tuvalete çıktıktan sonra, aç karnına ve çıplak olarak tartılın.
- Ölçüm için önemli bilgiler: Vücut yağ oranı ölçümü yalnızca ellerden ve çıplak ayaklardan ve tercihen ayak tabanları hafifçe nemliken yapılmalıdır.
- Ayak tabanlarının tamamen kuru veya nasırlı olması tatmin edici olmayan sonuçlara neden olabilir, çünkü bu durumda iletkenlik çok düşüktür.
- Tartılma esnasında diik ve hareketsiz durun.
- Alışılmadık bedensel etkinlikten sonra birkaç saat bekleyin.
- Yataktan kalktıktan sonra vücudunuzdaki suyun dağılabilmesi için yakl. 15 dakika bekleyin.
- Sadece uzun vadeli eğilimin değerlendirilmesi önemlidir. Birkaç gün içindeki kısa süreli kilo değişiklikleri genelde sıvı kaybindan kaynaklanır; ancak vücut suyu sağlığınız için önemli bir rol oynar.

4. CİHAZ AÇIKLAMASI

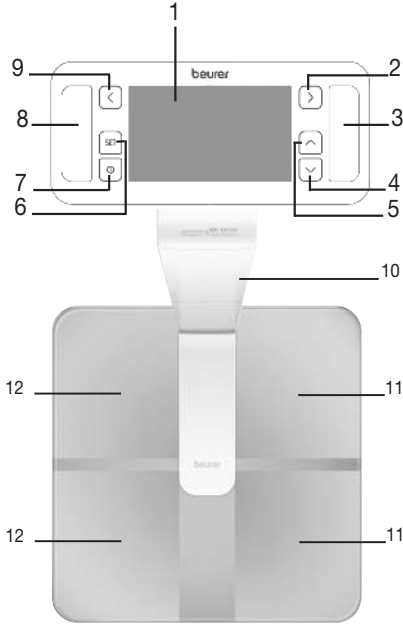

1. Ekran
2. ➤ Menü: Sağ tuş (Sensörlü tuşu)
3. Elektrotlar, sağ el
4. ▼ Menü: Aşağı yön tuşu (Sensörlü tuşu)
5. ▲ Menü: Yukarı yön tuşu (Sensörlü tuşu)
6. [SET] Ayar tuşu, giriş onayı (Sensörlü tuşu)
7. [ON/OFF] ON/OFF tuşu (Sensörlü tuşu)
8. Elektrotlar, sol el
9. ⬅ Menü: Sol tuş (Sensörlü tuşu)
10. Alüminyum ayak
11. Ayak elektrotları, sağ ayak
12. Ayak elektrotları, sol ayak

Ekran

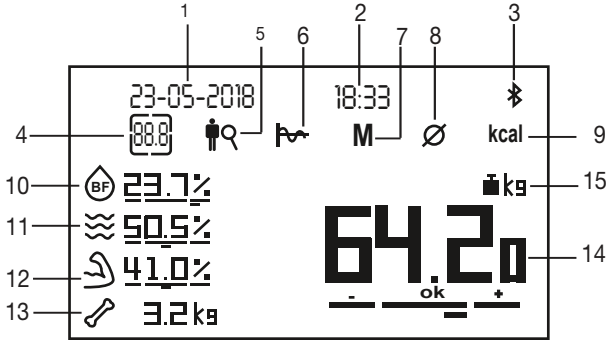


1. Tarih	2. Saat
3. Bluetooth®	4. Genel görünüm
5. Segment analizi	6. Grafiksel gösterim
7. Kullanıcı hafızası	8. Ortalama değerler
9. Kalori tüketimi	10. Açıklamalı vücut suyu oranı
11. Açıklamalı vücut suyu oranı	12. Açıklamalı kas oranı
13. Açıklamalı kemik kütlesi	14. BMI açıklamalı kilo
15. Ağırlık birimi (kg, lb veya st)	

5. İLK ÇALIŞTIRMA


Terazinin kurulması

Teraziyi düz ve sert bir zemine yerleştirin. Doğru ölçüm için zeminin düz ve sert olması şarttır.




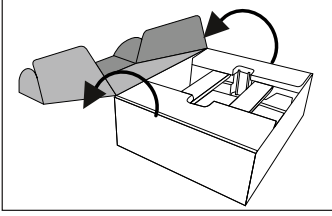


1. Kutuyu açın.

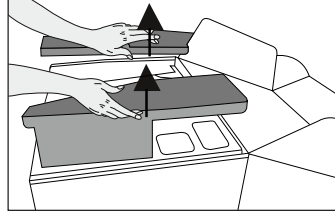


2. Soldaki ve sağdaki strafor köpüğü çıkarın.

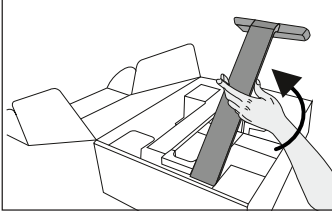


3. Alüminyum ayağın üst ve alt parçasını aynı anda yukarı kaldırın.

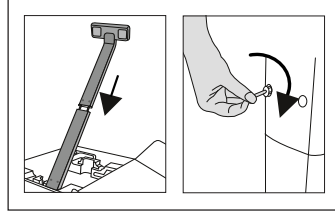


4. Alüminyum ayağın üst parçasını alt parçanın içine sokun ve üst taraftan vidalayın.

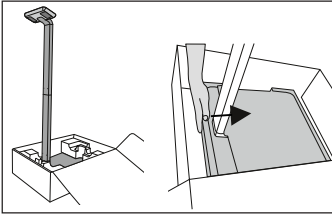


5. Alüminyum ayağı kutunun içinde dik konuma getirin. Teraziyi kenara doğru itin...

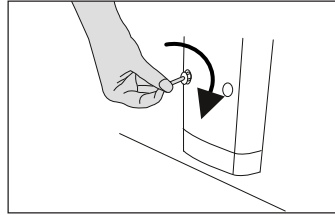

6. ...ve alt taraftan vidalayın.

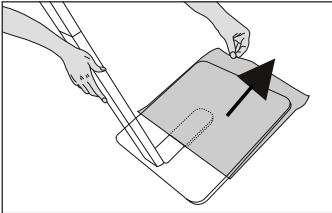

7. Bir elinizle ayağı sabit şekilde tutarken diğer elinizle folyoyu çıkarın.

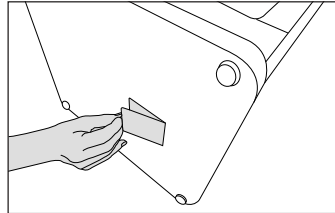

8. Pilleri terazinin alt tarafından kutupları doğru olacak şekilde (+/-) yerleştirin. Teraziyi düz bir zemine dik olarak yerleştirin.

6. DIYAGNOZ TERAZISININ UYGULAMA İLE AYARLANMASI

Vücut yağ oranınızı ve diğer vücut değerlerinizi hesaplamak için kişisel kullanıcı bilgilerinizi teraziye kaydetmeniz gerekir.

Terazi, kendinizin ve örneğin aile bireylerinizin kişisel ayarlarını kaydedebileceğiniz 10 kullanıcı kayıt yeri içerir.

Ayrıca, "beurer HealthManager Pro" uygulamasının kurulu olduğu diğer mobil cihazlardan veya uygulama içindeki kullanıcı profili değişikliği ile (bkz. uygulama ayarları) başka kullanıcılar da eklenebilir.

İlk çalıştırma sırasında **Bluetooth®** bağlantısının etkin durumda kalması için akıllı telefonu terazinin yanından uzaklaştırmayın.

• Akıllı telefonun **Bluetooth®** özelliğini etkinleştirin.

• **Apple App Store (iOS)** veya **Google Play 'dan (Android™)** ücretsiz "beurer HealthManager Pro" uygulamasını indirin.

• Uygulamayı başlatın ve talimatları uygulayın.

- "beurer HealthManager Pro" uygulamasında aşağıdaki ayarlar veya girişler yapılmalıdır:

Kullanıcı bilgileri	Ayar değerleri												
Baş harfler	maks. 3 haneli (A-Z, 0-9)												
Cinsiyet	Erkek (♂), Kadın (♀)												
Boy	100 - 250 cm (3' 03" - 8' 02")												
Doğum günü	Yıl, Ay, Gün												
Etkinlik derecesi	Etkinlik derecesini seçerken orta ve uzun vadeli inceleme önem taşır: <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>Bedensel etkinlik</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Yok.</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Az: Az ve hafif bedensel etkinlik (örn. yürüyüş, hafif bahçe işleri, jimnastik egzersizleri).</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Orta: Haftada en az 2 ila 4 kez 30'ar dakikalık bedensel etkinlik.</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Yüksek: Haftada en az 4 ila 6 kez 30'ar dakikalık bedensel etkinlik.</td></tr> <tr> <td>5</td><td>Çok yüksek: Her gün en az 1 saat yoğun bedensel etkinlik, yoğun antrenman veya ağır bedensel çalışma.</td></tr> </tbody> </table>		Bedensel etkinlik	1	Yok.	2	Az: Az ve hafif bedensel etkinlik (örn. yürüyüş, hafif bahçe işleri, jimnastik egzersizleri).	3	Orta: Haftada en az 2 ila 4 kez 30'ar dakikalık bedensel etkinlik.	4	Yüksek: Haftada en az 4 ila 6 kez 30'ar dakikalık bedensel etkinlik.	5	Çok yüksek: Her gün en az 1 saat yoğun bedensel etkinlik, yoğun antrenman veya ağır bedensel çalışma.
	Bedensel etkinlik												
1	Yok.												
2	Az: Az ve hafif bedensel etkinlik (örn. yürüyüş, hafif bahçe işleri, jimnastik egzersizleri).												
3	Orta: Haftada en az 2 ila 4 kez 30'ar dakikalık bedensel etkinlik.												
4	Yüksek: Haftada en az 4 ila 6 kez 30'ar dakikalık bedensel etkinlik.												
5	Çok yüksek: Her gün en az 1 saat yoğun bedensel etkinlik, yoğun antrenman veya ağır bedensel çalışma.												
Hedef kilo	kg/lb/st (grafiksel seyir gösterimi için)												

- Uygulama, terazinin bir sonraki boş kullanıcı kayıt yerini size tahsis eder (Kişi 1 - Kişi 10).
- Ölçümün yapılması: Otomatik kullanıcı algılaması için ilk ölçümün kişisel kullanıcı verilerinize atanması gerekir. Uygulama sizden bu işlemi yapmanızı ister. Bunun için bkz. "8. Ölçümün yapılması".

7. ALTERNATİF OLARAK: DIYAGNOZ TERAZISININ UYGULAMA OLMADAN AYARLANMASI

İlk çalıştırmanın ve tüm ayarların uygulama üzerinden yapılmasını tavsiye ederiz. Bkz. "6. Diyagnoz terazisinin uygulama ile ayarlanması". Bunlar cihaz üzerinde de yapılabilir.

Kumanda panelinden cihaz/zaman/kullanıcı ayarlarını yapın. Bunun için genel kural olarak [] veya [] tuşlarını kullanarak seçiminizi yapın ve [SET] ile onaylayın.

a.) Zamanın ayarlanması

[SET] → "SET TIME (ZAMAN AYARI)" → [SET]

Sıra	Ayar değerleri
Tarih	Yıl-Ay-Gün
Saat	Saat - Dakika

b.) Cihazın ayarlanması

[SET] → "SET UNIT (BİRİM AYARI)" → [SET]

Sıra	Ayar değerleri
Dil	    
Ölçü birimi	kg-lb-st
Saat	24 saat-12 saat
Misafir modu	AÇIK - KAPALI
Bluetooth®	AÇIK - KAPALI  "KAPALI" durumdaysa, Bluetooth® bağlantısı ancak terazi açık olduğunda mümkün olur. Pillerin kullanım ömrünü uzatmak veya istenmeyen radyo ışınımını önlemek için bu mantıklı olabilir.

c.) Kullanıcı verilerinin ayarlanması

[SET] → "SET USER (KULLANICI AYARI)" → [SET]

Kullanıcı bilgileri	Ayar değerleri
Baş harfler	maks. 3 haneli (A-Z, 0-9)
Cinsiyet	Erkek (♂), Kadın (♀)
Boy	100 - 250 cm (3'-03" - 8'-02")
Doğum günü	Yıl, Ay, Gün
Etkinlik derecesi	1 - 5 (bkz. Bölüm 6)
Hedef kilo	kg/lb/st (grafiksel seyir gösterimi için)

9. ÖLÇÜM DEĞERLERİNİN ANALİZİ



Ölçümden sonra sonuçlar otomatik olarak veya kumanda panelinden manuel kullanıcı seçiminden sonra değerlendirilir. [] tuşuna basarak kullanıcınızı seçin. [SET] tuşuna basarak onaylayın veya 3 saniye bekleyin.

Genel görünüm


Kullanıcınıza ait tüm vücut analizinden önce veya sonra ekranda bir genel görünüm gösterilir.	
---	--

Vücut yağı ve kas oranı için segment analizi

a) Sol ve sağ kol vücut yağı [] işaretleninceye kadar [] menü tuşuna art arda basın. Ekranda sol ve sağ kol için vücut yağı segment analizi gösterilir.	
b) Sol ve sağ bacak vücut yağı [] tuşu ile sol ve sağ bacakta vücut yağının ayrıntılı görünümüne geçebilirsiniz.	
c) Gövde vücut yağı [] tuşu ile gövdedeki vücut yağının ayrıntılı görünümüne geçebilirsiniz.	
d) Viseral yağ (organ yağı/göbek yağı) [] tuşu ile viseral yağın ayrıntılı görünümüne geçebilirsiniz.	
e) Sol ve sağ kol kas oranı [] tuşu ile sol ve sağ koldaki kas oranının ayrıntılı görünümüne geçebilirsiniz.	
f) Sol ve sağ bacak kas oranı [] tuşu ile sol ve sağ bacakta kas oranının ayrıntılı görünümüne geçebilirsiniz.	

g) Gövde kas oranı

- [] tuşu ile gövdedeki kas oranının ayrıntılı görünümüne geçebilirsiniz.




10-17 yaş arası kullanıcılar için visceral yağ ve vücut bölgelerine (kol/bacak/gövde) özel kas oranı gösterilmez.

**Grafiksel gösterim****a) Kilo**


- [] işaretleninceye kadar [] menü tuşuna art arda basın. Ekranda kilonuzun gelişimi gösterilir. Ölçümler arasında kilonuzun gelişimi gösterilir. Yeni ölçümler sağa eklenerek gösterilir. Referans çizgi, hedef kiloyu belirtir.




Hedef kiloyu istediğiniz zaman kullanıcı verilerinizde değiştirebilirsiniz.

**b) Vücut yağı **


- [] tuşu ile vücut yağı değerlerinin seyrini  açın. Ölçümler arasında vücut yağ oranı değerinizin gelişimi gösterilir. Referans çizgi, tüm vücut yağı ölçümlerinin ortalama değerini, çubuklar ise değerlerin aşağı veya yukarı yöndeki değişimini gösterir.

**c) Su oranı **


- [] tuşu ile su oranının seyrini  açın. Ölçümler arasında su oranınızın gelişimi gösterilir. Referans çizgi, tüm su oranı ölçümlerinin ortalama değerini gösterir, çubuklar ise değerlerin aşağı veya yukarı yönde değiştiğine ilişkin bir göstergedir.

**d) Kas oranı **

- [] tuşu ile kas oranının seyrini  açın. Ölçümler arasında kas oranınızın gelişimi gösterilir. Referans çizgi, tüm kas oranı ölçümlerinin ortalama değerini, çubuklar ise değerlerin aşağı veya yukarı yönde değişimini gösterir.

**M****Kaydedilen değerlerin gösterilmesi**


- [] işaretleninceye kadar [] menü tuşuna art arda basın. Ekranda en son kaydedilen ölçüm değeri gösterilir. Üst bölümde ölçümün tarihi ve kayıt yeri numarası (03-03) gösterilir, örn. kullanımdaki toplam 3 kayıt yerinden üçüncüsü = en sonuncu kayıt yeri.
- [ , ] tuşlarını kullanarak kayıt yerleri arasında geçiş yapabilirsiniz.

**Ortalama değerler**


- [] işaretleninceye kadar [] menü tuşuna art arda basın. Ekranda kaydedilen ölçümlerin tüm ortalama değerleri gösterilir.



Üst bölümde, ilk ve son ölçümün tarihi yer alır.

**Kalori tüketimi**

- [] işaretleninceye kadar [] menü tuşuna art arda basın. Teorik olarak hesaplanan temel metabolizma hızı BMR ve aktif metabolizma hızı AMR Kcal cinsinden görüntülenir.



Terazinin kapatılması (Standby modu)

- Ekran kendiliğinden kapanıncaya kadar bekleyin veya ekranı manuel olarak kapatmak için kumanda panelindeki [U] tuşuna basın. Tarih ve saat görünmeye devam eder.

10. SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Vücut yağı oranı

Vücut yağı değerleri ekranda gösterilir ve çubuk grafik ile değerlendirilir. % olarak belirtilen aşağıdaki vücut yağı değerleri referans olarak verilmiştir (lütfen ayrıntılı bilgi için doktorunuza danışın!).

Erkek				
Yaş	az	normal	fazla	çok fazla
10-14	<%11	%11-16	%16,1-21	>%21
15-19	<%12	%12-17	%17,1-22	>%22
20-29	<%13	%13-18	%18,1-23	>%23
30-39	<%14	%14-19	%19,1-24	>%24
40-49	<%15	%15-20	%20,1-25	>%25
50-59	<%16	%16-21	%21,1-26	>%26
60-69	<%17	%17-22	%22,1-27	>%27
70-100	<%18	%18-23	%23,1-28	>%28

Kadın				
Yaş	az	normal	fazla	çok fazla
10-14	<%16	%16-21	%21,1-26	>%26
15-19	<%17	%17-22	%22,1-27	>%27
20-29	<%18	%18-23	%23,1-28	>%28
30-39	<%19	%19-24	%24,1-29	>%29
40-49	<%20	%20-25	%25,1-30	>%30
50-59	<%21	%21-26	%26,1-31	>%31
60-69	<%22	%22-27	%27,1-32	>%32
70-100	<%23	%23-28	%28,1-33	>%33

Sporcularda sıklıkla daha düşük bir değer tespit edilir. Yapılan spor türüne, antrenman yoğunluğuna ve bedensel kondisyona göre, belirtilen referans değerlerin altında kalan değerlere de ulaşılabilir. Ancak aşırı düşük değerlerde sağlıkla ilgili risklerin olabileceğini lütfen unutmayın.

Viseral yağ (organ yağı/göbek yağı)

Viseral yağ, karın boşluğundaki iç organların etrafında oluşan yağdır. Viseral yağın, tansiyon veya diyabet gibi hastalıkların oluşma riskini yükselttiği düşünülmektedir.

Viseral yağ ekranda 1 ile 59 arasında bir sayı ile gösterilir.

Viseral yağ oranı değeri	Değerlendirme
1-12	Viseral yağ oranı normal aralıktadır.
13-59	Viseral yağ oranı çok yüksek.

Vücut suyu oranı

Vücut suyu oranı (%) normalde aşağıdaki aralıktadır:

Erkek			
Yaş	kötü	iyi	çok iyi
10-100	<%50	%50-65	>%65

Kadın			
Yaş	kötü	iyi	çok iyi
10-100	<%45	%45-60	>%60

Vücut yağı görece az su içerir. Bu nedenle vücut yağı oranı yüksek olan kişilerdeki vücut suyu oranı referans değerlerin altında olabilir. Buna karşın dayanıklılık sporları yapan kişilerde, yağ oranının az ve kas oranının yüksek olması nedeniyle bu referans değerler aşılabılır.

Bu teraziyle vücut suyu oranının tespit edilmesi, örn. yaştan ileri gelen ödemler hakkında tıbbi bir sonuca varmak için elverişli değildir. Gerektiğinde doktorunuza danışın. Esas olarak vücut suyu oranının yüksek olması amaçlanmalıdır.

Kas oranı

Kas oranı ölçümünde iskelet kası kütlesi ölçülür. Organ kasları hesaba katılmaz. Kas oranı (%) normalde aşağıdaki aralıklardadır:

Erkek			
			
Yaş	az	normal	fazla
10-14	<%44	%44-57	>%57
15-19	<%43	%43-56	>%56
20-29	<%42	%42-54	>%54
30-39	<%41	%41-52	>%52
40-49	<%40	%40-50	>%50
50-59	<%39	%39-48	>%48
60-69	<%38	%38-47	>%47
70-100	<%37	%37-46	>%46

Kadın			
			
Yaş	az	normal	fazla
10-14	<%36	%36-43	>%43
15-19	<%35	%35-41	>%41
20-29	<%34	%34-39	>%39
30-39	<%33	%33-38	>%38
40-49	<%31	%31-36	>%36
50-59	<%29	%29-34	>%34
60-69	<%28	%28-33	>%33
70-100	<%27	%27-32	>%32

Kemik kütlesi

Kemiklerimiz, vücudumuzun diğer bölümleri gibi doğal gelişme, azalma ve yaşlanma süreçlerine tabidir. Kemik kütlesi çocuk yaşlarda hızla artar ve 30 ile 40 yaş arasında maksimuma ulaşır. Yaş ilerledikçe kemik kütlesi tekrar biraz azalır. Sağlıklı beslenmeyle (özellikle kalsiyum ve D vitamini) ve düzenli bedensel hareketlerle bu azalmaya biraz karşı koyabilirsiniz. Sistemli kas geliştirme yoluyla iskeletinizin dayanıklılığını daha da güçlendirebilirsiniz. Bu terazinin kemiklerdeki mineral oranını gösterdiğini dikkate alın. Kemik kütlesine müdahale etmek neredeyse imkansızdır, ancak ağırlık, boy, yaş, cinsiyet gibi etki faktörlerine bağlı olarak az miktarda değişiklik gösterir. Kabul görmüş yönergeler ve tavsiyeler bulunmamaktadır.



Lütfen kemik kütlesini kemik yoğunluğuyla karıştırmayın. Kemik yoğunluğu sadece tıbbi muayeneye (örn. bilgisayarlı tomografi, ultrason) tespit edilebilir. Bu nedenle bu teraziyle kemiklerdeki ve kemik sertliğindeki değişiklikler hakkında bir sonuca varmak (örn. osteoporoz) mümkün değildir.

BMR

Temel metabolizma hızı (BMR = Basal Metabolic Rate) vücudun, tamamen istirahat halindeyken temel işlevlerini sürdürebilmek için gereksinim duyduğu enerji miktarıdır (örn. 24 saat yatakta yatıldığında). Bu değer büyük ölçüde ağırlığa, boya ve yaşa bağlıdır. Bu değer diyagnoz terazisinde kcal/gün birimiyle gösterilir ve bilimsel olarak kabul görmüş Mifflin-St.Jeor Formülü'ne göre hesaplanır. Vücudunuz bu enerji miktarına her durumda gereksinim duyar ve bunun besin şeklinde yeniden vücuda alınması zorunludur. Uzun vadede yetersiz enerji alırsanız, sağlığınız bozulabilir.

AMR

Aktif metabolizma hızı (AMR = Active Metabolic Rate) vücudun aktif durumda bir günde tükettiği enerji miktarıdır. İnsanın enerji tüketimi aran bedensel etkinlikle doğru orantılıdır ve diyagnoz terazisinde girilen etkinlik derecesi (1-5) yardımıyla saptanır.

Kilonun korunması için, tüketilen enerjinin yiyecek ve içecek biçiminde yeniden vücuda alınması zorunludur. Uzun bir süre boyunca tüketilenden daha az enerji alındığında vücut aradaki farkı esas olarak depoladığı yağdan karşılar, ağırlık kaybı olur. Buna karşın uzun bir süre boyunca hesaplanan etkinlik metabolizma hızından (AMR) daha fazla enerji alınırsa vücut bu enerji fazlasını yakamaz ve bu yağ olarak vücutta depolanır, ağırlık artar.

Sonuçların zamanla ilişkisi



Sadece uzun vadeli eğilimin önem taşıdığını göz önünde bulundurun. Birkaç gün içindeki kısa süreli ağırlık farklılıkları genelde su kaybindan ileri gelir.

Sonuçlar, toplam ağırlıktaki ve vücut yağı, vücut suyu ve kas kütlesi oranlarındaki değişikliklere ve ayrıca bu değişikliklerin olduğu süreye göre yorumlanır. Birkaç gün içindeki hızlı değişiklikler orta vadeli (birkaç hafta içindeki) değişikliklerden ve uzun vadeli (birkaç ay içindeki) değişikliklerden ayrıt edilmelidir.

Temel kural olarak, ağırlıktaki kısa vadeli değişikliklerin neredeyse tamamen su oranındaki değişiklikler olduğu, buna karşın orta ve uzun vadedeki değişikliklerin yağ ve kas oranlarını ifade ettiği kabul edilebilir.

- Eğer kısa vadede ağırlık azalıyorsa ama vücut yağı oranı artıyor veya değişmiyorsa, yalnız su kaybetmişsinizdir –örn. antrenmandan veya saunadan sonra ya da yalnızca hızlı kilo kaybıyla sınırlı olan bir diyet sonrasında.
- Eğer orta vadede ağırlık artıyor, vücut yağı oranı azalıyor veya değişmiyorsa, değerli kas kütlesi geliştirmiş olabilirsiniz.
- Eğer ağırlık ve vücut yağı oranı aynı zamanda azalıyorsa, diyetiniz işe yarıyor demektir –yağ kütlesi kaybediyorsunuz.
- İdeal koşullarda diyetinizi bedensel etkinlik, zindelik veya kuvvet antrenmanı ile desteklersiniz. Bu sayede orta vadede kas oranınızı artırabilirsiniz.
- Vücut yağı, vücut suyu veya kas oranı birbiriyle toplanmamalıdır (kas dokusu vücut suyunun bir kısmını içerir).

11. ÖLÇÜM DEĞERLERİNİN UYGULAMA İLE AKTARILMASI

Uygulama açık değilse, yeni atanan ölçümler teraziyeye kaydedilir. Teraziyeye her kullanıcı için azami 30 ölçüm kaydedilebilir. Uygulamayı Bluetooth® kapsama alanı dahilinde açarsanız kaydedilen ölçüm değerleri otomatik olarak uygulamaya aktarılır. Cihaz ayarlarında Bluetooth® etkinleştirilmişse, terazi kapalıyken de otomatik aktarım gerçekleştirilir.

12. DİĞER BİLGİLER

Terazi verilerinin silinmesi

a) Kullanıcının tüm ayarları ve kayıtlı değerleri ile birlikte silinmesi

- Cihazı açtıktan sonra [↶] tuşuna basarak kullanıcıyı seçin. Gerekirse tuşa art arda basın ve [SET] ile onaylayın.
- Ekranda 0.0 gösterildiğinde [SET] tuşuna 12 saniye süreyle basarak kullanıcıyı silin.
- [↶], [↷] tuşları ile "YES (EVET)" yanıtını seçin ve sorgulamayı [SET] tuşu ile onaylayın. Kullanıcıyı silmek istemiyorsanız, "NO (HAYIR)" seçin ve [SET] ile onaylayın.



Bu kullanıcının kaydedilmiş tüm değerleri ve ayarları silinir.

b) Bir kullanıcının bazı kayıtlı değerlerinin silinmesi

- [M] kullanıcı kayıt yerinden bir ölçüm değeri seçin ve kumanda panelindeki [SET] tuşuna kısaca basarak gösterilen kayıtlı değeri silin.
- Bunu doğrudan ölçümden sonra da yapabilirsiniz.
- [↶], [↷] tuşları ile "YES (EVET)" yanıtını seçin ve sorgulamayı [SET] tuşu ile onaylayın. Değeri silmek istemiyorsanız "NO (HAYIR)" yanıtını seçin ve [SET] ile onaylayın.

c) Bir kullanıcının tüm kayıtlı değerlerinin silinmesi

- [M] kullanıcı kayıt yerini çağırın ve kumanda panelindeki [SET] tuşuna yakl. 5 saniye süreyle basarak tüm değerleri silin.
- [↶], [↷] tuşları ile "YES (EVET)" yanıtını seçin ve sorgulamayı [SET] tuşu ile onaylayın. Hiçbir şey silmek istemiyorsanız, "NO (HAYIR)" yanıtını seçin ve [SET] ile onaylayın.

Pillerin değiştirilmesi

Kumanda panelinde pil değiştirme göstergesi bulunur. Terazinin pilleri çok zayıfladığında ekranda "LOW BATTERY (PİL ZAYIF)" mesajı gösterilir. Bu durumda piller değiştirilmelidir. Bunun ardından teraziyi tekrar uygulamaya bağlayın. Sistem zamanı güncellenir.



Not:

- Her pil değişiminde aynı tip, aynı marka ve kapasitede piller kullanın.
- Şarj edilebilir piller kullanmayın.
- Ağır metallsiz piller kullanın.

13. TEMİZLİK VE BAKIM

Terazinin yüzeyini ara sıra yumuşak ve hafif nemli bir bezle silin. Teraziyi ancak terazi yüzeyi tamamen kuruduktan sonra tekrar kullanın.



Not:

- Keskin temizlik maddesi kullanmayın.
- Teraziyi kesinlikle suya daldırmayın. Teraziyi asla akan suyun altında yıkamayın.
- Kullanılmadığında terazinin üzerine herhangi bir nesne koymayın.
- Teraziyi darbelerden, nemden, tozdan, kimyasallardan, aşırı sıcaklık değişikliklerinden ve çok yakın ısı kaynaklarından (soba, kalorifer radyatörü) koruyun.

14. BERTARAF ETME

Kullanılmış, tamamen boşalmış piller özel işaretli toplama kutularına atılarak, özel atık toplama yerlerine veya elektrikli cihaz satıcılarına teslim edilerek bertaraf edilmelidir. Pillerin bertaraf edilmesi, yasal olarak sizin sorumluluğunuzdadır.

Bu işaretler, zararlı madde içeren pillerin üzerinde bulunur:

Pb = pil kurşun içerir,
Cd = pil kadmium içerir,
Hg = pil cıva içerir.



Çevreyi korumak için, kullanımı ömrü dolan cihazı evsel atıklarla beraber bertaraf etmeyin. Cihaz, kullanıldığı ülkedeki uygun atık toplama merkezleri aracılığıyla bertaraf edilebilir.

Cihazı, elektrikli ve elektronik hurda cihazlarla ilgili AB direktifine (WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment) uygun şekilde bertaraf edin. Bertaraf etme ile ilgili sorularınızı, ilgili yerel makamlara iletebilirsiniz.



15. SORUNLARIN GIDERİLMESİ

Terazi, ölçüm esnasında bir hata tespit ederse şu görüntülenir:

Ekran göstergesi	Neden	Çözüm
„ERROR: _OVERLOAD„ (HATA: AŞIRI YÜK)	200 kg olan maksimum taşıma kapasitesi aşıldı.	Sadece 200 kg'a kadar ağırlık uygulayın.
„LOW_BATTERY“ (PİL ZAYIF)	Piller bitmek üzere.	Pilleri değiştirin (bkz. “Pillerin değiştirilmesi” bölümü).
„MEMORY_FULL“ (HAFIZA DOLU)	30 ölçüm kaydedildi.	Ölçüm değerlerini aktarın.
„ERROR: CONTACT ERROR!„ (HATA: TEMAS HATASI!)	Elektrotlar ile ayak tabanı arasındaki elektrik direnci çok yüksek (örn. kalın nasır oluşumu).	Ölçümü çıplak ayakla tekrarlayın. Gerekirse ayak tabanlarınızı hafifçe nemlendirin. Gerekirse ayak tabanlarındaki nasırı giderin. El elektrotlarını parmaklarınız arkaya ve avuçlarınız öne gelecek şekilde tutun.
„ERROR: DATA!“ (HATA: VERİ!)	BlA ölçümü başarıyla gerçekleştirilmiş olmasına rağmen yağ oranı ölçülebilir aralığın dışında (%3'ten küçük veya %65'ten büyük).	Lütfen ölçümü yalınayak olarak tekrarlayın veya gerekiyorsa ayak tabanınızı hafifçe nemlendirin. Gerekirse, ayarlanmış olan aktivite seviyesini değiştirin.
Gösterge yok	Piller tamamen bitmiş.	Pilleri değiştirin (bkz. “Pillerin değiştirilmesi” bölümü).
	Piller doğru yerleştirilmemiş.	Kutupların doğru olduğunu kontrol edin (bkz. “İlk çalıştırma” -> “Pillerin değiştirilmesi”).
Sadece ağırlık göstergesi var, diyagnoz yok	Kullanıcı ataması sınırı dışında veya kesin bir atama mümkün olmadığı için bilinmeyen ölçüm.	Terazide [] tuşuyla kullanıcıyı seçin veya uygulamada kullanıcı ataması işlemini tekrarlayın. Kumanda panelinin elektrotlarını tutun ve platform üzerine yalınayak çıkın.

Hatalı ağırlık ölçümü

Olası hatalar	Çözüm
Terazinin sıfır noktası yanlıştr.	Teraziyi açın, yakl. 5 saniye bekleyin ve ölçümü tekrarlayın.
Terazi halı üzerinde duruyor.	Teraziyi düz ve sert bir zemin üzerine koyun. Terazinin devrilmesine neden olmadan, mümkün olduğunca dışarı doğru durun.
Yanlış ağırlık gösteriliyor.	Mümkün olduğunca hareketsiz durun.
Yanlış ağırlık gösteriliyor.	Terazinin tekrar kendi kendine kapanmasını bekleyin. Ölçümü tekrarlayın.

Bluetooth® bağlantısı yok (📶 sembolü görünmüyor)

Olası hatalar	Çözüm
Kablosuz bağlantı	Açık alanda asgari kapsama mesafesi yakl. 10 m'dir. Duvarlar ve tavanlar kapsama mesafesini kısaltır. Diğer radyo dalgaları aktarımı bozabilir. Bu nedenle teraziye örn. WIFI Router, mikrodalgı, endüksiyonlu ocak vs. gibi cihazların yakınına yerleştirmeyin.
Bluetooth® bağlantısı	Uygulamayı tamamen kapatın (arka planda da kapalı olmalıdır). Bluetooth® özelliğini kapatıp tekrar açın. Akıllı telefonunuzu kapatıp yeniden açın. Terazinin pillerini kısa bir süreliğine çıkarıp yeniden takın. www.beurer.com sitesinde Sık Sorulan Sorulara bakın.
Bağlantı kurulması çok uzun sürüyor	Terazi açıkken Bluetooth® bağlantısı daha hızlıdır.

16. TEKNİK VERİLER

Terazinin ölçüleri	380 x 390 x 1000 mm
Terazinin pilleri	4 adet 1,5V Tip AA
Ölçüm aralığı	8 kg - 200 kg
Ekran göstergesi:	Ekran göstergesinde değerler 0,05 kg'lık dilimlerle gösterilir.
Tekrarlama hassasiyeti:	Tekrar ölçümlerindeki ölçüm toleransı: +/- 0,3 kg (terazi ve kişi mümkün olduğunca aynı şekilde durur, aynı terazide birbiri ardına birkaç ölçüm yapılır).
Mutlak hassasiyet:	Kalibrasyonlu bir tartıya kıyasla ölçüm değeri: +/- %0,5 +0,05 kg. Örnek olarak 50 kg için = +/- 0,3 kg, 100 kg için: +/- 0,55 kg.
Bluetooth® wireless technology ile veri aktarımı	Ürün Bluetooth® low energy technology kullanır, 2,402–2,480 GHz frekans bandı, maks. 0 dBm, verici gücü ile Bluetooth® 4.0 akıllı telefonlar/ tabletler ile uyumludur

"beurer HealthManager Pro" uygulaması için sistem gereksinimleri ve uyumlu cihazların listesi*



Teknik değişiklik hakkı saklıdır.

*Bu ürün, geçerli Avrupa Birliği yönergelerinin gerekliliklerini karşılamaktadır.
Bu ürünün 2014/53/AB sayılı Avrupa RED direktifine uygun olduğunu onaylarız.
Bu ürünle ilgili CE uyumluluk beyanını şu konumda bulabilirsiniz:
<https://www.beurer.com/web/we-landingpages/de/declarationofconformity.php>

17. GARANTİ/SERVİS

Garanti ve garanti koşulları ile ilgili ayrıntılı bilgileri cihazla birlikte verilen garanti broşüründe bulabilirsiniz.



Внимательно прочтите эту инструкцию по применению. Обращайте внимание на предупреждения и соблюдайте указания по технике безопасности. Сохраните инструкцию по применению для последующего использования. Обеспечьте другим пользователям доступ к инструкции по применению. Передавайте прибор другим пользователям вместе с инструкцией по применению.

Оглавление

1. Комплект поставки.....	88	9. Анализ измеренных значений	94
2. Пояснения к символам.....	88	10. Оценка результатов	96
3. Предостережения и указания по технике безопасности	88	11. Передача измеренных значений через приложение..	98
4. Описание прибора.....	90	12. Дополнительная информация	98
5. Подготовка к работе.....	91	13. Очистка и уход.....	99
6. Настройка диагностических весов через приложение.....	91	14. Утилизация	99
7. Другой вариант: настройка диагностических весов без приложения	92	15. Что делать при возникновении проблем?	99
8. Выполнение измерения	93	16. Технические данные	100
		17. Гарантия/сервисное обслуживание	100

Ознакомительная информация

Функции прибора

Данные электронные весы используются для взвешивания и определения Ваших фитнес-параметров. Они предназначены для домашнего использования.

Весы имеют следующие функции, которыми могут пользоваться до 10 человек:

- измерение массы тела;
- определение доли жировой массы;
- доли висцерального жира (жировые накопления в органах/брюшной полости);
- доли тканевой жидкости;
- доли мышечной массы;
- массы костей;
- значений основного обмена веществ и обмена веществ с учетом физической активности.

Кроме того, доступны следующие функции.

- Сегментный анализ, т. е. представление отдельных участков тела (руки, ноги, корпус) благодаря перекрестному измерению с 8 электродами.
- Инновационная навигация по меню на большом дисплее (на одном из 5 языков).
- Переключение между единицами измерения: килограммы (kg), фунт (lb) или стоун (st).
- Индикация необходимости замены батареек, если они разрядились.
- Автоматическое определение пользователя.
- Хранение 30 последних измерений для 10 человек при невозможности переноса данных в приложение.
- Гостевой режим GUEST_MODE (без функции памяти).

Принцип измерения

Данные весы работают по принципу BIA (биоимпедансометрия). За считанные секунды с помощью незаметного, абсолютно безопасного электрического тока определяется состав тела человека.

Посредством измерения электрического сопротивления (импеданса) с учетом постоянных величин или индивидуальных параметров (возраст, рост, степень активности) можно определить долю жировой массы или других веществ в организме. Мышечная ткань и вода имеют хорошую электрическую проводимость, поэтому уровень сопротивления здесь невелик. Кости и жировая ткань, наоборот, имеют небольшую электрическую проводимость, так как жировые клетки и кости из-за очень высокого сопротивления практически не проводят ток.

Электрический контакт с телом оптимизирован при помощи 4 ручных и 4 ножных электродов, что повышает точность измерений и анализа. Благодаря такой чувствительности измерительной техники при повторных измерениях значения могут незначительно различаться. Причиной этого являются отклонения во время измерения сопротивления (например, изменение электрического контакта рук и ног с электродами, иное распределение жидкости в теле).

Учитывайте, что значения, определенные диагностическими весами, являются лишь приближенными к реальным медицинским значениям, полученным в результате анализа. Долю жировой массы, тканевой жидкости, мышечной массы и строение костей может определить только врач, используя медицинские методы (например, компьютерную томографию).

1. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Проверьте комплектность поставки и убедитесь, что на картонной упаковке нет внешних повреждений. Перед использованием убедитесь, что прибор и его принадлежности не имеют видимых повреждений, и удалите все упаковочные материалы. При наличии сомнений не используйте прибор и обратитесь к продавцу или в сервисную службу по указанному адресу.

- Диагностические весы с дисплеем на высокой алюминиевой ножке
- 4 батарейки 1,5 В типа AA
- Инструкция по применению
- 2 кратких руководства
- Набор для монтажа (4 винта с 2 запасными винтами + ключ для винтов с внутренним шестигранником)

2. ПОЯСНЕНИЯ К СИМВОЛАМ

На приборе, в инструкции по применению, на упаковке и на фирменной табличке прибора используются следующие символы:

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Указывает на потенциальную опасность. Если ее не предотвратить, возможны тяжелейшие травмы или даже смерть.			
	Информация об изделии Обращает внимание на важную информацию		Знак соответствия требованиям Великобритании
	Запрещается применение прибора лицами с установленными медицинскими имплантатами (например, кардиостимуляторами). В противном случае может нарушиться работа имплантата.		Символ импортера
	Знак CE Это изделие соответствует требованиям действующих европейских и национальных директив.		Изготовитель
	Продукция прошла подтверждение соответствия требованиям технических регламентов ЕАЭС.		Снимите упаковку с изделия и утилизируйте ее в соответствии с местными предписаниями.
	Нельзя утилизировать (электро-)прибор вместе с бытовым мусором		См. инструкцию по применению
	Не утилизируйте вместе с бытовым мусором батарейки, содержащие токсичные вещества		Маркировка для идентификации упаковочного материала. A = сокращенное обозначение материала, B = номер материала: 1-7 = пластик, 20-22 = бумага и картон
	Опасность поскользывания! Не вставляйте на влажные весы.		Установите весы на прочную ровную поверхность. Не ставьте весы на ковер.
	Опасность опрокидывания! Не вставляйте на самый край.		

3. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ И УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Прибор предназначен только для взвешивания людей и записи Ваших личных фитнес-параметров. Прибор предназначен исключительно для частного пользования, запрещается его использование в медицинских и коммерческих целях. Используйте прибор только в тех целях, для которых он был разработан, и только тем способом, который описан в данной инструкции по применению.
- Запрещается применение прибора лицами с установленными медицинскими имплантатами (например, кардиостимуляторами). В противном случае может нарушиться работа имплантата.
- Не используйте прибор во время беременности.



- **Опасность опрокидывания!** Никогда не устанавливайте весы на неровную поверхность. Не вставайте на самый край весов с одной стороны.
- **Опасность поскальзывания!** Не вставайте на весы влажными ногами. Не вставайте на весы, если их поверхность влажная. Не вставайте на весы в носках.
- Обратите внимание, что по техническим причинам возможны погрешности измерений, так как речь идет не о калиброванных весах для профессионального использования в медицинских целях.
- При любом лечении (диете) избыточного или недостаточного веса требуется квалифицированная консультация со стороны соответствующего специалиста (например, лечащего врача). Полученные посредством этих весов данные могут помочь специалистам.
- У детей, профессиональных спортсменов или лиц с ограниченными с медицинской/физической точки зрения возможностями (например, с симптомами отечности, остеопорозом, при приеме медикаментов для лечения сердечно-сосудистых или сосудистых заболеваний, лиц с существенными анатомическими отклонениями на ногах) возможны неточные или недостоверные результаты при определении жировой массы тела.
- Ремонтные работы должны производиться только сервисной службой Beurer или авторизованными торговыми представителями. Категорически запрещается самостоятельное вскрытие весов.

Указания по обращению с батарейками

- Всегда правильно устанавливайте батарейки с учетом полярности (+/-). Следите, чтобы батарейки были чистыми и сухими, защитите их от воздействия воды. Всегда выбирайте батарейки подходящего типа.
- Не допускайте короткого замыкания батареек и контактов батарейного отсека.
- Запрещается заряжать, принудительно разряжать, нагревать, разбирать, деформировать, герметизировать или модифицировать батарейки.
- Запрещается сваривать или заплаивать батарейки.
- Не используйте внутри прибора батарейки разных производителей, разной емкости (новые и использованные), разного размера и типа.
- **Опасность взрыва!** Несоблюдение указанных правил может привести к травмам, перегреву, вытеканию, выпуску воздуха, поломке, взрыву или возгоранию.
- Если батарейка потекла, очистите отсек для батареек сухой салфеткой, предварительно надев защитные перчатки.
- При попадании жидкости из батарейки на кожу или в глаза необходимо промыть соответствующий участок большим количеством воды и обратиться к врачу.
- **Опасность проглатывания мелких частей!** Храните батарейки в недоступном для детей месте. При проглатывании немедленно обратитесь к врачу.
- Никогда не позволяйте детям заменять батарейки без присмотра взрослых.
- Храните батарейки вдали от металлических предметов, в хорошо проветриваемых, сухих и прохладных помещениях.
- Не подвергайте батарейки воздействию прямых солнечных лучей или дождя.
- Если прибор длительное время не используется, извлеките из него батарейки.
- Разряженные батарейки следует немедленно утилизировать надлежащим образом. Не бросайте батарейки в огонь.
- При утилизации храните батарейки отдельно от различных электрохимических систем.



Общие указания


- Максимальная нагрузка для весов составляет 200 кг (440 фунтов, 31 стоун). При измерении веса результаты отображаются с шагом 50 г (0,1 фунта).
- Результаты измерения доли жировой массы, тканевой жидкости и мышечной массы отображаются с точностью до 0,1 %.
- Потребность в калориях отображается с шагом 1 ккал.
- При поставке на весах установлены единицы измерения «см» и «кг». Во время пуска в эксплуатацию с помощью приложения можно менять настройки единиц измерения.



Общие советы


- Для получения результатов, необходимых для сравнения, по возможности взвешивайтесь в одно и то же время суток (лучше всего утром), после того, как сходите в туалет, на голодный желудок и без одежды.
- Важно при измерении. Доля жировой массы может определяться только вручную и без обуви, при этом подошвы стопы должны быть слегка увлажнены.
- Абсолютно сухие подошвы ступней или подошвы ступней с сильно ороговевшими участками кожи имеют слишком низкую проводимость, что может привести к неудовлетворительным результатам измерения.
- Во время взвешивания стойте прямо и неподвижно!
- После физической нагрузки в непривычно большом объеме воздержитесь от измерений в течение нескольких часов.
- Встав утром, подождите примерно 15 минут, чтобы вода, содержащаяся в организме, распределилась по нему.
- Важно: значение имеют только долговременные тенденции. Как правило, кратковременные отклонения веса в течение нескольких дней обусловлены потерей жидкости; однако тканевая жидкость играет для самочувствия большую роль.

4. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

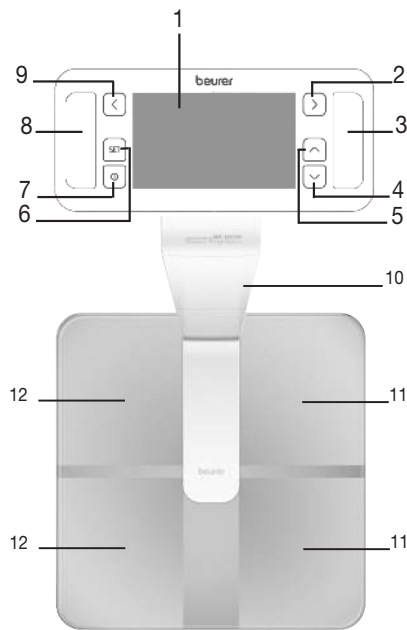

1. Дисплей
2. > Меню: кнопка «Вправо» (Сенсорная кнопка)
3. Электроды, правая рука
4. ▾ Меню: кнопка «Вниз» (Сенсорная кнопка)
5. ▴ Меню: кнопка «Вверх» (Сенсорная кнопка)
6. [SET] Кнопка настройки, подтверждение ввода данных (Сенсорная кнопка)
7. [ON/OFF] Кнопка ON/OFF (Сенсорная кнопка)
8. Электроды, левая рука
9. < Меню: кнопка «Влево» (Сенсорная кнопка)
10. Алюминиевая ножка
11. Ножные электроды, правая нога
12. Ножные электроды, левая нога

Дисплей

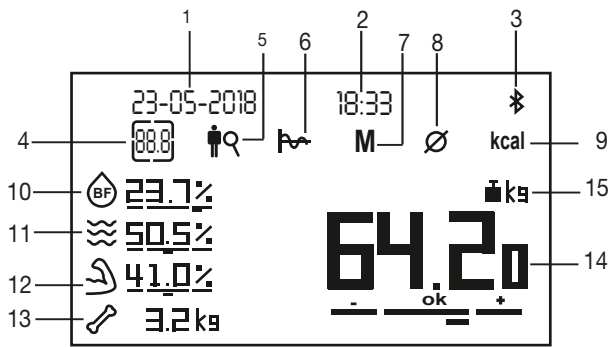


1. Дата	2. Время
3. Bluetooth®	4. Общий обзор
5. Сегментный анализ	6. Графическое отображение
7. Пользовательская память	8. Средние значения
9. Расход калорий	10. Доля жира в организме, с интерпретацией
11. Доля тканевой жидкости с интерпретацией	12. Доля мышечной массы с интерпретацией
13. Масса костей, с интерпретацией	14. Масса тела с интерпретацией ИМТ
15. Единица измерения веса (кг, фунт или стоун)	


5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Установка весов


Поставьте весы на ровную и твердую поверхность. Твердая поверхность является необходимым условием для точного измерения.

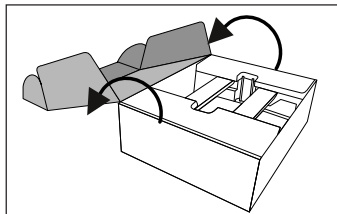


1. Откройте коробку.

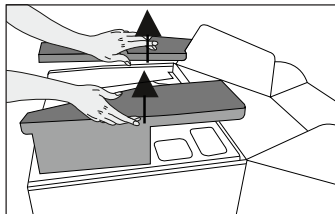


2. Выньте защитные вставки из пенополистирола, расположенные слева и справа в коробке.

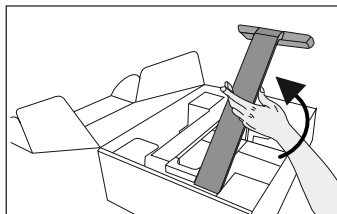


3. Одновременно откиньте верхнюю и нижнюю часть алюминиевой ножки.

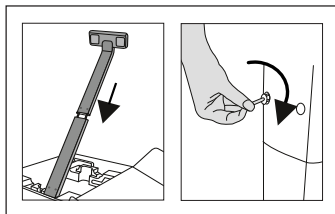


4. Вставьте верхнюю часть алюминиевой ножки в нижнюю часть и привинтите ее сверху.

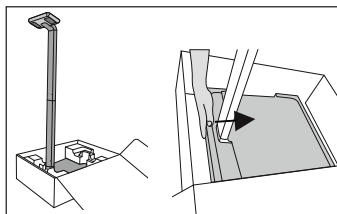


5. Установите алюминиевую ножку в коробке в вертикальном положении. Пододвиньте весы к краю...

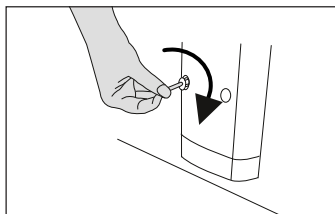

6. ...и привинтите вниз.

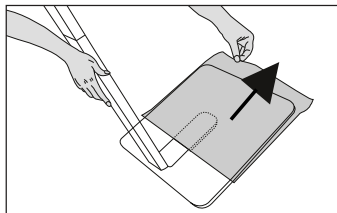

7. Одной рукой удерживайте ножку, а другой снимите пленку.

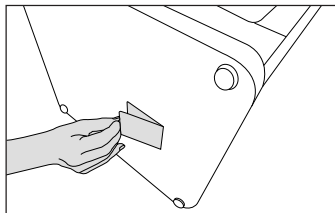

8. Установите батарейки с правильной полярностью (+/-) в нижней части весов. Затем разместите весы на ровной поверхности и поставьте их на ребро.

6. НАСТРОЙКА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ВЕСОВ ЧЕРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ

Чтобы определить долю жировой массы в организме и другие физические показатели, необходимо сохранить в памяти весов личные данные пользователя.

Весы оснащены 10 ячейками памяти, в которых Вы и, например, члены Вашей семьи сможете хранить личные данные.

Дополнительно пользователи могут подключаться с помощью мобильных устройств с установленным приложением «Beurer HealthManager Pro» или путем изменения профиля пользователя в приложении (см. настройки приложения).

Чтобы при подготовке прибора к работе соединение Bluetooth® оставалось активным, держите смартфон на достаточно близком расстоянии от весов.

- **Активируйте в настройках смартфона функцию Bluetooth®.**
- **Загрузите бесплатное приложение «Beurer HealthManager Pro» в Apple App Store (iOS) или Google Play (Android™).**
- **Запустите приложение и следуйте указаниям.**
 - В приложении «Beurer HealthManager Pro» должны быть выбраны следующие настройки.

Данные пользователя	Значения настроек
Инициалы	Макс. 3 знака (A–Z, 0–9)
Пол	Мужской (♂), женский (♀)
Рост	От 100 до 250 см (от 3' 03" до 8' 02")
Дата рождения	Год, месяц, день
Уровень активности	При выборе уровня активности решающим является средне- или долгосрочное наблюдение.
	Физическая активность
	1 Отсутствует.
	2 Малая: небольшой объем легких физических нагрузок (например, пешие прогулки, легкие работы в саду, гимнастические упражнения).
	3 Средняя: физические нагрузки не менее 2–4 раз в неделю по 30 минут.
	4 Высокая: физические нагрузки не менее 4–6 раз в неделю по 30 минут.
	5 Очень высокая: интенсивные физические нагрузки, интенсивные тренировки или тяжелый физический труд, ежедневно не менее 1 часа.
Целевой вес	кг (kg)/фунты (lb)/стоуны (st) (для графического отображения)

- Приложение присвоит Вам следующую свободную ячейку пользовательской памяти (от 1 до 10).
- Выполнение измерения: для автоматического распознавания пользователя при первом измерении необходимо ввести свои данные. Следуйте инструкциям в приложении. Внимательно изучите раздел «8. Выполнение измерения».

7. ДРУГОЙ ВАРИАНТ: НАСТРОЙКА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ВЕСОВ БЕЗ ПРИЛОЖЕНИЯ

Мы рекомендуем осуществлять ввод в эксплуатацию и настройку весов через приложение. См. раздел «6. Настройка диагностических весов через приложение». Настройка весов может также выполняться непосредственно на приборе.

Настройте прибор/время/пользователя на блоке управления. Для выбора используйте кнопки [⏮] или [⏭] и подтвердите его нажатием кнопки [SET].

а) Настройка времени

[SET] → «SET TIME» (НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ) → [SET]

Последовательность	Значения настроек
Дата	Год, месяц, день
Время	Часы, минуты

б) Настройка прибора

[SET] → «SET UNIT» (НАСТРОЙКА ПРИБОРА) → [SET]

Последовательность	Значения настроек
Язык	(DE) (EN) (FR) (ES) (IT)
Единица измерения	кг (kg), фунты (lb), стоуны (st)
Время	24 ч/12 ч
Гостевой режим	ON — OFF
Bluetooth®	ON — OFF
	 При OFF, соединение по Bluetooth® возможно, только когда весы включены. Это целесообразно для увеличения срока службы батарей и избежания нежелательного радиозлучения.

в) Настройка пользовательских данных
[SET] → «SET USER» (СМЕНИТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ) → [SET]

Данные пользователя	Значения настроек
Инициалы	Макс. 3 знака (A–Z, 0–9)
Пол	Мужской (♂), женский (♀)
Рост	От 100 до 250 см (от 3' 03" до 8' 02")
Дата рождения	Год, месяц, день
Уровень активности	От 1 до 5 (см. раздел 6)
Целевой вес	кг (kg)/фунты (lb)/стоуны (st) (для графического отображения)
PIN-код пользователя	Генерируется автоматически для возможного дальнейшего использования Bluetooth®. Данная информация используется только при последующей настройке приложения, когда во время следующей установки приложения добавляются созданные пользователи весов.



Последующая регистрация в приложении

Если ввод весов в эксплуатацию проводился без приложения, Вы можете добавить созданного пользователя весов в приложение «beurer HealthManager Pro». Для этого требуется ввести 4-значный PIN-код пользователя — PIN. Данный порядок работы описывается в приложении.

8. ВЫПОЛНЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЯ

8.1 Измерение массы тела

- Нажмите кнопку [P] на блоке управления. На дисплее появится индикация „0.0“ кг.
- Прибор готов для измерения веса. Встаньте на весы, равномерно распределяя вес на обе ноги. Показатели веса не сохраняются, назначение пользователей невозможно, так как измерение BIA через руки и ноги не выполняется.

8.2 Выполнение измерения в гостевом режиме

При однократном измерении или когда не требуется сохранение пользовательских данных. Для этого следует включить в настройках прибора гостевой режим.
[F] → Guest → [SET] или включить весы

Данные пользователя	Значения настроек
Пол	Мужской (♂), женский (♀)
Рост	От 100 до 250 см (от 3' 03" до 8' 02")
Дата рождения	Год, месяц, день
Уровень активности	От 1 до 5 (см. раздел 6)

8.3 Измерение показателей пользователя с диагностикой всего организма

- Нажмите кнопку [P] на блоке управления. На дисплее появится индикация „0.0“ кг.




В случае активации гостевого режима (GUEST_MODE) в настройках весов вставляйте на весы, когда они находятся в выключенном состоянии.

- Встаньте на весы босиком и крепко держите в руках блок управления. Держите пульт управления так, чтобы нижняя часть большого пальца лежала на переднем электроде, а остальные пальцы прижимали задние электроды.
- На весах следует стоять спокойно, равномерно распределяя вес на обе ноги. Следите, чтобы ступни, ноги, икры и бедра не соприкасались.



- Если весы распознали Вас автоматически, после измерения веса выполняется измерение сопротивления (импеданса) для анализа. Об этом сигнализирует значок сканируемого тела.
- После завершения диагностики всего организма отображается обзор результатов. Измеренное значение будет автоматически сохранено.



Инициалы Сегментный анализ




Указание:

результат измерения может не сохраниться по следующим причинам.

- Пользователь не распознан автоматически. Это произойдет, если измеренный вес будет отличаться на ± 3 кг от последнего измерения или у другого пользователя будут похожие значения с разницей ± 3 кг. Тогда нажмите кнопку [↵], чтобы выбрать пользователя вручную и выполнить новое измерение.
- Пользователь стоит на весах в обуви.
- Пользователь не взял в руки блок управления.

9. АНАЛИЗ ИЗМЕРЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ




Оценка результатов происходит автоматически после проведения измерения или после выбора пользователя вручную на блоке управления. Выберите свои данные пользователя нажатием кнопки [↵]. Подтвердите свой выбор нажатием кнопки [SET] или подождите 3 секунды.



Общий обзор


До или после диагностики всего организма на дисплее отображается обзор результатов.



Сегментный анализ показателей жировой и мышечной массы


а) Жировая масса левой и правой руки

- Нажимайте кнопку меню [→] до тех пор, пока не будет отмечен символ [↵]. На дисплее появятся результаты сегментного анализа показателей жировой массы левой и правой руки.




б) Жировая масса левой и правой ноги

- Нажимайте кнопку [↵] для подробного отображения показателей жировой массы левой и правой ноги.




в) Жировая масса корпуса

- Нажимайте кнопку [↵] для подробного отображения показателей жировой массы в корпусе.




г) Висцеральный жир (жировые накопления в органах/брюшной полости)


- Нажимайте кнопку [↵] для подробного отображения показателей висцерального жира.



д) Доля мышечной массы левой и правой руки





- Нажимайте кнопку [↵] для подробного отображения показателей мышечной массы левой и правой руки.




е) Доля мышечной массы левой и правой ноги • Нажимайте кнопку [] для подробного отображения показателей мышечной массы левой и правой ноги.	
ж) Доля мышечной массы корпуса • Нажимайте кнопку [] для подробного отображения показателей мышечной массы в корпусе.	

Для пользователей в возрасте 10–17 лет висцеральный жир и сегменты мышечной массы (рука/нога/торс) не отображаются.


Графическое отображение

а) Масса тела • Нажимайте кнопку меню [] до тех пор, пока не будет отмечен символ . На дисплее отображается изменение веса тела. Отображается изменение веса тела от измерения к измерению. Новые измерения добавляются справа. Линия сравнения обозначает целевой вес. Целевой вес можно изменить в любой момент в пользовательских данных.	
б) Жировая масса • С помощью кнопки [] перейдите к отображению жировой массы . Отображается изменение жировой массы тела от измерения к измерению. Линия отсчета обозначает усредненный показатель всех измерений жировой массы, столбики обозначают увеличение или уменьшение значений.	
в) Доля жидкости • С помощью кнопки [] перейдите к отображению доли жидкости . Отображается изменение доли жидкости тела от измерения к измерению. Линия отсчета обозначает усредненный показатель всех измерений доли жидкости, столбики обозначают увеличение или уменьшение значений.	
г) Доля мышечной массы • С помощью кнопки [] перейдите к отображению мышечной массы . Отображается изменение доли мышечной массы тела от измерения к измерению. Линия отсчета обозначает усредненный показатель всех измерений доли мышечной массы, столбики обозначают увеличение или уменьшение значений.	

M Отображение сохраненных результатов

• Нажимайте кнопку меню [] до тех пор, пока не будет отмечен символ . На дисплее появится последний сохраненный результат измерения. Сверху указывается дата измерения и номер ячейки памяти (03–03), например третья = последняя ячейка памяти из 3 заполненных ячеек. • С помощью кнопок [], [] можно переключаться между ячейками памяти.	
---	--

Средние значения

• Нажимайте кнопку меню [] до тех пор, пока не будет отмечен символ . На дисплее отображаются все средние значения сохраненных результатов измерений. Сверху указывается дата первого и последнего измерения.	
---	--

- Нажимайте кнопку меню [] до тех пор, пока не будет отмечен символ **kcal**. Теоретически рассчитанный основной обмен веществ (BMR), а также обмен веществ с учетом физической активности (AMR) отображаются в ккал.

23-05-2021 18:33



BMR: 1499 KCAL
AMR: 2248 KCAL

Выключение весов (режим ожидания)

- Подождите, пока дисплей не отключится самостоятельно, или нажмите кнопку [] на блоке управления, чтобы отключить дисплей вручную. Дата и время остаются видимыми.

10. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ

Доля жировой массы

Значения жировой массы отображаются на дисплее и оцениваются с помощью гистограммы. Ориентиром являются следующие значения жировой массы в % (за дополнительной информацией обратитесь к врачу).

Мужчины

	--	ak	+
	=====	=====	=====
Возраст	Низкая	Нормальная	Большая
10-14	< 11 %	11-16 %	16,1-21 %
15-19	< 12 %	12-17 %	17,1-22 %
20-29	< 13 %	13-18 %	18,1-23 %
30-39	< 14 %	14-19 %	19,1-24 %
40-49	< 15 %	15-20 %	20,1-25 %
50-59	< 16 %	16-21 %	21,1-26 %
60-69	< 17 %	17-22 %	22,1-27 %
70-100	< 18 %	18-23 %	23,1-28 %

Женщины

	-	ak	+
	=====	=====	=====
Возраст	Низкая	Нормальная	Большая
10-14	< 16 %	16-21 %	21,1-26 %
15-19	< 17 %	17-22 %	22,1-27 %
20-29	< 18 %	18-23 %	23,1-28 %
30-39	< 19 %	19-24 %	24,1-29 %
40-49	< 20 %	20-25 %	25,1-30 %
50-59	< 21 %	21-26 %	26,1-31 %
60-69	< 22 %	22-27 %	27,1-32 %
70-100	< 23 %	23-28 %	28,1-33 %

У спортсменов значения часто бывают ниже. В зависимости от вида спорта, интенсивности тренировок и конституции тела значения могут быть ниже указанных ориентировочных значений. Однако учитывайте, что при чрезвычайно низких показателях, возможно, существует угроза для здоровья.

Висцеральный жир (жировые накопления в органах/брюшной полости)

Висцеральный жир — это жир, который окружает внутренние органы в брюшной полости. Предполагается, что висцеральный жир способствует развитию таких болезней, как гипертония или сахарный диабет.

Показатель висцерального жира отображается на дисплее в диапазоне от 1 до 59.

Показатель доли висцерального жира	Оценка
1-12	Доля висцерального жира в Вашем организме находится в нормальном диапазоне.
13-59	Доля висцерального жира в Вашем организме слишком высокая.

Доля тканевой жидкости

Доля тканевой жидкости в % обычно находится в следующих диапазонах.

Мужчины

	--	ak	+
	=====	=====	=====
Возраст	Плохо	Хорошо	Очень хорошо
10-100	< 50 %	50-65 %	> 65 %

Женщины

	--	ak	+
	=====	=====	=====
Возраст	Плохо	Хорошо	Очень хорошо
10-100	< 45 %	45-60 %	> 60 %

В жировой массе содержится сравнительно мало воды. Поэтому у людей с большой долей жировой массы доля тканевой жидкости может быть меньше ориентировочных значений. У людей, занимающихся видами спорта, развивающими выносливость, ориентировочные значения, наоборот, могут быть выше из-за небольшой доли жировой массы и большой доли мышечной массы.

На основании определения доли тканевой жидкости на этих весах нельзя делать какие-либо медицинские заключения, например о скоплении жидкости, связанном с возрастными изменениями. При необходимости проконсультируйтесь со своим врачом. Как правило, необходимо стремиться к большой доле тканевой жидкости.

Доля мышечной массы

При определении мышечной массы измеряется мышечно-скелетная масса. Мышцы внутренних органов не учитываются. Доля мышечной массы в % обычно находится в следующих диапазонах.

Мужчины				Женщины			
— ■ +				— ■ +			
В о з - раст	Низкая	Нормальная	Большая	Возраст	Низкая	Нормальная	Большая
10–14	< 44 %	44–57 %	> 57 %	10–14	< 36 %	36–43 %	> 43 %
15–19	< 43%	43–56 %	> 56 %	15–19	< 35%	35–41 %	> 41 %
20–29	< 42%	42–54 %	> 54 %	20–29	< 34%	34–39 %	> 39 %
30–39	< 41%	41–52 %	> 52 %	30–39	< 33%	33–38 %	> 38 %
40–49	< 40%	40–50 %	> 50 %	40–49	< 31%	31–36 %	> 36 %
50–59	< 39%	39–48 %	> 48 %	50–59	< 29%	29–34 %	> 34 %
60–69	< 38%	38–47 %	> 47 %	60–69	< 28%	28–33 %	> 33 %
70–100	< 37%	37–46 %	> 46 %	70–100	< 27%	27–32 %	> 32 %

Масса костей

Наши кости, как и остальные ткани нашего тела, подвержены естественным процессам роста, уменьшения и старения. Масса костей в детском возрасте быстро растет и достигает к 30–40 годам своего максимума. С увеличением возраста масса костей снова несколько уменьшается. Благодаря правильному питанию (в частности, приему кальция и витамина D) и регулярной двигательной активности Вы можете немного остановить процесс ее сокращения. С помощью целенаправленного наращивания мускулатуры Вы можете дополнительно увеличить стабильность Вашего костного скелета. Обратите внимание, что данные веса отображают содержание минеральных веществ в костях. На массу костей практически невозможно повлиять, однако она незначительно колеблется в пределах влияющих на нее факторов (вес, рост, возраст, пол). Общепризнанных предписаний и рекомендаций не существует.

▲ ВНИМАНИЕ

Не путайте костную массу с плотностью кости. Плотность кости определяется только при медицинском исследовании (например, компьютерная томография, ультразвуковое исследование). Поэтому делать какие-либо заключения об изменениях костей и их плотности (например, остеопороз) при помощи данных весов невозможно.

ВМR (уровень основного обмена веществ)

Скорость основного обмена веществ (ВМR — Basal Metabolic Rate) — это количество энергии, которое требуется организму в состоянии полного покоя для поддержания своих основных функций (например, если круглые сутки лежать в постели). Данное значение в значительной степени зависит от веса, роста и возраста. На диагностических весах данное значение отображается в единицах «ккал/день» и рассчитывается согласно научно признанной формуле Миффлина-Сан Жеора.

Этот объем энергии необходим для Вашего организма в любом случае и должен поставляться в форме еды. Если Вы продолжительное время получаете малое количество энергии, это может негативно отразиться на Вашем здоровье.

АМR (обмен веществ с учетом физической активности)

Обмен веществ с учетом физической активности (АМR — Active Metabolic Rate) — это количество энергии, которое организм ежедневно расходует в активном состоянии. Расход энергии у человека повышается вместе с увеличением его физической активности и определяется на диагностических весах согласно заданной степени активности (1–5).

Для сохранения имеющегося веса затраченная энергия должна быть возвращена в организм за счет еды и питья. Если в течение продолжительного времени в организм возвращается меньше энергии, чем расходуется, организм начинает возмещать эту разницу за счет накопленных жировых отложений, в результате вес снижается. Если, напротив, в течение продолжительного времени энергии поступает больше, чем рассчитанное значение обмена веществ с учетом физической активности (АМR), излишки энергии в организме не сжигаются, а сохраняются в форме жировых отложений, в результате вес увеличивается.

Взаимосвязь результатов во времени



Учтите, что значения имеют только долговременные тенденции. Кратковременные отклонения в весе в течение нескольких дней, как правило, обусловлены потерей жидкости.

При толковании результатов учитывается изменение общего веса и процентной доли жировой массы, тканевой жидкости и мышечной массы, а также время, за которое произошли изменения. Следует различать быстрые изменения в течение нескольких дней и изменения, происходящие со средней (в течение недель) и малой (в течение месяцев) скоростью.

Основным является тот факт, что краткосрочные изменения почти всегда связаны с изменением содержания воды в организме, в то время как среднесрочные и долгосрочные изменения могут также касаться изменений доли жировой и мышечной массы.

- Если за короткое время вес снижается, а доля жировой массы увеличивается или сохраняется, у Вас в организме произошла исключительно потеря жидкости, например, после тренировки, посещения сауны или диеты, направленной на быстрое снижение веса.
- Если вес увеличивается со средней скоростью, доля жировой массы уменьшается или сохраняется на том же уровне, то Вы, возможно, напротив, приобрели ценную мышечную массу.
- Если вес и доля жировой массы уменьшаются одновременно, то Ваша диета работает — Вы теряете жировую массу.
- В идеале Вы должны поддерживать действие диеты при помощи физической активности, занятий фитнесом или силовыми видами спорта. Таким образом Вы можете увеличить долю мышечной массы в среднесрочный период.
- Значения долей жировой массы, тканевой жидкости или мышечной массы не следует складывать (в мышечной ткани также содержатся компоненты, в составе которых имеется тканевая жидкость).

11. ПЕРЕДАЧА ИЗМЕРЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ ЧЕРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ

Если приложение не открыто, новые присвоенные значения сохраняются в памяти весов. На весах можно хранить до 30 значений для каждого пользователя. Сохраненные измеренные значения автоматически передаются в приложение, если Вы откроете его в пределах действия Bluetooth®-соединения. Автоматическая передача данных при выключенных весах возможна, если включен Bluetooth® в настройках прибора.

12. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Удаление данных из памяти весов

а) Удаление пользователя со всеми настройками и сохраненными результатами

- После включения выберите свои данные пользователя нажатием кнопки []. При необходимости нажмите кнопку несколько раз и подтвердите нажатием [SET].
- При появлении на дисплее 0.0 нажмите кнопку [SET] и удерживайте ее в течение 12 секунд, чтобы удалить пользователя.
- Выберите с помощью кнопок [, ] пункт YES и подтвердите запрос кнопкой [SET]. Если Вы не хотите удалять пользователя, выберите пункт NO и подтвердите выбор кнопкой [SET].



Все сохраненные значения и настройки этого пользователя будут удалены.

б) Удаление отдельного результата пользователя

- Выберите в пользовательской памяти [] измеренное значение и быстро нажмите кнопку [SET] на блоке управления, чтобы удалить отображенный сохраненный результат.
- Это можно сделать также сразу после измерения.
- Выберите с помощью кнопок [, ] пункт YES и подтвердите запрос кнопкой [SET]. Если Вы не хотите удалять результат, выберите пункт NO и подтвердите выбор кнопкой [SET].

в) Удаление всех сохраненных результатов пользователя

- Вызовите пользовательскую память [] и нажмите кнопку [SET] на блоке управления, удерживая ее в течение примерно 5 секунд, чтобы удалить все значения.
- Выберите с помощью кнопок [, ] пункт YES и подтвердите запрос кнопкой [SET]. Если Вы ничего не хотите удалять, выберите пункт NO и подтвердите выбор кнопкой [SET].

Замена батареек

Блок управления оснащен индикатором замены батареек. На дисплее отображается надпись LOW_BATTERY, если батарейки разрядились. В этом случае батарейки следует заменить. После этого выполните повторное соединение с приложением. Время обновится.



Указание

- При замене батареек используйте батарейки того же типа, той же марки и такой же емкости.
- Не используйте заряжаемые аккумуляторы.
- Используйте батарейки, не содержащие тяжелых металлов.

13. ОЧИСТКА И УХОД

Время от времени протирайте весы мягкой, слегка увлажненной салфеткой. Не используйте весы снова до тех пор, пока поверхность весов полностью не высохнет.

ВНИМАНИЕ

- Не используйте едкие чистящие средства.
- Никогда не погружайте весы в воду. Категорически запрещается промывать весы проточной водой.
- При неиспользовании весов не ставьте на них посторонние предметы.
- Весы следует предохранять от ударов, воздействия влаги, пыли, химических веществ, значительных колебаний температуры. Не устанавливайте их вплотную к источникам тепла (печи, радиаторы отопления).

14. УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизируйте использованные и полностью разряженные батарейки в контейнеры со специальной маркировкой, сдавайте в пункты приема спецотходов или в магазины электрооборудования. Закон обязывает пользователей обеспечить утилизацию батареек.

Следующие знаки предупреждают о наличии в батарейках токсичных веществ:

Pb = батарейка содержит свинец,

Cd = батарейка содержит кадмий,

Hg = батарейка содержит ртуть.



В интересах охраны окружающей среды по завершении срока службы прибора запрещается утилизировать его вместе с бытовыми отходами. Утилизация может производиться через соответствующие пункты сбора в Вашей стране.

Прибор следует утилизировать согласно Директиве ЕС об отходах электрического и электронного оборудования — WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). При возникновении вопросов обращайтесь в местную коммунальную службу, ответственную за утилизацию отходов.



15. ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПРОБЛЕМ?

Если при измерении весы регистрируют неисправность, на дисплее отобразится следующее.

Индикация на дисплее	Причина	Меры по устранению
«ERROR:_OVERLOAD»	Превышен максимальный вес 200 кг.	При взвешивании не превышайте максимальный вес 200 кг.
«LOW_BATTERY»	Батарейки почти разряжены.	Замените батарейки (см. главу «Замена батареек»).
«MEMORY_FULL»	Сохранены 30 результатов измерений.	Перенесите результаты измерений.
«ERROR:_CONTACT» «ERROR»	Электрическое сопротивление между электродами и подошвами ног слишком высокое (например, при сильных мозолях).	Выполните измерение еще раз босиком. При необходимости слегка смочите подошвы ступней. При необходимости удалите мозоли и ороговевшую кожу на стопах. Прижимайте ручные электроды пальцами сзади и ладонями спереди.
«ERROR:_DATA»	Измерение BIA прошло успешно, однако доля жировой массы выходит за пределы диапазона измерения (менее 3 % или более 65 %).	Пожалуйста, повторите измерение без обуви или при необходимости слегка смочите подошвы ступней. При необходимости измените настройки степени активности.
Индикация отсутствует	Батарейки полностью разряжены.	Замените батарейки (см. главу «Замена батареек»).
	Батарейки вставлены неправильно.	Проверьте полярность (см. главу «Ввод в эксплуатацию» -> «Замена батареек»).
Отображается только вес, диагностика отсутствует	Неизвестное измерение, так как не выполнены условия присвоения пользователей или однозначное присвоение невозможно.	Выберите пользователя на весах с помощью кнопки [↵] или выполните повторное присвоение пользователя в приложении. Держите электроды блока управления и стойте на платформе босиком.

Неверное измерение веса

Возможные ошибки	Меры по устранению
На весах установлена неверная нулевая точка.	Включите весы, при необходимости подождите 5 секунд и повторите измерение.
Весы стоят на ковре.	Установите весы на прочную ровную поверхность. Стойте максимально близко к краю, не опрокидывая весы.
Отображается неправильный вес	Стойте неподвижно.
Отображается неправильный вес	Подождите, пока весы снова автоматически выключатся. Повторите измерение.

Отсутствует соединение *Bluetooth*® (символ отсутствует)

Возможные ошибки	Меры по устранению
Радиосвязь.	Минимальный радиус действия в свободном пространстве — около 10 м. Стены и потолки ограничивают радиус действия. Передачу данных могут нарушить и другие радиоволны. Поэтому не ставьте весы вблизи таких устройств, как WIFI-маршрутизатор, микроволновая печь, индукционная варочная панель.
Соединение <i>Bluetooth</i> ® не установлено.	Полностью выключите приложение (в т. ч. в фоновом режиме). Выключите и снова включите <i>Bluetooth</i> ®. Выключите и снова включите смартфон. Ненадолго извлеките из весов батарейки и снова вставьте их. Посмотрите раздел FAQ на сайте www.beurer.com .
Установление соединения длится слишком долго.	Более короткий интервал передачи данных по <i>Bluetooth</i> ® при включенных весах.

16. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Размер весов	380 × 390 × 1 000 мм
Батарейки для весов	4 батарейки 1,5 В типа AA
Диапазон измерения	От 8 до 200 кг
Индикация на дисплее:	Возможность считывания показаний дисплея с шагом 0,05 кг.
Точность при повторных измерениях:	Погрешность при повторных измерениях составляет +/- 0,3 кг (серия измерений: измерения выполнены подряд на тех же весах с максимально идентичным положением весов и человека).
Абсолютная точность:	Измеренное значение по сравнению с эталонным весом составляет +/- 0,5 % +0,05 кг. Например, для 50 кг отклонение составит +/- 0,3 кг, для 100 кг — +/- 0,55 кг.
Передача данных с помощью беспроводной технологии <i>Bluetooth</i> ®	В приборе используется технология <i>Bluetooth</i> ® low energy technology, диапазон частоты 2,402–2,480 ГГц, мощность передатчика макс. 0 дБм, совместим со смартфонами и планшетами с <i>Bluetooth</i> ® 4.0

Системные требования и список совместимых устройств для приложения beurer HealthManager Pro*



Возможны технические изменения.

*Данное изделие соответствует требованиям действующих европейских и национальных директив. Настоящим подтверждаем, что данное изделие соответствует требованиям европейской директивы RED 2014/53/EC. С декларацией о соответствии директивам ЕС для данного прибора можно ознакомиться, перейдя по ссылке: <https://www.beurer.com/web/we-landingpages/de/cedclarationofconformity.php>

17. ГАРАНТИЯ/СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Более подробную информацию о гарантии и гарантийных условиях см. в прилагаемом гарантийном листе.



Uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Przestrzegać ostrzeżeń i wskazówek bezpieczeństwa. Zachować instrukcję obsługi do późniejszego wykorzystania. Udostępniać instrukcję obsługi innym użytkownikom. Przekazywać urządzenie wraz z instrukcją obsługi.

Spis treści

1. Zawartość opakowania	102	9. Analiza wartości pomiarowych.....	108
2. Objasnienie symboli	102	10. Ocena wyników	110
3. Ostrzeżenia i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa ...	102	11. Przenoszenie pomiarów za pomocą aplikacji.....	112
4. Opis urządzenia.....	104	12. Dodatkowe informacje	112
5. Uruchomienie	105	13. Czyszczenie i pielęgnacja.....	113
6. Konfigurowanie wagi diagnostycznej przy użyciu aplikacji.....	106	14. Utylizacja	113
7. Opcja: Konfigurowanie wagi diagnostycznej bez użycia aplikacji.....	106	15. Postępowanie w przypadku problemów	113
8. Wykonanie pomiaru.....	107	16. Dane techniczne.....	114
		17. Gwarancja/serwis	115

Informacje ogólne

Funkcje urządzenia

Cyfrowa waga służy do pomiaru masy ciała oraz określania innych czynników wpływających na zdrowie i kondycję. Jest przeznaczona do użytku osobistego.

Waga oferuje następujące funkcje, z których może korzystać nawet 10 osób:

- pomiar masy ciała,
- pomiar ilości tkanki tłuszczowej,
- pomiar ilości trzewnej tkanki tłuszczowej (tłuszcz organiczny / tłuszcz w okolicy brzucha),
- pomiar zawartości wody w organizmie,
- pomiar ilości tkanki mięśniowej,
- pomiar tkanki kostnej,
- pomiar podstawowej i czynnej przemiany materii.

Ponadto waga jest wyposażona w następujące dodatkowe funkcje:

- pomiar poprzeczny z 8 elektrodami, który pozwala na analizę segmentową, tj. oddzielne przedstawienie wyników dla poszczególnych części ciała (ramiona, nogi, tułów);
- innowacyjne menu na dużym wyświetlaczu (do wyboru w 5 językach);
- przełączanie pomiędzy kilogramami „kg”, funtami „lb” oraz kamieniami „st”;
- wskaźnik zużycia baterii przy niskim poziomie naładowania baterii;
- automatyczne rozpoznawanie użytkownika;
- zapisanie ostatnich 30 pomiarów dla 10 osób, jeśli nie można ich przenieść na aplikację;
- tryb gościa (bez funkcji pamięci).

Zasada pomiaru

Waga działa zgodnie z zasadą analizy B.I.A., czyli impedancji bioelektrycznej, która w ciągu kilku sekund umożliwia pomiar składników masy ciała przez nieodczuwalny i całkowicie nieszkodliwy przepływ prądu.

Za pomocą pomiaru oporu elektrycznego (impedancji) i przy uwzględnieniu stałych lub indywidualnych wartości (wiek, wzrost, płeć, stopień aktywności) można określić ilość tkanki tłuszczowej oraz inne wskaźniki ciała. Tkanka mięśniowa i woda charakteryzują się dobrym przewodnictwem elektrycznym, a tym samym mniejszym oporem. Natomiast kości i tkanka tłuszczowa mają małą przewodność, ponieważ komórki tłuszczowe i kości praktycznie nie przewodzą prądu ze względu na wysoką oporność.

Kontakt elektryczny z ciałem jest optymalizowany przez 4 elektrody rąk i 4 elektrody stóp, aby osiągnąć większą dokładność pomiaru, a co za tym idzie – lepszą analizę. Ze względu na wysocę czułą technikę analizy przy powtórnych pomiarach wartości mogą się w niewielkim stopniu zmieniać. Powodem są odchylenia podczas pomiaru impedancji (np. inny kontakt elektryczny elektrod z rękami i stopami, inny rozkład wody w organizmie).

Należy pamiętać, że wartości uzyskane za pomocą wagi diagnostycznej są jedynie przybliżeniem rzeczywistych, analitycznych wartości medycznych ciała. Jedyne lekarz może przeprowadzić dokładny pomiar tkanki tłuszczowej, wody w organizmie, tkanki mięśniowej i struktury kości, posługując się metodami medycznymi (np. tomografią komputerową).


1. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Zestaw należy sprawdzić pod kątem zewnętrznych uszkodzeń kartonowego opakowania oraz kompletności zawartości. Przed użyciem upewnić się, że na urządzeniu ani na akcesoriach nie widać żadnych uszkodzeń, a wszystkie części opakowania zostały usunięte. W razie wątpliwości zaprzestać używania urządzenia i zwrócić się do sprzedawcy lub pod podany adres działu obsługi klienta.

- Waga diagnostyczna z wyświetlaczem na aluminiowym stojaku
- 4 × baterie 1,5 V typ AA
- Niniejsza instrukcja obsługi
- 2 × skrócona instrukcja obsługi
- Zestaw montażowy (4 śruby + 2 zapasowe śruby + klucz imbusowy)

2. OBJAŚNIENIE SYMBOLI

Na urządzeniu, w instrukcji obsługi, na opakowaniu i tabliczce znamionowej urządzenia zastosowano następujące symbole:

⚠ OSTRZEŻENIE			
Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację. Nieuniknięcie tego ryzyka może prowadzić do śmierci lub najcięższych obrażeń ciała.			
	Informacja o produkcie Wskazówka z ważnymi informacjami.		Oznaczenie zgodności z wymogami w Wielkiej Brytanii
	Urządzenie nie może być używane przez osoby z implantami medycznymi (np. rozrusznikiem serca). W przeciwnym razie urządzenie może negatywnie wpływać na ich działanie.		Symbol importera
	Oznaczenie CE Niniejszy produkt spełnia wymagania obowiązujących dyrektyw europejskich i krajowych.		Producent.
	Produkty spełniają wymogi przepisów technicznych obowiązujących w Unii Europejskiej i Unii Gospodarczej.		Oddzielić produkt i elementy opakowania i zutylizować je zgodnie z lokalnymi przepisami.
	Urządzenia elektrycznego nie wolno utylizować wraz z innymi odpadami domowymi		Sprawdzić w instrukcji obsługi
	Baterii zawierających szkodliwe substancje nie należy wyrzucać z odpadami z gospodarstwa domowego.		Oznakowanie identyfikujące materiał opakowaniowy. A = skrót nazwy materiału, B = numer materiału: 1-7 = tworzywa sztuczne, 20-22 = papier i tektura
	Niebezpieczeństwo poślizgnięcia się! Nie wchodzić na wagę, gdy jest mokra.		Ustawić wagę na twardym i płaskim podłożu. Nie stawiać wagi na dywanie.
	Niebezpieczeństwo przewrócenia się! Nie stawać na krawędzi.		

3. OSTRZEŻENIA I WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

⚠ OSTRZEŻENIE

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do ważenia ludzi i rejestrowania osobistych danych dotyczących stanu organizmu. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego i nie może być wykorzystywane do celów medycznych ani komercyjnych. Urządzenie może być używane wyłącznie do celu, do jakiego jest zaprojektowane i w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi.
- **Urządzenie nie może być używane przez osoby z implantami medycznymi (np. rozrusznikiem serca).** W przeciwnym razie urządzenie może negatywnie wpływać na ich działanie.
- Z urządzenia nie powinny korzystać kobiety w ciąży.



- **Niebezpieczeństwo przewrócenia się!** Nigdy nie ustawiać wagi na nierównym podłożu. Nie stawać z jednej strony na krawędzi wagi.
- **Niebezpieczeństwo poślizgnięcia się!** Nie stawać na wagę mokrymi stopami. Nie stawać na wadze, gdy jej powierzchnia jest wilgotna. Nie stawać na wadze w skarpetach.
- Należy pamiętać, że możliwe są uwarunkowane technicznie tolerancje pomiarowe, ponieważ nie jest to waga legalizowana do profesjonalnych zastosowań medycznych.
- W przypadku leczenia lub diety z powodu nadwagi lub niedowagi należy skonsultować się z odpowiednim personelem medycznym (np. z lekarzem). Wartości określone za pomocą wagi mogą stanowić pomoc dla specjalistycznego personelu.
- W przypadku dzieci, sportowców wyczynowych lub osób z ograniczeniami medycznymi/fizycznymi (np. objawy obrzęku, osteoporoza, przyjmowanie leków stosowanych w chorobach układu sercowo-naczyniowego, znaczne anomalie anatomiczne kończyn dolnych) może dojść do niedokładnych lub niewiarygodnych wyników pomiaru tkanki tłuszczowej.
- Naprawy mogą być wykonywane tylko przez serwis Beurer lub autoryzowanego dystrybutora. Nigdy nie otwierać wagi samodzielnie.

Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące postępowania z bateriami

- Baterie należy zawsze wkładać prawidłowo i z uwzględnieniem biegunowości (+ / -). Baterie należy utrzymywać w czystości i w stanie suchym, a także trzymać je z dala od wody. Zawsze wybierać odpowiedni typ baterii.
- Nigdy nie należy zwierać baterii ani styków baterii.
- Nigdy nie należy ładować, wymuszać rozładowywania, podgrzewać, rozkładać, deformować, okrywać ani modyfikować baterii.
- Nigdy nie należy spawać ani lutować baterii.
- Nigdy nie należy użytkować jednocześnie w jednym urządzeniu baterii różniących się producentem, pojemnością (nowe i używane), rozmiarem ani typem.
- **Zagrożenie wybuchem!** Nieprzestrzeganie powyższych punktów może prowadzić do obrażeń ciała, przegrzania, wycieku, odpowietrzenia, pęknięcia, wybuchu lub pożaru.
- Jeśli z baterii wycieknie elektrolit, należy założyć rękawice ochronne i wyczyścić komorę baterii suchą szmatką.
- Jeśli dojdzie do kontaktu elektrolitu ze skórą lub z oczami, należy przemyć podrażnione miejsca wodą i skontaktować się z lekarzem.
- **Niebezpieczeństwo połknięcia!** Baterie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W razie połknięcia niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.
- Nigdy nie należy pozwalać dzieciom na wymianę baterii bez nadzoru osoby dorosłej.
- Baterie należy przechowywać z dala od przedmiotów metalowych, w dobrze wentylowanych, suchych i chłodnych pomieszczeniach.
- Nigdy nie wystawiać baterii na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani deszczu.
- Wyjąć baterie, jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas.
- Rozładowane baterie należy zutylizować niezwłocznie i w odpowiedni sposób. Nigdy nie należy wrzucać baterii do ognia.
- Podczas utylizacji baterie należy przechowywać oddzielnie od różnych systemów elektrochemicznych.



Wskazówki ogólne


- Maksymalne obciążenie wagi wynosi 200 kg (440 lb, 31 st). Wyniki pomiaru masy ciała są wyświetlane z dokładnością do 50 g (0,1 lb).
- Wyniki pomiaru zawartości tkanki tłuszczowej, wody i tkanki mięśniowej są wyświetlane z dokładnością do 0,1%.
- Zapotrzebowanie kaloryczne jest podawane z dokładnością do 1 kcal.
- Ustawionymi fabrycznie jednostkami wagi są „cm” i „kg”. Podczas pierwszego uruchomienia za pomocą aplikacji można zmienić ustawienia jednostek.



Ogólne wskazówki


- Aby zapewnić porównywalne wyniki, należy się ważyć w miarę możliwości o tej samej porze dnia (najlepiej rano), po wycie w toalecie, na czczo i bez ubrania.
- Ważne informacje podczas pomiaru: Pomiar tkanki tłuszczowej należy wykonywać tylko przy użyciu elektrod rąk i bosych stóp, a także celowo lekko zwilżyć podeszwy stóp.
- Zupełnie suche lub pokryte odciskami podeszwy mogą negatywnie wpływać na wyniki, ponieważ mają zbyt niską przewodność.
- W trakcie pomiaru należy stać w pozycji pionowej i nie poruszać się.
- Odczekać kilka godzin po niestandardowym wysiłku fizycznym.
- Począć około 15 minut po przebudzeniu, tak aby woda znajdująca się w organizmie została rozprowadzona.
- Należy pamiętać, że pod uwagę brana jest tylko tendencja długoterminowa. Zazwyczaj krótkoterminowe wahania masy ciała w ciągu kilku dni są spowodowane utratą płynów; woda w organizmie ma duży wpływ na dobre samopoczucie.

4. OPIS URZĄDZENIA

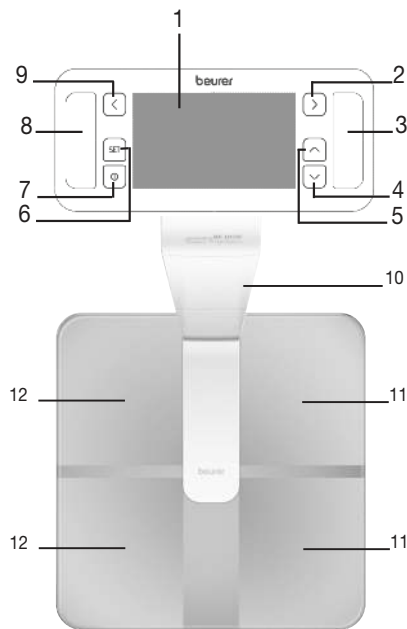

1. Wyświetlacz
2. > Menu: Przycisk w prawo (Przycisk dotykowy)
3. Elektrody, prawa ręka
4. < Menu: Przycisk do dołu (Przycisk dotykowy)
5. < Menu: Przycisk do góry (Przycisk dotykowy)
6. [SET] Przycisk ustawień, potwierdzenie wprowadzonych danych (Przycisk dotykowy)
7. [ON/OFF] Przycisk ON/OFF (Przycisk dotykowy)
8. Elektrody, lewa ręka
9. < Menu: Przycisk w lewo (Przycisk dotykowy)
10. Stojak aluminiowy
11. Elektrody stóp, prawa stopa
12. Elektrody stóp, lewa stopa

Wyświetlacz

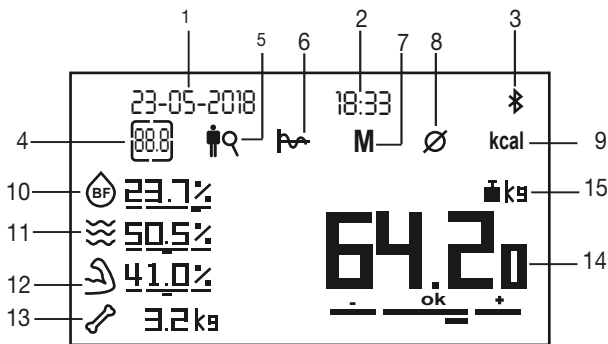


1. Data	2. Godzina
3. Bluetooth®	4. Ogólny przegląd
5. Analiza segmentowa	6. Wykres
7. Pamięć użytkownika	8. Wartości średnie
9. Zużycie kalorii	10. Procentowa ilość tkanki tłuszczowej z interpretacją
11. Zawartość wody w organizmie z interpretacją	12. Procentowa ilość tkanki mięśniowej z interpretacją
13. Masa kostna z interpretacją	14. Masa ciała z interpretacją BMI
15. Jednostka masy (kg, lb lub st)	


5. URUCHOMIENIE

Ustawienie wagi


Ustaw wagę na twardym i stabilnym podłożu. Stabilna powierzchnia jest warunkiem prawidłowego pomiaru.

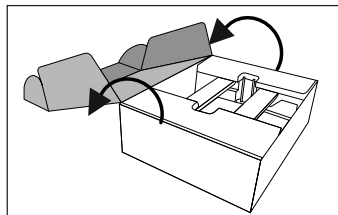


1. Otwórz karton.

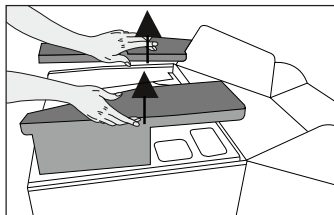


2. Zdejmij styropianowe zabezpieczenia z lewej i prawej strony.

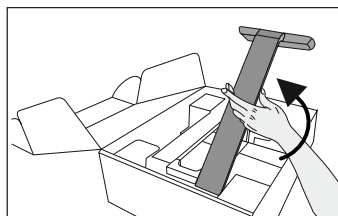


3. Jednocześnie rozłóż górną i dolną część aluminiowego stojaka.

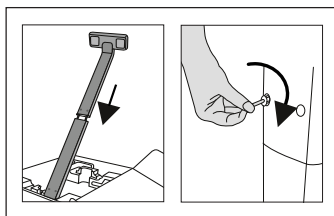


4. Włóż górną część aluminiowego stojaka do dolnej części i przykręć ją u góry

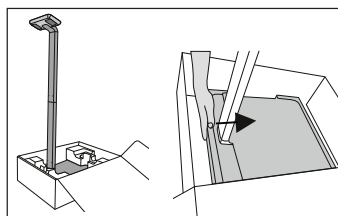


5. Stojak aluminiowy ustaw w pudełku w pozycji pionowej. Przesuń wagę na brzeg kartonu...

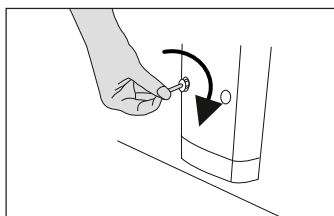

6. ...i przykręć od dołu.

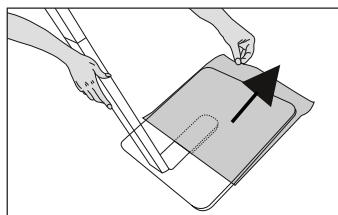

7. Jedną ręką przytrzymaj stojak, a drugą zdejmij folię.

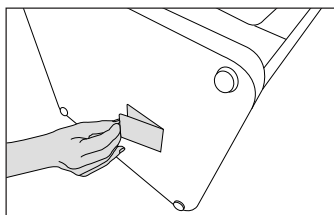

8. Włóż baterie do spodniej części wagi, zwracając uwagę na prawidłową biegunowość (+/-). Ustaw wagę na płaskiej powierzchni.

6. KONFIGUROWANIE WAGI DIAGNOSTYCZNEJ PRZY UŻYCIU APLIKACJI

Aby zmierzyć ilość tkanki tłuszczowej i inne parametry ciała, należy zapisać dane użytkownika w pamięci wagi. W pamięci wagi można zapisać dane 10 użytkowników. Miejsca w pamięci można przypisać poszczególnym członkom rodziny w celu umożliwienia rejestrowania indywidualnych ustawień.

Ponadto konta użytkowników można włączać za pomocą innych mobilnych urządzeń końcowych z zainstalowaną aplikacją „beurer HealthManager Pro” lub przez zmianę profilu użytkownika w aplikacji (patrz ustawienia aplikacji).

Aby podczas uruchomienia połączenia *Bluetooth®* pozostało aktywne, nie należy oddalać się ze smartfonem od wagi.

- **Uruchom funkcję *Bluetooth®* w ustawieniach smartfona.**
- **Pobierz bezpłatną aplikację „beurer HealthManager Pro” ze sklepu Apple App Store (iOS) lub Google Play (Android™).**
- **Uruchom aplikację i postępuj zgodnie ze wskazówkami.**

- W aplikacji „beurer HealthManager Pro” należy ustawić lub wprowadzić następujące ustawienia:

Dane użytkownika	Wartości nastawcze												
Inicjały	Maks. 3 znaki (A–Z, 0–9)												
Płeć	Mężczyzna (♂), kobieta (♀)												
Wzrost	100–250 cm (od 3' 03" do 8' 02")												
Data urodzenia	Rok, miesiąc, dzień												
Stopień aktywności	Przy wyborze stopnia aktywności decydujące jest uwzględnienie średniego i długiego okresu obserwacji:												
	<table><tr><td></td><td>Aktywność fizyczna</td></tr><tr><td>1</td><td>Brak.</td></tr><tr><td>2</td><td>Mała intensywność: niewielki i lekki wysiłek fizyczny (np. spacer, lekkie prace ogrodowe, ćwiczenia gimnastyczne).</td></tr><tr><td>3</td><td>Średnia intensywność: wysiłek fizyczny co najmniej od 2 do 4 razy w tygodniu po 30 minut.</td></tr><tr><td>4</td><td>Wysoka intensywność: wysiłek fizyczny co najmniej od 4 do 6 razy w tygodniu po 30 minut.</td></tr><tr><td>5</td><td>Bardzo wysoka intensywność: intensywny wysiłek fizyczny, intensywny trening lub ciężka praca fizyczna codziennie przez co najmniej godzinę.</td></tr></table>		Aktywność fizyczna	1	Brak.	2	Mała intensywność: niewielki i lekki wysiłek fizyczny (np. spacer, lekkie prace ogrodowe, ćwiczenia gimnastyczne).	3	Średnia intensywność: wysiłek fizyczny co najmniej od 2 do 4 razy w tygodniu po 30 minut.	4	Wysoka intensywność: wysiłek fizyczny co najmniej od 4 do 6 razy w tygodniu po 30 minut.	5	Bardzo wysoka intensywność: intensywny wysiłek fizyczny, intensywny trening lub ciężka praca fizyczna codziennie przez co najmniej godzinę.
		Aktywność fizyczna											
	1	Brak.											
	2	Mała intensywność: niewielki i lekki wysiłek fizyczny (np. spacer, lekkie prace ogrodowe, ćwiczenia gimnastyczne).											
	3	Średnia intensywność: wysiłek fizyczny co najmniej od 2 do 4 razy w tygodniu po 30 minut.											
	4	Wysoka intensywność: wysiłek fizyczny co najmniej od 4 do 6 razy w tygodniu po 30 minut.											
5	Bardzo wysoka intensywność: intensywny wysiłek fizyczny, intensywny trening lub ciężka praca fizyczna codziennie przez co najmniej godzinę.												
Masa docelowa	kg/lb/st (do graficznego przedstawiania przebiegu)												

- Aplikacja przypisuje do użytkownika następną wolną pamięć wagi (osoba 1 – osoba 10).

- Wykonanie pomiaru: Aby automatycznie rozpoznawanie osób było możliwe, pierwszy pomiar należy przypisać do osobistych danych użytkownika. Aplikacja o to poprosi. Postępuj przy tym zgodnie ze wskazówkami w rozdziale „8. Wykonanie pomiaru”.

7. OPCJA: KONFIGUROWANIE WAGI DIAGNOSTYCZNEJ BEZ UŻYCIA APLIKACJI

Zalecamy uruchomienie i wykonanie wszystkich ustawień za pomocą aplikacji – patrz rozdział: „6. Konfigurowanie wagi diagnostycznej przy użyciu aplikacji”. Czynności te można jednak wykonać również na urządzeniu.

Wprowadzić ustawienia dotyczące urządzenia/czasu/użytkownika na panelu sterowania. Dokonać wyboru za pomocą przycisków [] ew. [] i potwierdzić każdorazowo za pomocą [SET].

a) Ustawianie czasu

[SET] → „SET TIME (USTAW CZAS)” → [SET]

Kolejność	Wartości nastawcze
Data	Rok-miesiąc-dzień
Godzina	Godziny-minuty

b) Wprowadzanie ustawień urządzenia

[SET] → „SET UNIT (USTAWIENIA URZĄDZENIA)” → [SET]

Kolejność	Wartości nastawcze
Język	
Jednostka pomiaru	kg–lb–st
Godzina	24 h–12 h
Tryb gościa	WŁ.–WYŁ.

Kolejność	Wartości nastawcze
Bluetooth®	Wł.–WYł.  W przypadku opcji „WYł.” połączenie <i>Bluetooth®</i> jest możliwe tylko wtedy, gdy waga jest włączona. Może to być przydatne w celu przedłużenia żywotności baterii lub uniknięcia promieniowania radiowego.

c) Ustawianie danych użytkownika

[SET] → „SET USER (ZMIEN OSOBE)” → [SET]

Dane użytkownika	Wartości nastawcze
Inicjały	Maks. 3 znaki (A–Z, 0–9)
Płeć	Mężczyzna () , kobieta ()
Wzrost	100–250 cm (od 3' 03" do 8' 02")
Data urodzenia	Rok, miesiąc, dzień
Stopień aktywności	1–5 (patrz rozdział 6)
Masa docelowa	kg/lb/st (do graficznego przedstawiania przebiegu)
PIN użytkownika	Jest nadawany automatycznie do ewentualnego późniejszego korzystania z <i>Bluetooth®</i> . Te informacje są potrzebne tylko w przypadku ponownej konfiguracji aplikacji, gdy istniejący użytkownicy wagi zostaną dodani podczas późniejszych instalacji aplikacji.



Późniejsza rejestracja aplikacji

Jeśli waga została uruchomiona bez aplikacji, możesz dodać swojego dotychczasowego użytkownika do aplikacji „beurer HealthManager Pro”. W trakcie tego procesu konieczne jest podanie 4-cyfrowego PIN-u użytkownika („PIN”). Kolejne kroki zostały opisane w aplikacji.

8. WYKONANIE POMIARU

8.1 Pomiar masy ciała

- Na panelu sterowania naciśnij przycisk . Na wyświetlaczu pojawi się wskazanie „0.0” kg.
- Waga jest przygotowana do pomiaru masy ciała. Stań na wadze, rozkładając ciężar ciała równomiernie na obie nogi. Dane z ważenia nie zostały zapisane, przypisanie użytkownika nie jest możliwe, ponieważ pomiar BIA na rękach i stopach nie udał się.

8.2 Pomiar masy w trybie gościa

W przypadku jednorazowego pomiaru lub jeśli dane użytkownika nie muszą zostać zapisane. W tym celu w ustawieniach urządzenia musi zostać włączony tryb gościa.

[] → „GUEST (Gość)” → [SET] lub włączenie wagi


Dane użytkownika	Wartości nastawcze
Płeć	Mężczyzna () , kobieta ()
Wzrost	100–250 cm (od 3' 03" do 8' 02")
Data urodzenia	Rok, miesiąc, dzień
Stopień aktywności	1–5 (patrz rozdział 6)

8.3 Pomiar z analizą całego ciała użytkownika

- Na panelu sterowania naciśnij przycisk . Na wyświetlaczu pojawi się wskazanie „0.0” kg.
-  Jeśli w ustawieniach wagi został włączony tryb gościa, należy stanąć na wadze, kiedy jest wyłączona.
- Stań boso na wagę i trzymaj panel sterowania mocno w rękach. Trzymaj panel sterowania dolną częścią kciuka przy przednich elektrodach i palcami dociśniętymi mocno do tylnych elektrod.
- Stój spokojnie na wadze, rozkładając ciężar ciała równomiernie na obu nogach. Upewnij się, że skóra między stopami, nogami, łydkami i udami się nie styka.



- Jeśli waga wykryła obecność automatycznie, po pomiarze masy ciała nastąpi pomiar impedancji do analizy. Jest to sygnalizowane przez symbol przepływu przez ciało.
- Po zakończeniu analizy całego ciała zostanie wyświetlone podsumowanie wyników. Wartość pomiarowa jest zapisywana automatycznie.



Wskazówka:

Zapis pomiaru nie następuje w następujących warunkach:

- Użytkownik nie został automatycznie wykryty. Dzieje się tak, gdy zmierzona masa ciała różni się od ostatniego pomiaru o ± 3 kg lub wartości pomiaru masy ciała innego użytkownika są zbliżone do Twoich w zakresie ± 3 kg. Należy wtedy nacisnąć przycisk [], aby ręcznie wybrać użytkownika i powtórzyć pomiar.
- Użytkownik stoi na wadze w butach.
- Użytkownik nie trzyma elementu ręcznego w dłoniach.

9. ANALIZA WARTOŚCI POMIAROWYCH




Przetwarzanie wyników następuje automatycznie po przeprowadzonym pomiarze lub po ręcznym wybraniu użytkownika na panelu sterowania. Wybierz użytkownika za pomocą przycisku []. Potwierdź wybór przyciskiem [SET] lub zaczekaj 3 sekundy.



Ogólny przegląd


Przed lub po pełnej analizie ciała użytkownika na wyświetlaczu pojawi się ogólny przegląd pomiarów.



Analiza segmentowa zawartości tkanki tłuszczowej i masy mięśniowej


a) Tkanka tłuszczowa lewej i prawej ręki

- Naciskaj przycisk menu [] tak często, aż napis zostanie zaznaczony. Na wyświetlaczu pojawi się analiza segmentowa tkanki tłuszczowej dla lewego i prawego ramienia.




b) Tkanka tłuszczowa lewej i prawej nogi




- Za pomocą przycisku [] przejdź do szczegółowego opisu tkanki tłuszczowej dla lewej i prawej nogi.



c) Tkanka tłuszczowa tułowia





- Za pomocą przycisku [] przejdź do szczegółowego opisu tkanki tłuszczowej tułowia.



d) Trzewna tkanka tłuszczowa (tłuszcz organiczny / tłuszcz w okolicy brzucha) • Za pomocą przycisku [☐] przejdź do szczegółowego opisu trzewnej tkanki tłuszczowej.	
e) Tkanka mięśniowa lewej i prawej ręki • Za pomocą przycisku [☐] przejdź do szczegółowego opisu tkanki mięśniowej dla lewej i prawej ręki.	
f) Tkanka mięśniowa lewej i prawej nogi • Za pomocą przycisku [☐] przejdź do szczegółowego opisu tkanki mięśniowej dla lewej i prawej nogi.	
g) Tkanka mięśniowa tułowia • Za pomocą przycisku [☐] przejdź do szczegółowego opisu tkanki mięśniowej tułowia.	

 Dla użytkowników w wieku od 10 do 17 lat nie jest wyświetlana zawartość tłuszczu trzewnego ani analiza segmentowa masy mięśniowej (ręka/noga/tułowia).

Wykres

a) Masa ciała • Naciśnij przycisk menu [☐] tak często, aż napis  zostanie zaznaczony. Na wyświetlaczu pojawi się kształtowanie masy ciała użytkownika. Przedstawiane jest kształtowanie się masy ciała między pomiarami. Nowsze pomiary są dodawane po prawej stronie. Linia referencyjna przedstawia masę docelową.  Masę docelową można w każdej chwili ustawić w danych użytkownika.	
b) Tkanka tłuszczowa  • Naciśnij przycisk [☐], aby wyświetlić przebieg zmian zawartości tkanki tłuszczowej . Przedstawiane jest kształtowanie się tkanki tłuszczowej między pomiarami. Linia referencyjna przedstawia wartość średnią wszystkich pomiarów tkanki tłuszczowej, paski pokazują, czy wartości zmieniły się w górę lub w dół.	
c) Zawartość wody  • Naciśnij przycisk [☐], aby wyświetlić przebieg zmian zawartości wody w organizmie . Przedstawiana jest zmiana zawartości wody w organizmie między pomiarami. Linia referencyjna przedstawia wartość średnią wszystkich pomiarów zawartości wody w organizmie, paski pokazują, czy wartości zmieniły się w górę lub w dół.	
d) Tkanka mięśniowa  • Naciśnij przycisk [☐], aby wyświetlić przebieg zmian ilości tkanki mięśniowej . Przedstawiana jest zmiana ilości tkanki mięśniowej między pomiarami. Linia referencyjna przedstawia wartość średnią wszystkich pomiarów ilości tkanki mięśniowej, paski pokazują, czy wartości zmieniły się w górę lub w dół.	

Trzewna tkanka tłuszczowa (tłuszcz organiczny / tłuszcz w okolicy brzucha)

Trzewną tkanką tłuszczową nazywany jest tłuszcz, który otacza narządy wewnętrzne w jamie brzusznej. Istnieją podejrzenia, że obecność trzewnej tkanki tłuszczowej sprzyja rozwojowi takich chorób, jak wysokie ciśnienie krwi lub cukrzyca.

Na wyświetlaczu trzewna tkanka tłuszczowa przedstawiona jest za pomocą wskaźników od 1 do 59.

Wskaźnik zawartości trzewnej tkanki tłuszczowej	Ocena
1–12	Zawartość trzewnej tkanki tłuszczowej w Twoim organizmie mieści się w prawidłowym zakresie.
13–59	Zawartość trzewnej tkanki tłuszczowej w Twoim organizmie jest za wysoka.

Procentowa zawartość wody

Ilość wody w organizmie wyrażona w % mieści się standardowo w następujących przedziałach:

Mężczyzna

-- ok +			
Wiek	Źle	Dobrze	Bardzo dobrze
10–100	<50%	50–65%	>65%

Kobieta

-- ok +			
Wiek	Źle	Dobrze	Bardzo dobrze
10–100	<45%	45–60%	>60%

W tkance tłuszczowej znajduje się stosunkowo mało wody. W przypadku osób z dużą ilością tkanki tłuszczowej zawartość wody w organizmie może być poniżej wartości orientacyjnych. U sportowców wytrzymałościowych wartości orientacyjne mogą zostać przekroczone ze względu na niski poziom tłuszczu i wysoką wartość procentową tkanki mięśniowej.

Na podstawie pomiaru poziomu wody nie można wyciągać wniosków o stanie zdrowia, np. na temat związanego z wiekiem zatrzymywania wody w organizmie. W razie potrzeby należy skonsultować się z lekarzem. Zasadniczo założeniem jest dążenie do wysokiej zawartości wody w organizmie.

Tkanka mięśniowa

Podczas pomiaru zawartości tkanki mięśniowej mierzona jest masa mięśni szkieletowych. Pomiar nie uwzględnia mięśni narządów wewnętrznych. Ilość tkanki mięśniowej w % mieści się standardowo w następujących przedziałach:

Mężczyzna

-- ok +			
Wiek	Mało	Standardowo	Dużo
10–14	<44%	44–57%	>57%
15–19	<43%	43–56%	>56%
20–29	<42%	42–54%	>54%
30–39	<41%	41–52%	>52%
40–49	<40%	40–50%	>50%
50–59	<39%	39–48%	>48%
60–69	<38%	38–47%	>47%
70–100	<37%	37–46%	>46%

Kobieta

-- ok +			
Wiek	Mało	Standardowo	Dużo
10–14	<36%	36–43%	>43%
15–19	<35%	35–41%	>41%
20–29	<34%	34–39%	>39%
30–39	<33%	33–38%	>38%
40–49	<31%	31–36%	>36%
50–59	<29%	29–34%	>34%
60–69	<28%	28–33%	>33%
70–100	<27%	27–32%	>32%

Masa kostna

Nasze kości, podobnie jak reszta naszego ciała, podlegają naturalnym procesom wzrostu, degradacji i starzenia. Ilość masy kostnej zwiększa się szybko w okresie dzieciństwa i osiąga wartość maksymalną w wieku 30–40 lat. Z wiekiem ubywa tkanki kostnej. W wyniku stosowania zdrowej diety (bogatej w wapń i witaminę D) i dzięki regularnym ćwiczeniom fizycznym można w pewnym stopniu zapobiec degradacji masy kostnej. Przez celowe budowanie mięśni można dodatkowo zwiększyć stabilność swojego układu kostnego. Należy uwzględnić to, że waga wskazuje zawartość minerałów w kościach. Na masę kostną mamy niewielki wpływ. Jednak w niewielkim stopniu może się ona zmieniać w zależności od pewnych czynników (takich jak masa, wzrost, wiek, płeć). Nie istnieją znane wytyczne ani zalecenia.



Nie myl masy kostnej z gęstością kości. Gęstość kości można określić tylko na podstawie badań medycznych (np. tomografii komputerowej, USG). W związku z tym nie można wyciągać wniosków o zmianach w kościach i ich twardości (np. o osteoporozie), bazując na wynikach pomiaru tej wagi.

BMR

Podstawowa przemiana materii (BMR = Basal Metabolic Rate) to ilość energii potrzebna organizmowi w stanie całkowitego spoczynku do utrzymania podstawowych funkcji życiowych (np. w trakcie 24-godzinnej odpoczynku w łóżku). Ta wartość zależy głównie od masy, wzrostu i wieku. W przypadku wagi diagnostycznej wskaźnik ten jest wyświetlany w jednostce kcal/dzień i obliczany na podstawie naukowo uznanego wzoru Mifflin-St.Jeor.

Jest to niezbędna ilość energii dla organizmu, którą należy dostarczyć z pożywieniem. Długotrwale dostarczanie zbyt małej ilości energii może mieć szkodliwy wpływ na zdrowie.

AMR

Czynna przemiana materii (AMR = Active Metabolic Rate) to ilość energii, jaką organizm zużywa w ciągu dnia w stanie aktywnym. Zużycie energii przez ludzki organizm zwiększa się wraz ze wzrostem aktywności fizycznej i jest mierzone na wadze diagnostycznej przez wprowadzony stopień aktywności (1–5).

Aby utrzymać aktualną masę ciała, należy uzupełniać zużyta energię, dostarczając ją do organizmu w postaci jedzenia i picia. Jeżeli przez dłuższy czas ilość dostarczanej energii jest mniejsza niż zużywana, organizm pobiera brakującą energię głównie z odłożonej tkanki tłuszczowej. Powoduje to spadek masy ciała. Jeżeli jednak przez długi okres organizm przyjmuje większą ilość energii, niż wynika to z obliczonej czynnej przemiany materii (AMR), nie może spalić nadmiaru energii, w związku z czym jest on przechowywany w postaci tkanki tłuszczowej, powodując zwiększenie masy ciała.

Związek pomiędzy wynikami a długością czasu obserwacji



Należy pamiętać, że tylko tendencje długoterminowe odgrywają istotną rolę. Krótkoterminowe wahania masy ciała w ciągu kilku dni są zazwyczaj uwarunkowane utratą płynów.

Interpretację wyników przeprowadza się na podstawie zmiany całkowitej masy ciała oraz procentowej zawartości tkanki tłuszczowej, mięśniowej i wody, a także okresu, w jakim zmiany te miały miejsce. Należy odróżnić szybkie zmiany (w ciągu kilku dni) od zmian średnioterminowych (tygodnie) i długoterminowych (miesiące).

Podstawową zasadą jest to, że krótkoterminowe zmiany w masie reprezentują prawie wyłącznie zmiany w zawartości wody, podczas gdy średnio- i długoterminowe zmiany mogą mieć wpływ na zawartość tłuszczu i mięśni.

- Jeżeli w krótkim czasie nastąpi spadek masy ciała, a ilość tkanki tłuszczowej wzrasta lub pozostaje na takim samym poziomie, jest to oznaka tylko ubytku wody – na przykład po treningu, saunie lub po szybkim spadku masy ciała w wyniku restrykcyjnej diety odchudzającej.
- Jeśli masa ciała zwiększa się w średnim czasie, a ilość tkanki tłuszczowej spada lub pozostaje na takim samym poziomie, może to oznaczać zwiększenie cennej masy mięśniowej.
- Jeśli następuje jednoczesny spadek masy ciała i ilości tkanki tłuszczowej, oznacza to, że dieta jest skuteczna i spalasz tkankę tłuszczową.
- Idealnym rozwiązaniem jest wspomaganie skuteczności diety aktywnością fizyczną, treningiem aerobowym i siłowym. Pozwala to w średnim czasie na zwiększenie masy mięśniowej.
- Nie można dodawać ilości tkanki tłuszczowej, wody zawartej w organizmie ani tkanki mięśniowej (tkanka mięśniowa zawiera również składniki pochodzące z wody zawartej w organizmie).

11. PRZENOSZENIE POMIARÓW ZA POMOCĄ APLIKACJI

Jeśli aplikacja nie jest włączona, nowo przyporządkowane pomiary zostaną zapisane w pamięci wagi. W pamięci wagi można zapisać maksymalnie 30 pomiarów na użytkownika. Zapisane wartości są automatycznie przenoszone do aplikacji, gdy urządzenie z aplikacją znajduje się w zasięgu połączenia *Bluetooth®*. Automatyczne przenoszenie danych jest możliwe, jeśli w ustawieniach urządzenia włączony jest *Bluetooth®*.

12. DODATKOWE INFORMACJE

Usuwanie danych zapisanych w pamięci wagi

a) Usuwanie użytkownika wraz ze wszystkimi ustawieniami i zapisanymi wartościami

- Po włączeniu wybierz użytkownika, naciskając przycisk []. W razie potrzeby ponownie naciśnij przycisk i potwierdź przy użyciu [SET].
- Aby usunąć użytkownika, po wyświetleniu wskazania **0,0** naciśnij przycisk [SET] przez 12 sekund.
- Za pomocą przycisków [,] wybierz opcję „TAK” i potwierdź zapytanie przyciskiem [SET]. Aby nie usuwać użytkownika, potwierdź wybór „NIE” przyciskiem [SET].



Wszystkie zapisane wartości i ustawienia tego użytkownika zostaną usunięte.

b) Usuwanie pojedynczej zapisanej wartości danego użytkownika

- Aby usunąć wyświetlaną wartość, w pamięci użytkownika [] wybierz wartość pomiaru i naciśnij krótko przycisk [SET] na pulpicie sterowania.
- Można to wykonać także bezpośrednio po pomiarze.
- Za pomocą przycisków [,] wybierz opcję „TAK” i potwierdź zapytanie przyciskiem [SET]. Aby nie usuwać wartości, potwierdź wybór „NIE” przyciskiem [SET].

c) Usuwanie wszystkich wartości zapisu użytkownika

- Aby usunąć wszystkie wartości, otwórz pamięć użytkownika , naciśnij przycisk [SET] na pulpicie sterowania i przytrzymaj go przez ok. 5 sekund.
- Za pomocą przycisków [, ,] wybierz opcję „TAK” i potwierdź zapytanie przyciskiem [SET]. Aby nie usuwać żadnych wartości, potwierdź wybór „NIE” przyciskiem [SET].

Wymiana baterii

Element obsługowy jest wyposażony we wskaźnik naładowania baterii. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat „LOW BATTERY”, jeśli baterie są zbyt rozładowane. Należy wówczas wymienić baterie. Potem waga znowu połączy się z aplikacją. Zostanie zaktualizowany czas systemowy.



Wskazówka:

- Do wymiany używać baterii tego samego typu, marki i o identycznej pojemności.
- Nie używać baterii do wielokrotnego ładowania.
- Stosować baterie niezawierające metali ciężkich.

13. CZYSZCZENIE I PIEŁĘGNACJA

Od czasu do czasu należy wyczyścić powierzchnię wagi miękką, lekko zwilżoną ściereczką. Nie używać wagi do czasu całkowitego wyschnięcia powierzchni.



Wskazówka:

- Nie stosować żadnych ostrych środków czyszczących.
- Nigdy nie zanurzać wagi w wodzie. Wagi nie należy płukać pod bieżącą wodą.
- Nie stawiać żadnych przedmiotów na wadze, gdy nie jest ona używana.
- Wagę należy chronić przed wstrząsami, wilgocią, kurzem, chemikaliami, dużymi wahaniami temperatury oraz polami elektromagnetycznymi. Urządzenie nie powinno znajdować się zbyt blisko źródeł ciepła (np. pieców, grzejników).

14. UTYLIZACJA

Zużyte, całkowicie rozładowane baterie należy wyrzucać do specjalnie oznakowanych pojemników zbiorczych, przekazywać do punktów zbiórki odpadów specjalnych lub do sklepu ze sprzętem elektrycznym. Użytkownik jest zobowiązany do utylizacji baterii zgodnie z przepisami.

Na bateriach zawierających szkodliwe związki znajdują się następujące oznaczenia:

Pb = bateria zawiera ołów,

Cd = bateria zawiera kadm,

Hg = bateria zawiera rtęć.



W związku z wymogami w zakresie ochrony środowiska nie należy wyrzucać urządzenia po zakończeniu eksploatacji wraz z odpadami domowymi. Utylizację należy zlecić w odpowiednim punkcie zbiórki w danym kraju.

Urządzenie należy zutylizować zgodnie z dyrektywą WE o zużytych urządzeniach elektrycznych i elektronicznych – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). W przypadku pytań należy zwrócić się do właściwej instytucji odpowiedzialnej za utylizację.



Zużyty sprzęt może mieć szkodliwy wpływ na środowisko i zdrowie ludzi z uwagi na potencjalną zawartość niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych. Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku surowców wtórnych, w tym recyklingu zużytego sprzętu. Na tym etapie kształtuje się postawy, które wpływają na zachowanie wspólnego dobra jakim jest czyste środowisko naturalne.

15. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PROBLEMÓW

W przypadku wykrycia błędu podczas pomiaru komunikat na wyświetlaczu będzie następujący:

Informacja na wyświetlaczu	Przyczyna	Rozwiązanie
„ERROR:_OVERLOAD”	Przekroczono maksymalną nośność 200 kg.	Dozwolone obciążenie tylko do 200 kg.
„LOW_BATTERY”	Baterie są prawie rozładowane.	Wymień baterie (patrz rozdział „Wymiana baterii”).
„MEMORY_FULL”	Zapisanych jest 30 pomiarów.	Przenieś wartości pomiarowe.
„ERROR:_CONTACT” „ERROR”	Opór elektryczny między elektrodami i podeszwą jest za wysoki (np. przy zrogowaciałej skórze).	Powtórz pomiar z bosymi stopami. W razie potrzeby lekko zwilż podeszwy. W razie potrzeby usuń zrogowaciałą skórę na podeszwach. Z tyłu trzymaj elektrody ręczne palcami, a z przodu kłębem kciuka.

Informacja na wyświetlaczu	Przyczyna	Rozwiązanie
„ERROR:_DATA”	Pomiar BIA wprowadził zakończył się powodzeniem, ale ilość tkanki tłuszczowej pozostaje poza mierzonym zakresem (jest mniejsza niż 3% lub większa niż 65%).	Pomiar należy powtórzyć boso lub z lekkimi zwilżonymi podszewkami stóp. W razie potrzeby zmień ustawiony stopień aktywności.
Brak wskazań	Baterie są zupełnie rozładowane.	Wymień baterie (patrz rozdział „Wymiana baterii”).
	Baterie nie są prawidłowo włożone.	Sprawdź prawidłową biegunowość (patrz „Urchomienie” -> „Wymiana baterii”).
Tylko wskazanie wagi, brak diagnozy	Nieznany pomiar, ponieważ wynik jest poza granicą przyporządkowaną do użytkownika lub jednoznaczne przyporządkowanie nie jest możliwe.	Wybierz użytkownika na wadze za pomocą przycisku [] lub powtórz proces przyporządkowania użytkownika w aplikacji. Chwyć elektrody dłońmi i stań boso na platformie.

Niewłaściwy pomiar wagi

Możliwe błędy	Rozwiązanie
Waga ma nieprawidłowy punkt zerowy.	Włącz wagę, zaczekaj ok. 5 sekund i powtórz pomiar.
Waga stoi na dywanie.	Ustaw wagę na twardym i płaskim podłożu. Stań jak najszerzej, bez przechylania wagi.
Nieprawidłowa masa ciała na wyświetlaczu.	W miarę możliwości należy stać spokojnie.
Nieprawidłowa masa ciała na wyświetlaczu.	Zaczekaj, aż waga sama się wyłączy. Następnie ponów pomiar.

Brak połączenia Bluetooth® (brak symbolu)

Możliwe błędy	Rozwiązanie
Połączenie radiowe	Minimalny zasięg na wolnej przestrzeni to ok. 10 m. Ściany i sufity zmniejszają ten zasięg. Inne fale radiowe mogą zakłócać połączenie. Dlatego wagi nie należy ustawiać w pobliżu takich urządzeń, jak routery sieci WIFI, mikrofalówki lub płyty indukcyjne.
Połączenie Bluetooth®	Zamknij aplikację (również w tle). Wyłącz i ponownie włącz Bluetooth®. Wyłącz i włącz smartfon. Wymij na chwilę baterie z wagi i włóż je z powrotem. Sprawdź FAQ na www.beurer.com .
Nawiązywanie połączenia trwa zbyt długo	Szybszy interwał Bluetooth® przy włączonej wadze.

16. DANE TECHNICZNE

Wymiary wagi	380 × 390 × 1000 mm
Baterie wagi	4 × 1,5 V typ AA
Zakres pomiaru	8–200 kg
Wyświetlacz:	Wartości są wyświetlane z dokładnością do 0,05 kg.
Powtarzalność:	Tolerancja pomiarów w przypadku powtarzalnych wartości wynosi +/-0,3 kg (pomiaru następujące bezpośrednio po sobie na tej samej wadze z możliwie identycznym położeniem wagi i osoby).
Absolutna dokładność:	Wartość zmierzona w stosunku do faktycznej masy wynosi +/-0,5% +0,05 kg. Np. w przypadku 50 kg odchylenie wynosi +/-0,3 kg, a w przypadku 100 kg, +/-0,55 kg.
Transmisja danych za pomocą technologii bezprzewodowej Bluetooth®	Produkt używa technologii Bluetooth® low energy technology, pasmo częstotliwości 2,402–2,480 GHz, moc nadawania maks. 0 dBm, kompatybilność ze smartfonami/tabletami Bluetooth® 4.0

Wymagania systemowe i lista kompatybilnych urządzeń dla aplikacji „beurer HealthManager Pro”*:
*



Zastrzega się prawo do zmian technicznych.

*Niniejszy produkt spełnia wymagania obowiązujących dyrektyw europejskich.
Potwierdzamy niniejszym, że ten produkt jest zgodny z dyrektywą europejską RED 2014/53/UE.
Certyfikat zgodności CE dotyczący tego produktu można znaleźć na stronie:
<https://www.beurer.com/web/we-landingpages/de/declarationofconformity.php>

17. GWARANCJA/SERWIS

Szczegółowe informacje na temat gwarancji i warunków gwarancji podano w załączonej ulotce gwarancyjnej.

Zastrzega się prawo do pomyłek i zmian

The *Bluetooth*® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Beurer GmbH is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.

Android is a trademark of Google LLC.



Beurer GmbH • Söflinger Str. 218 • 89077 Ulm (Germany) • www.beurer.com
www.beurer-gesundheitsratgeber.com • www.beurer-healthguide.com



Beurer UK Ltd., Suite 16, Stonecross Place, Stonecross Lane North,
WA3 2SH, Lowton, United Kingdom