Solution désinfectante détergente sans aldéhyde à diluer pour la désinfection et le nettoyage de tous les instruments dentaires et chirurgicaux y compris les fraises, instruments à canaux, daviers, sondes, miroirs... avant leur stérilisation. Micro 10®+ possède un large spectre antimicrobien et s'utilise aussi bien en bac de trempage qu'en bac à ultrasons.

Caractéristiques principales

- Dilution économique : 2%
- Temps de contact : 15 minutes
- Convient à tous les instruments
- Comprend des inhibiteurs de corrosion performants qui protègent les instruments de la rouille
- Marqué CE conformément à la Directive 93/42/CE relative aux dispositifs médicaux
- Certifié VAH/DGHM

USF Healthcare S.A. | Rue François Perréard 18 | CH-1225 Chêne Bourg | Genève | Suisse
Tél + 41 22 839 79 00 | Fax + 41 22 839 79 10 | info@usfhc.com
www.usfhealthcare.com

Unident
USF Healthcare

Micro 10®+

Protocole d'utilisation

Avant utilisation

Porter des gants appropriés.

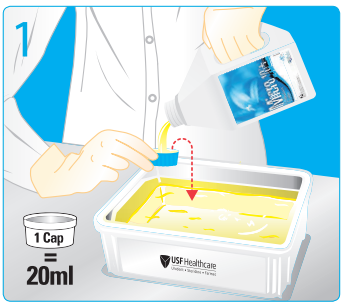

Diluer Micro 10®+ dans un bac de trempage à 2% (20ml pour 1L d'eau).

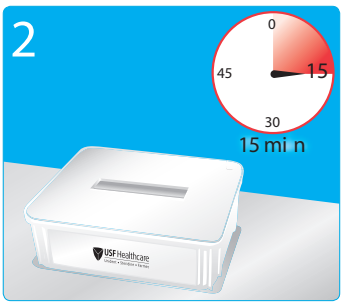

Immerger les instruments dans la solution et laisser agir pendant 15 minutes.

Retirer les instruments de la solution avec précaution et les inspecter. Les brosser si nécessaire pour enlever tout résidu visible.

Rincer les instruments à l'eau courante ou par immersion.

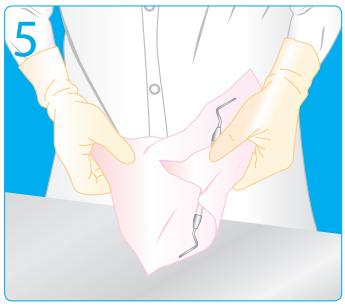

Sécher les instruments avec un essuie-tout jetable propre et les préparer à la stérilisation.

Précautions

Dangereux : respecter les précautions d'emploi (établies conformément à la réglementation européenne en matière de classification et étiquetage des produits chimiques). Avant toute utilisation, lire attentivement l'étiquette et les informations relatives au produit. Conserver entre +5°C et +35°C. Usage professionnel uniquement. Dispositif médical de classe IIb (conformément à la directive 93/42/CEE modifiée, relative aux dispositifs médicaux).

Dilutions recommandées

2% (20ml pour 1L d'eau) pour toute l'instrumentation dentaire

5% (50ml pour 1L d'eau) pour une utilisation en bac à ultrasons : 3 à 8 minutes. Supporte le chauffage jusqu'à 50°C.

10% (100 ml pour 1L d'eau) pour les petits instruments comme les instruments à canaux, les fraises diamantées, etc.

Spectre d'activité

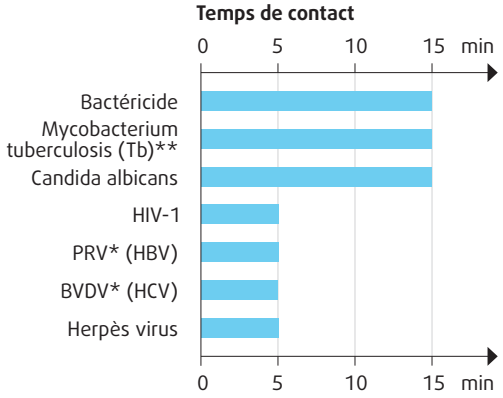

* PRV : Virus modèle de l'Hépatite B ** Dilué à 5%
* BVDV : Virus modèle de l'Hépatite C

Conforme aux normes européennes

Bactéricide : EN 1040, EN 13727, EN 14561
Levuricide : EN 1275, EN 13624, EN 14562
Actif sur virus selon EN 14476

Composition

100 g de Micro 10®+ contiennent 9 g alkyl-benzyl-diméthyl-chlorure d'ammonium, tensioactifs non ionique et amphotère, complexant, inhibiteur de corrosion et substances auxiliaires.

Données physiques

Couleur :	Jaune clair
Parfum :	Sans parfum
pH :	7,5 (dilué à 2%)
Conservation :	
Concentré	3 ans
Dilué, non utilisé	28 jours
Dilué, utilisé	7 jours selon le degré de salissure
Emballage :	PEHD recyclable

Conditionnement

1L	2,5L	5L
✓	✓	✓

INTANK

Accessoires

Bac de trempage 3L (INTANK)
Bac de trempage - Spécial fraises

ECOEngage
Our Ecological Engagement

Unident
USF Healthcare

Photo non contractuelle – 07/2018 – 07 – FR - 1625